

Analyse de gaz



ModbusRTU

Refroidisseur de gaz de mesure Série TC-Double

Manuel d'utilisation et d'installation

Notice originale





Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20 Internet: www.buehler-technologies.com E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Faites tout particulièrement attention aux indications d'avertissement et de sécurité. Dans le cas contraire, des risques sanitaires ou matériels peuvent apparaître. La responsabilité de Bühler Technologies GmbH est exclue pour toute modification de l'appareil effectuée par l'utilisateur ou toute utilisation non conforme.

Tous droits réservés. Bühler Technologies GmbH 2024

Information sur document

No. du document......BF440021

Version.......03/2024

Sommaire

1	Intro	oduction	3
	1.1	Utilisation conforme à la destination d'usage	3
	1.2	Vue d'ensemble	3
	1.3	Contenu de la livraison	3
	1.4	Indications de commande	4
		1.4.1 TC-Double	4
		1.4.2 TC-Double+	5
2	Indic	cations de sécurité	6
	2.1	Indications importantes	
	2.2	Indications générales de risques	
2	T		
3		sport et stockage	
4	Asse	mblage et raccordement	
	4.1	Exigences quant au lieu d'installation	
	4.2	Montage	
		4.2.1 Raccordement capteur de débit (en option)	
		4.2.2 Branchement capteur d'humidité (option)	
		4.2.3 Branchement pompe péristaltique (option)	
		4.2.4 Raccordement des conduites de gaz de la pompe pour gaz de mesure (en option)	
		4.2.6 Raccordement de dérivateur de condensat	
	4.3	Raccordements électriques	
	4.4	Sorties de signal	
5		tionnement et commande	
	5.1	Description des fonctions	
	5.2	Utilisation des fonctions de menu	
		5.2.1 Verrouillage de menu	
	F 2	5.2.2 Vue d'ensemble de guidage de menu	
	5.3	Description des fonctions de menu	
		5.3.2 Menu principal	
		5.3.3 Sous-menu 1	
		5.3.4 Sous-menu 1 (réglages globaux)	
		5.3.5 Définir le menu favorisé	
	5.4	Utilisation de l'interface numérique	
	5.5	Configuration Modbus	
	5.6	Communication Modbus	
	5.7	Registre Modbus	27
6	Entr	etien	21
U			
7	Entre	etien et réparation	
	7.1	Recherche de panne et résolution	
		7.1.1 Messages d'erreur sur l'écran	
	7.2	Indications de sécurité	
	7.3	Nettoyage et démontage de l'échangeur de chaleur	
	7.4	Changement du fusible du refroidisseur de gaz de mesure	
	7.5	Changer le tuyau de la pompe péristaltique (option)	
	7.6	Changement de l'élément de filtre (option)	
	7.7 7 0	Séchage du capteur d'humidité (option)	
	7.8	Changement des valves d'admission et des souppos d'échangement de la nompe pour say de mesure (en entien)	
	7.9 7.10	Changement des valves d'admission et des soupapes d'échappement de la pompe pour gaz de mesure (en option) Remplacement du joint torique de soupape by-pass (en option)	
	7.10	Changement du joint torique de soupape by-pass (en option)	
	7.11 7.12	Pièces de rechange	
	1.12	7.12.1 Consommables et accessoires	
_			
8	Mise	au rebut	40

ii

9	Pièce	es jointes	4
	9.1	Données techniques refroidisseur à gaz	41
	9.2	Caractéristiques techniques options	42
	9.3	Schéma de procédé	43
		Courbes de puissance	
		Échangeur thermique	
		9.5.1 Description échangeur de chaleur	
		9.5.2 Vue d'ensemble de l'échangeur thermique	44
	9.6	Dimensions (mm)	45
10	Docu	uments joints	46

1 Introduction

1.1 Utilisation conforme à la destination d'usage

Cet appareil est conçu pour un usage dans des systèmes d'analyse de gaz. Il constitue une composante essentielle à la préparation du gaz de mesure pour protéger l'appareil de l'humidité résiduelle dans le gaz de mesure.

Veuillez respecter les indications de la fiche technique concernant la finalité spécifique, les combinaisons de matériaux présentes ainsi que les limites de pression et de température.

1.2 Vue d'ensemble

La série TC-Double a été spécialement conçue pour de hautes capacités de refroidissement, de hautes températures ambiantes et un refroidissement en deux opérations pour minimiser les effets de dispersion. Avec le dispositif TC-Double+ les deux températures du bloc de refroidissement peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.

Une autre application de ce refroidisseur se trouve dans la variante avec pré-refroidisseur passif intégré, cela signifie que la pre-mière étape du refroidissement n'est pas pilotée électroniquement.

Les dispositifs de refroidissement de Peltier sont divisés selon la puissance de refroidissement ou la température raisonnable d'environnement. Ce classement se retrouve dans la désignation de type. Le numéro d'article précis du type que vous avez défini est déterminé à partir du code dans la rubrique Indications de commande.

Utilisation	Utilisation	s standards
Température de fonctionnement	40 °C	50 °C
2 échangeurs thermiques en série	TC-Double 6111	TC-Double 6112
2 échangeurs thermiques en série	TC-Double+ 6111	TC-Double+ 6112

D'autres composants devant être présents dans tous les systèmes de préparation peuvent être intégrés en option :

- Pompe péristaltique pour la dérivation de condensat,
- Filtre,
- Capteur d'humidité,
- Pompe de gaz de mesure.

En outre, différentes sorties de signaux peuvent être sélectionnées :

- Sortie d'état,
- Sortie analogique, 4...20 mA, incl. sortie d'état,
- Sortie numérique Modbus RTU, incl. sortie d'état

Grâce à ses options, le refroidisseur dispose d'une grande variété de configuration. Cette rubrique décrit comment simplifier à moindres frais la réalisation d'un système complet en utilisant des composants prémontés et équipés de flexibles. En outre, une grande attention a été portée à garantir un accès aux pièces d'usure et de consommation.

1.3 Contenu de la livraison

- Refroidisseur
- Documentation produit
- Accessoires de raccordement ou de montage (en option)

BF440021 ∘ 03/2024 Bühler Technologies GmbH

1.4 Indications de commande

1.4.1 TC-Double

Le numéro d'article codifie la configuration de votre appareil. Utilisez pour cela les codes types suivants :

4496 6 1 1 X 0 X 1 X X X X X X X 0 0 0 Caractéristique du produit

/ \	٠,	, ,		` /\	· / `	٠,	,,	``	. 0	, ,	Caracteristique du produit
											Type de refroidisseur de gaz
1											TC-Double 6111 : Température ambiante 40 ºC
2											TC-Double 6112 : Température ambiante 60 ºC
											Autorisation
	0										Utilisations standards – CE
											Tension d'alimentation
		1									115 V AC, 50/60 Hz
	2	2									230 V AC, 50/60 Hz
											Échangeur thermique
		1	1	1 0							Acier inoxydable, PTS, métrique
		1	1	1 5							Acier inoxydable, PTS-I, en pouces
		1	2	2 0							Verre Duran, PTG, métrique
		1	2	2 5							Verre Duran, PTG-I, en pouces
		1	3	3 0							PVDF, PTV, métrique
		1	3	3 5							PVDF, PTV-I, en pouces
											Dérivation de condensat 1)
					0						sans dérivation de condensat
					2						CPdouble avec raccords de tuyau, coudé
					4						Cpdouble avec raccord vissé 2)
											Pompes pour gaz de mesure 1) 3)
						0					sans pompe pour gaz de mesure
						1					P1, PVDF
						2					P1, avec soupape by-pass
											Capteur d'humidité/filtre 1) 2)
							0 (0			sans filtre, sans capteur d'humidité
							0	1			sans filtre, 1 capteur d'humidité avec adaptateur PVDF 4)
							1 (0			1 filtre, sans capteur d'humidité
							1	1			1 filtre avec capteur d'humidité intégré
											Sorties de signal
								C	0		sortie d'état uniquement
								1	0		Sortie analogique, 420 mA, incl. sortie d'état
								2	0		Sortie numérique Modbus RTU, incl. sortie d'état

 $^{^{1)}}$ Lorsque l'option est sélectionnée, la température ambiante maximale est limitée à 50 °C.

²⁾ Raccordement métrique, voire en pouces, selon l'échangeur thermique.

³⁾ Tubulure d'usine pour fonctionnement en aspiration.

⁴⁾ Aussi disponible en acier inoxydable.

1.4.2 TC-Double+

Le numéro d'article codifie la configuration de votre appareil. Utilisez pour cela les codes types suivants :

4496 6 1 1 X 0 X 1 X X X X X X X 0 0 0 Caractéristique du produit

٠,								_				
												Type de refroidisseur de gaz
1												TC-Double+ 6111 : Température ambiante 40 °C
2												TC-Double+ 6112 : Température ambiante 60 ºC
												Autorisation
	0											Utilisations standards – CE
												Tension d'alimentation
		1										115 V AC, 50/60 Hz
		2										230 V AC, 50/60 Hz
												Échangeur thermique
			1	2	2							Verre Duran, PTG-2, métrique
			1	2	7							Verre Duran, PTG-2-I, en pouces
			1	3	2							PVDF, PTV-2, métrique
			1	3	7							PVDF, PTV-2-I, en pouces
												Dérivation de condensat 1)
						0						sans dérivation de condensat
						2						CPdouble avec raccords de tuyau, coudé
						4						Cpdouble avec raccord vissé 2)
												Pompes pour gaz de mesure 1) 3)
						(0					sans pompe pour gaz de mesure
							1					P1, PVDF
							2					P1, avec soupape by-pass
												Capteur d'humidité/filtre 1) 2)
							(0	0			sans filtre, sans capteur d'humidité
							(0	1			sans filtre, 1 capteur d'humidité avec adaptateur PVDF 4)
							-	1	0			1 filtre, sans capteur d'humidité
							-	1	1			1 filtre avec capteur d'humidité intégré
												Sorties de signal
									() ()	sortie d'état uniquement
										1 ()	Sortie analogique, 420 mA, incl. sortie d'état
									2	2 ()	Sortie numérique Modbus RTU, incl. sortie d'état

 $^{^{1)}}$ Lorsque l'option est sélectionnée, la température ambiante maximale est limitée à 50 °C.

BF440021 • 03/2024 Bühler Technologies GmbH

²⁾ Raccordement métrique, voire en pouces, selon l'échangeur thermique.

³⁾ Tubulure d'usine pour fonctionnement en aspiration.

⁴⁾ Aussi disponible en acier inoxydable.

2 Indications de sécurité

2.1 Indications importantes

L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si :

- le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions d'installation et de commande, conformément à la plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il a été conçu. Toute modification de l'appareil de votre propre chef exclut la responsabilité de Bühler Technologies GmbH,
- les indications et dénominations sur les plaques signalétiques sont respectées.
- les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et le mode d'emploi sont respectées,
- les dispositifs de supervision / de protection sont correctement connectés,
- les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler Technologies GmbH,
- des pièces de rechange originales sont utilisées.

Ce mode d'emploi fait partie du matériel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les données de performance, de spécification ou d'interprétation sans préavis. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Mots-signaux pour avertissements

DANGER	Mot-signal pour désigner une menace à haut risque entraînant immédiatement la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
AL/EDTIOOENIENIE	Mot-signal pour désigner une menace de risque intermédiaire pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.
ATTENTION	Mot-signal pour désigner une menace à faible risque pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.
INDICATION	Mot-signal pour une information importante à propos du produit, information à laquelle il faudrait accorder une attention importante.

Signaux d'avertissement

Ce mode d'emploi utilise les signaux d'avertissement suivants :

Signal d'avertissement général	Signal d'obligation général
Avertissement de tension électrique	Débrancher la fiche d'alimentation
Avertissement d'inhalation de gaz toxiques	Porter une protection respiratoire
Avertissement de liquides irritants	Porter une protection faciale
Avertissement de risque d'explosion	Porter des gants

2.2 Indications générales de risques

L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.

Respectez impérativement les indications de sécurité pertinentes relatives au lieu d'installation ainsi que les règles techniques en vigueur. Évitez les défaillances et les dommages corporels et matériels.

L'exploitant de l'installation doit s'assurer que :

- les indications de sécurité et les instructions d'utilisation sont disponibles et respectées,
- les directives nationales respectives de prévention des accidents sont respectées,
- les données et conditions d'utilisation licites sont respectés,
- les dispositifs de protection sont utilisés et les travaux d'entretien prescrits effectués,
- les réglementations légales pour la mise au rebut sont respectées,
- les prescriptions d'installation nationales en vigueur sont respectées.
- l'appareil est protégé contre les effets mécaniques.

Entretien, réparation

Lors de toute opération de maintenance et de réparation, respecter les points suivants :

- Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.
- Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange endommagées ou défectueuses. Avant le montage, effectuez le cas échéant un contrôle visuel afin de détecter les dommages évidents sur les pièces de rechange.

Lorsque des travaux de maintenance de toutes sortes sont effectués, les dispositions de sécurité et d'exploitation applicables du pays d'utilisation doivent être respectées.

DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution




- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



DANGER

Gaz/condensats toxiques et irritants

Le gaz de mesure/les condensats peuvent être nocifs pour la santé.





- b) Coupez l'arrivée de gaz lors de tous travaux d'entretien et de réparation.
- c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz/condensats toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.





DANGER

Atmosphère potentiellement explosive



Risque d'explosion lors d'une utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion

Ce moyen de production n'est **pas** adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.

Aucun mélange gazeux inflammable ou explosif ne doit traverser l'appareil.

3 Transport et stockage

Les produits doivent toujours être transportés dans leur emballage d'origine ou dans un emballage de remplacement approprié. En cas de non utilisation, les matériels d'exploitation doivent être protégés de l'humidité et de la chaleur. Ils doivent être stockés dans une pièce couverte, sèche et sans poussière à une température comprise entre - 20°C et 60°C (- 4 °F à 140 °F).

4 Assemblage et raccordement

4.1 Exigences quant au lieu d'installation

L'appareil est destiné à un montage mural dans des lieux fermés. En cas d'utilisation en plein air, une protection contre les intempéries suffisante doit être prévue.

Montez l'appareil de sorte à laisser assez d'espace sous le refroidisseur pour dériver le condensat. Un peu d'espace doit également être prévu au-dessus pour l'alimentation en gaz.

Il faut veiller à ce que les limites autorisées de température ambiante soient respectées. La convection du refroidisseur ne doit pas être entravée. Un espace suffisant doit être laissé entre les ouvertures de ventilation et l'obstacle le plus proche. En particulier du côté de l'évacuation de l'air, une distance minimale de 10 cm doit être assurée.

Lors du montage dans des boîtiers fermés, par exemple dans des armoires d'analyse, veuillez assurer une ventilation suffisante. Si la convection ne suffit pas, nous recommandons de rincer l'armoire à l'air ou de prévoir un ventilateur afin d'abaisser la température interne.

4.2 Montage

Installez l'alimentation en gaz vers le refroidisseur avec une inclinaison. Les entrées de gaz sont marquées en rouge et comportent la mention « IN ».

En cas de grosses formations de condensat, nous recommandons de placer un séparateur de liquides avec purge automatique de condensat.

Pour la dérivation du condensat, des récipients en verre et un purgeur sont disponibles et doivent être montés à l'extérieur, sous l'appareil. En cas d'utilisation de purgeurs de condensat automatiques, la pompe pour gaz de mesure doit être montée en amont du refroidisseur (fonctionnement sous pression). Dans le cas contraire, le bon fonctionnement du purgeur de condensat n'est pas assuré.

Si la pompe pour gaz de mesure se trouve à la sortie du refroidisseur (aspiration), l'utilisation de récipients collecteurs de condensat ou de pompes péristaltiques est recommandée.

4.2.1 Raccordement capteur de débit (en option)

Si le refroidisseur est commandé avec l'option capteur d'humidité sans filtre, il est monté en usine dans un adaptateur de débit.

La liaison entre la sortie d'échangeur thermique et l'entrée d'adaptateur de débit n'est pas globalement pourvue de tuyaux. Le raccordement G1/4 ou NPT 1/4" (adaptateur de débit marqué de NPT) pour l'entrée/la sortie de gaz doit être branché avec précaution et de manière appropriée avec des raccords filetés adaptés. Le sens de l'écoulement n'est alors pas important.

4.2.2 Branchement capteur d'humidité (option)

Si le refroidisseur est commandé avec **l'option capteur d'humidité**, il est déjà monté en usine dans un adaptateur de débit, ou pour **l'option filtre**, est raccordé et monté dans la tête du filtre.

BF440021 ∘ 03/2024 Bühler Technologies GmbH

4.2.3 Branchement pompe péristaltique (option)

Si vous avez commandé le refroidisseur avec une pompe péristaltique montée, celle-ci est déjà installée et câblée à la livraison. Les échangeurs thermiques commandés en même temps sont montés et branchés à la pompe péristaltique.

Le raccordement via les assemblages vissés de la sortie de condensat de la pompe doit être fait en utilisant le flexible adéquat, prudemment et de manière appropriée.

INDICATION



L'installation de **pompes** péristaltiques CPsingle / CPdouble limite la **pression de fonctionnement** maximale du système !

Pression de fonctionnement ≤ 1 bar

4.2.4 Raccordement des conduites de gaz de la pompe pour gaz de mesure (en option)

Si vous avez commandé le refroidisseur avec une pompe pour gaz de mesure montée, celle-ci est déjà installée raccordée et câblée à la livraison. Les pièces commandées en même temps sont montées et branchées aux pompes pour gaz de mesure.

Évitez les installations mixtes, c'est-à-dire des conduites tubulaires métalliques sur des corps en plastique. Si cela est inévitable pour certaines utilisations, vissez les raccords filetés métalliques dans le corps de pompe avec précaution et sans jamais forcer.

Posez les conduites tubulaires de manière à ce que la conduite à l'entrée/la sortie reste élastique sur une distance suffisante.


Les pompes sont caractérisées sur la bague de fixation par **IN** pour Inlet (admission) et **OUT** pour Outlet (évacuation). Assurezvous que les raccords sur les conduites de gaz sont bien étanches.

4.2.5 Raccordement échangeur de chaleur


Pour minimiser les effets de dispersion du gaz dans le refroidisseur, les deux échangeurs de chaleur (de construction identique) doivent fonctionner en série l'un derrière l'autre. Pour cela, la procédure suivante devrait être suivie :

- 1. Ligne d'entrée de gaz sur l'entrée de gaz de l'échangeur de chaleur identifiée en rouge n° 2 (refroidissement préalable).
- 2. Ligne de raccordement entre la sortie de gaz de l'échangeur de chaleur n° 2 et l'entrée de gaz identifiée en rouge de l'échangeur de chaleur n° 1 (refroidissement subséquent).
- 3. Montage de la ligne terminale de sortie du gaz à la sortie du gaz de l'échangeur de chaleur n° 1.

Échangeur de chaleur 1 Échangeur de chaleur 2

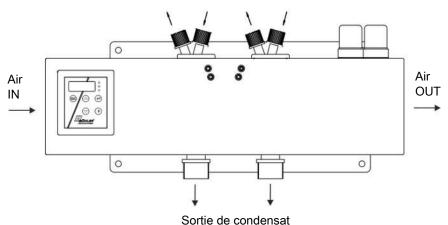


Organigramme:

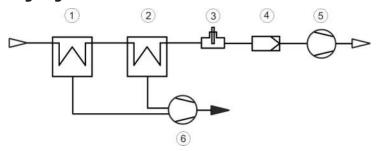

1 Échangeur de chaleur 2 /refroidissement préalable	4 Filtre (en option)
2 Échangeur de chaleur 1/refroidissement subséquent	5 Pompe pour gaz de mesure (en option)
3 Capteur d'humidité (en option)	6 Pompe de condensat (en option)

Les entrées de gaz sont identifiées en rouge.

Dans le cas d'échangeurs de chaleur en verre, il est nécessaire de faire attention au bon positionnement du joint d'étanchéité lors du raccordement des conduites de gaz (voir illustration). Le joint se compose d'un anneau en silicone avec une face en PTFE. Le côté en PTFE doit être orienté vers le filetage en verre.



Dans le cas d'échangeurs thermiques en acier inoxydable, il convient de tenir compte de l'ouverture de clé compatible avec la sélection de raccords vissés.

Raccordements de gaz PTS/PTS-I: SW 14 ou 9/16

Vidange de condensat PTS/PTS-I: SW 22

4.2.6 Raccordement de dérivateur de condensat

Selon le matériau, il est nécessaire d'établir une conduite de raccordement entre l'échangeur thermique et le dérivateur de condensat en utilisant des raccords vissés et des tubes ou tuyaux. En cas d'acier inoxydable, il est possible d'accrocher le dérivateur de condensat directement sur le tube de raccordement. Pour les tuyaux, le dérivateur de condensat doit être attaché séparément à l'aide d'un collier de serrage.

Le dérivateur de condensat peut être directement fixé sur l'échangeur thermique.

Les conduites de condensat doivent en général être montées avec un inclinaison et une section nominale minimale de DN 6/8 (1/4").

BF440021 • 03/2024 Bühler Technologies GmbH

4.3 Raccordements électriques

L'exploitant doit installer pour l'appareil un dispositif de séparation externe étant attribué à cet appareil de manière reconnaissable.

Ce dispositif de séparation

- doit se trouver à proximité de l'appareil,
- doit être facilement accessible pour l'utilisateur,
- doit satisfaire aux normes IEC 60947-1 et IEC 60947-3,
- doit séparer tous les conducteurs de courant du raccordement d'alimentation et de la sortie d'état et
- ne doit pas être intégré dans la ligne d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Tension dangereuse



Le raccordement ne peut être entrepris que par des personnels formés et qualifiés.

ATTENTION

Tension erronée du réseau



Une tension de réseau erronée peut détruire l'appareil. Lors du raccordement, faire attention à ce que la tension du réseau soit correcte conformément à la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT

Haute tension



Endommagement de l'appareil lors du contrôle de l'isolation N'effectuez **pas de contrôle de rigidité diélectrique avec une haute tension** sur l'ensemble de l'appareil!

Essai de résistance diélectrique

Cet appareil est équipé de protections CEM importantes. Les contrôles nécessaires ont été effectués à l'usine (tension de test selon l'élément 2,1 kV ou 2,55 kV DC).

Si vous voulez effectuer vous-même encore une fois un contrôle de rigidité diélectrique, vous pouvez l'effectuer sur l'appareil entier. Vérifiez l'appareil uniquement avec les valeurs prédéterminées et avec la tension continue. Un contrôle de la rigidité diélectrique avec courant alternatif peut endommager les composants électroniques. La tension recommandée est de 2,1 kV DC, 2 s. Avant l'essai, retirez toutes les lignes d'alimentation de l'appareil. La tension peut être appliquée directement par l'intermédiaire du raccordement au réseau.


Raccordement via connecteur

L'appareil est équipé d'une fiche selon EN 175301-803 et destinée à l'alimentation en tension et à la sortie de signal. Elles doivent être placées de manière à éviter toute confusion lorsque le raccordement de conduite est correct. Pour cette raison, veillez à ce que les fiches soient de nouveau assemblées en conformité après le raccordement des conduites. Les affectations de raccordement sont indiquées comme suit, les numéros correspondant aux numéros sur les fiches :


Les sections de ligne doivent être ajustées au courant de mesure. Utilisez au maximum une section de câble de 1,5 mm² (AWG 16) et un diamètre de câble de 8 à 10 mm (0,31 - 0,39 pouces).

Des lignes de signaux blindées doivent être prévues pour le raccordement de la sortie analogique ou de l'interface numérique.


Numérotation de fiche




Raccordement secteur S1



Contact d'alarme S2



Sortie analogique S3



- 2 inoccupé

- 4 4-20 mA out
- 5 blindage

Sortie numérique S4



- 1 inoccupé
- 2 RS485 A
- 3 GND/Common
- 4 RS485 B
- 5 blindage

Les zones de serrage de S1 et S2 ont un diamètre de 8-10 mm (0,31 - 0,39 pouces).

4.4 Sorties de signal

L'appareil est équipé de différents signaux d'état. La capacité de commutation maximale des sorties d'alarme est de 250 V AC/ 150 V DC, 2 A, 50 VA chacune.

Une alarme est déclenchée par le biais du contact alarme/la sortie d'état (S2) lorsque la température dans le bloc 1 se situe en dehors des valeurs limites fixées. Il n'est cependant pas signalé si l'alarme a été déclenchée pour cause de sur-température ou de sous-température.

Description des sorties de signal

	Fonction/Type de contact	Description	
Vers S2)	contact inverseur interne :	deux sorties de commutation	Contact fermé entre 3 et 2 (alarme)
	max. 250 V AC/150 V DC, 2 A, 50 VA	permettent de signaler les états d'appareil suivants :	 Pas de tension secteur et/ou valeur réelle de température en dehors des seuils d'alerte définis
			Contact fermé entre 3 et 1 (ok)
			 Tension secteur appliquée + valeur réelle de température en dehors des seuils d'alerte définis
			Avec option signal de température
Vers S3)	4-20 mA sortie analogue	Signalisation de la tempéra-	$T_{refroidisseur} = -20 \degree C \triangleq (-4 \degree F) \rightarrow 4 \text{ mA/ 2V}$
	$(R_{charge} < 500 \Omega)$	ture réelle dans le bloc 1	Refroidisseur _T = 5 °C \triangleq (41 °F) -> 9 mA/4,5 V
			Refroidisseur _T = 60 °C \triangleq (140 °F) -> 20 mA/10 V
Vers S4)	Sortie numérique	Modbus RTU (RS-485)	Valeurs par défaut interface
			Vitesse de transmission en bauds – parité – bit d'arrêt :
			19200 – Even – 1
			ID par défaut : 10
			Les lignes de bus ne sont pas terminées en interne.

Le panneau avant du module d'affichage continent trois LED :

Couleur	Libellé	Fonction
Rouge	S2	Température excessive / insuffisante
		Défaillance de l'appareil
Jaune	S1	Réservé
Vert	OP	Fonctionnement normal

Les LED OP et S2 signalisent l'état de l'appareil analogue au S2.

Si l'option "signal de température" est intégrée, le signal pour la température réelle à la sortie analogue du refroidisseur est disponible.

Le signal de température peut être baissé via la fiche à encastrer (S3) avec le raccord M12x1. Ce connecteur se trouve à côté des raccordements de la sonde d'humidité sur la partie supérieure du refroidisseur.

La température affichée en continu sur le display (CH1) correspond à la température dans le bloc 1 (refroidissement subséquent). Le signal analogue de température correspond également à la température dans le bloc 1.

5 Fonctionnement et commande

INDICATION



L'appareil ne doit pas être exploité en dehors du cadre de ses spécifications!

Après mise en marche du refroidisseur, la température du bloc s'affiche (bloc 1). L'affichage clignote jusqu'à ce que la température de bloc ait atteint la valeur de consigne réglée (± la plage d'alarme réglable). Le contact d'état est en position d'alarme.

Si la plage de température de consigne est atteinte, la température est indiquée de manière permanente et le contact d'état commute.

Si, lors du fonctionnement, l'affichage clignote ou bien si un message d'erreur apparaît, veuillez consulter le chapitre « Recherche et élimination des pannes ».

Les données de performance et limites doivent être prises dans la fiche technique.

5.1 Description des fonctions

La commande du refroidisseur s'effectue via un microprocesseur. Le préréglage d'usine prend en compte les différentes caractéristiques des échangeurs de chaleur intégrés dès la commande.

L'écran programmable représente la température de bloc selon l'unité d'affichage sélectionnée (°C / °F) (°C en usine). 5 touches de commande de menu permettent d'actionner simplement les réglages individuels des applications. Cela concerne d'une part le point de rosée de consigne pouvant être réglé de 2° C (36 à 68 °F) à 20° C (réglage d'usine 5° C / 41° F).

D'autre part, les seuils d'alerte de sous-température et sur-température peuvent être réglés. Ceux-ci sont réglés par rapport au point de rosée réglé τ_a .

Pour la sous-température, une plage de T_a -1 jusqu'à - 3 K (au moins 1 °C / 34° F de température de bloc de refroidissement) est disponible, une plage de T_a +1 jusqu'à +7 K est disponible pour le réglage d'usine. Les réglages d'usine pour les deux valeurs sont 3 K.

Le clignotement de l'affichage et le relais d'état signalent un dépassement par le haut ou par le bas de la plage d'avertissement réglée (par ex. après allumage).

La sortie d'état peut par ex. être utilisée pour commander la pompe de gaz de mesure, afin de permettre d'enclencher le flux de gaz dès que la plage de refroidissement est atteinte ou pour éteindre la pompe si l'alarme du capteur d'humidité s'enclenche.

Le condensat collecté peut être évacué via des pompes péristaltiques ou le dérivateur de condensat automatique intégré.

De plus, il est également possible d'utiliser des filtres fins dans lesquels des capteurs d'humidité peuvent être intégrés, en option cependant.

La cloche en verre permet de voir les salissures de l'élément filtrant.

Le capteur d'humidité peut être démonté facilement. Cela peut être nécessaire si du condensat devait pénétrer dans le refroidisseur du fait d'une panne et ne pouvait plus être transporté par la pompe péristaltique, ou le dérivateur de condensat automatique.

Le TC-Double est équipé d'une autre étape de refroidissement qui est utilisée pour le pré-refroidissement du gaz (échangeur de chaleur 2), dont la température de bloc dépend de la température ambiante et de la charge. La valeur cible de l'étape de pré-re-froidissement correspond à celle du dem bloc 1.

BF440021 • 03/2024 Bühler Technologies GmbH

5.2 Utilisation des fonctions de menu

Explication courte du principe de commande :

La commande s'effectue au moyen de 5 touches. Elles possèdent les fonctions suivantes :

Touche	Plage	Fonctions
↓	Affichage	 Passage de l'affichage de la valeur mesurée au menu principal
ou	Menu	 Sélection du point de menu affiché
ок	Saisie	 Acceptation d'une valeur éditée ou d'une sélection
A	Affichage	– passage temporaire à un affichage de valeur de mesure alternative (si option disponible)
	Menu	- Défiler vers l'arrière
	Saisie	 Augmenter la valeur ou naviguer dans la sélection
		- valable ici :
		- Presser 1 fois la touche = modifier le paramètre / la valeur d'un incrément ;
		 Maintenir la touche pressée = déroulement rapide (uniquement pour les valeurs numériques)
		 L'affichage clignote : paramètre / valeur modifié(e)
		 L'affichage ne clignote pas : paramètre / valeur d'origine
V	Affichage	 passage temporaire à un affichage de valeur de mesure alternative (si option disponible)
•	Menu	– Défiler vers l'avant
	Saisie	Diminuer la valeur ou naviguer dans la sélection
ESC	Menu	- Revenir vers le niveau supérieur
	Saisie	- Revenir au menu
		Les modifications ne sont pas sauvegardées !
F		 Définition d'un menu favorisé.
ou		(remarque : Le menu favorisé est également appelé même en cas de verrouillage de menu
Func		actif!)

5.2.1 Verrouillage de menu

Afin d'éviter toute modification non intentionnelle des réglages de l'appareil, certains menus peuvent être verrouillés. Un code doit pour ceci être défini. Pour savoir comment mettre en place le verrouillage de menu voire l'annuler, consulter « Réglages globaux » dans le menu (ŁoP) au point de menu ŁoP > LCc.

Lors de la livraison, le verrouillage de menu **n'est pas** actif et tous les points de menu sont accessibles.

En cas de verrouillage de menu actif, uniquement les points de menu suivants sont visibles si le code correct n'a pas été saisi :

Point de menu	Explication
toP > uni t	Sélection de l'unité de température affichée (°C ou °F).
F ou Func.	Accès au menu favorisé
	INDICATION! Ce menu peut provenir du domaine normalement verrouillé.

5.2.2 Vue d'ensemble de guidage de menu

Si vous pressez le touche **OK** en fonctionnement normal, la demande de saisie **LodE** apparait sur l'afficheur en cas de verrouillage de menu actif. Saisissez le code correct au moyen des touches **△** et **▼** et pressez **OK**.

En cas de saisie erronée ou en cas de non saisie, le verrouillage de menu n'est pas levé et vous n'avez pas accès à tous les points de menu.


Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez accéder à tout moment au menu à l'aide du code maître 287 et le verrouillage de menu est désactivé.

La vue d'ensemble de la structure de menu est présentée sur la figure suivante.

Les points entourés en pointillés ne sont affichés que si les réglages correspondants ont été effectués, voire uniquement si des messages d'état sont présents.

Les réglages en usine standards et les plages de réglage sont indiqués dans la vue d'ensemble ainsi qu'au point de menu respectif. Les réglages en usine standards sont valables tant qu'aucune autre décision n'a été prise.

Vous pouvez interrompre les saisies et la sélection de menu, sans sauvegarde, à l'aide de la touche ESC.

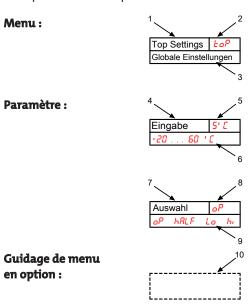

- 1. Désignation de menu
- 2. Affichage
- 3. Explication brève
- 4. Saisie d'une valeur
- 5. Réglages d'usine
- 6. Plage de paramètres
- 7. Sélection dans une liste de valeurs
- 8. Réglages d'usine
- 9. Plage de paramètres / Sélection
- 10. boîte hachurée = option

BF440021 ° 03/2024

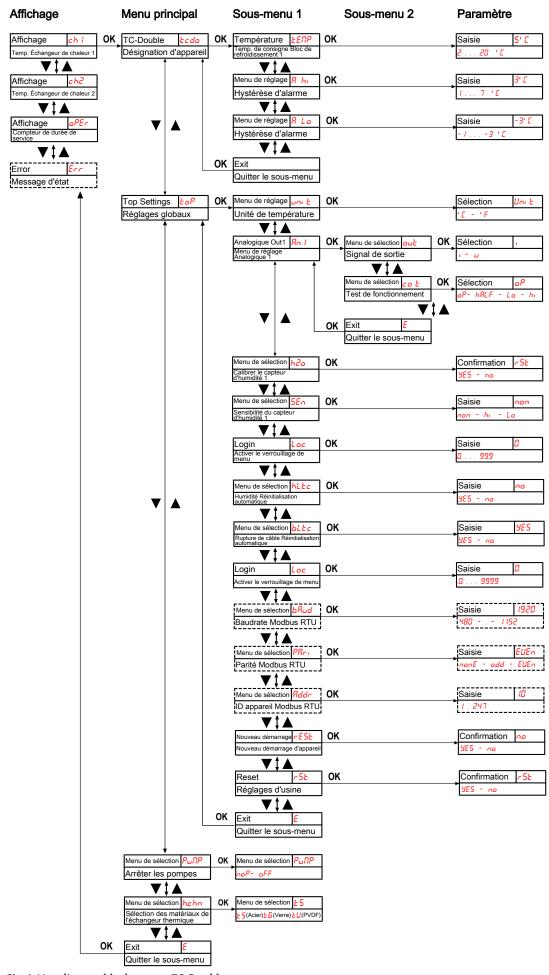


Fig. 1: Vue d'ensemble du menu TC-Double

5.3 Description des fonctions de menu

5.3.1 Menu d'affichage

Affichage de la température de bloc

Affichage → ch !



En fonction de l'état de l'appareil, la température est constante, cliqnotante ou affichée en alternance avec un message d'état.

Affichage des valeurs mesurées étape de pré-refroidissement

Affichage → ch2



En fonction de l'état de l'appareil, la température est constante, clignotante ou affichée en alternance avec un message d'état.

Affichage des heures de fonctionnement de l'appareil/de la durée de vie de l'appareil

Affichage → oPEr



Affichage des heures de fonctionnement de l'appareil. La durée de vie de l'appareil ne peut pas être réinitialisée et elle peut être exprimée dans différents formats d'affichage. Pour afficher/quitter l'affichage de l'heure d'exécution, appuyer sur la touche « Enter ».

- Représentation en années et en mois (par défaut)
- Représentation en mois
- L'EEh Représentation en semaines
- dRY5 Représentation en jours
- Un mois correspond à une durée de 30 jours. Appuyer sur la touche « F » pour passer d'une forme de présentation à l'autre. Dans l'affichage, le format sélectionné est d'abord lisible sous forme de texte court, puis la durée.

Indication de code d'erreur

Affichage $\rightarrow Err$



Si des défauts/défaillances hors service apparaissent, le numéro de défaut affiché indique les causes possibles et les mesures d'intervention.

5.3.2 Menu principal

Refroidisseur Peltier TC-Double

Visualisation → Łcdo



On accède à partir d'ici au réglage de la température de consigne du refroidisseur et de la plage de tolérance (seuil d'alarme).

Réglage global

Affichage $\rightarrow LoP$ (ToP Settings)



Les réglages globaux pour le refroidisseur sont effectués dans ce menu.

Pompe péristaltique

Affichage → Pu∏P



Allumage et extinction de la pompe péristaltique.

Plage de paramètres : noP, oFF

Réglages d'usine :

Remarque: Le statut bascule, « Pull? » clignote.

Sélection des matériaux de l'échangeur thermique

Affichage → hchn



Sélection des matériaux de l'échangeur thermique

Plage de paramètres : £5 (Acier), £6 (Verre), £11 (PVDF)

Réglages d'usine : £5 (refroidisseur sans échangeur thermique), ou tout matériau selon la configuration

Exit menu principal

Affichage $\rightarrow E$



Cette sélection permet de revenir au mode d'affichage.

5.3.3 Sous-menu 1

Température de consigne

Affichage \rightarrow Refroidisseur \rightarrow **LETIP**

8.8.8.8

Ce réglage fixe la valeur de consigne pour la température de refroidissement.

Plage de paramètres : de 2 °C à 20 °C (de 35,6 °F à 68 °F)

Réglages d'usine : 5 °C (41 °F)

Remarque : Lors d'une température modifiée, l'affichage clignote le cas échéant, jusqu'à ce que la nouvelle zone

de travail soit atteinte.

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de touche actif.

seuil d'alarme supérieur

Affichage \rightarrow Refroidisseur $\rightarrow R H$ (Alarm high)

La va

La valeur-seuil supérieure pour l'alarme optique et pour le relais d'alarme peut être réglée ici. Le seuil d'alarme est réglé en se basant sur la température de refroidissement déterminée.

Plage de paramètres : $de 1 ^{\circ}C à 7 ^{\circ}C (de 1,8 ^{\circ}F à 12,6 ^{\circ}F)$

Réglages d'usine : 3 °C (5,4 °F)

Remarque: Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de touche actif.

seuil d'alarme inférieur

Affichage \rightarrow Refroidisseur $\rightarrow R$ Lo (Alarm low)



La valeur-seuil inférieure d'alarme pour l'alarme optique ainsi que pour le relais d'alarme peut être réglée ici. Le seuil d'alarme est réglé en se basant sur la température de refroidissement déterminée.

Plage de paramètres :

de -1 °C à -3 °C (de -1,8 °F à -5,4 °F)

Réglages d'usine :

-3 °C (-5.4 °F)

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de touche actif.

Exit sous-menu 1

Affichage \rightarrow Sous-menu \rightarrow $\stackrel{\mathcal{E}}{=}$



En sélectionnant, on revient au menu principal.

5.3.4 Sous-menu 1 (réglages globaux)

Unité de température

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow Uov L$



L'unité d'affichage de température peut être sélectionnée ici.

Plage de paramètres :

' [, ' F

Réglages d'usine :

' [

Sortie analogique

Affichage $\rightarrow E_0P \rightarrow R_0 I$



Dans ce sous-menu sont définis les réglages de la sortie analogique 1, voir chapitre Sous-menu 2 (sortie analogique 1)

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Étalonner le capteur d'humidité

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow hZo$



Lorsque les capteurs d'humidité sont installés, il est ici possible d'effectuer le calibrage. À cet effet, l'appareil doit être rincé au gaz sec.

Remarque:

En usine, le calibrage a été effectué avec l'air ambiant. Il est nécessaire de renouveler le calibrage après avoir remplacé le capteur d'humidité.

Le calibrage du capteur d'humidité paramètre le menu 5En sur h.

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Sensibilité Capteur d'humidité

Affichage $\rightarrow \underline{\&oP} \rightarrow \underline{SEn}$



Lorsque les capteurs d'humidité sont installés, il est ici possible de réduire la sensibilité du capteur d'humidité.

Plage de paramètres :

h: : sensibilité élevée Lo: sensibilité faible

non: pas de capteur d'humidité

Réglages d'usine:

hi

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Capteur d'humidité : réinitialisation manuelle ou automatique après pénétration d'humidité

Affichage $\rightarrow \underline{loP} \rightarrow \underline{hLLc}$

(hLEc = humidity latch). Le réglage vaut pour tous les capteurs d'humidité connectés.

	Finalisation pour décider si le message pour pénétration d'humidité doit être réinitialisé manuelle- ment ou bien réinitialisé automatiquement après séchage du capteur.
Plage de paramètres :	YE5: L'état est signalé jusqu'au nouveau démarrage d'appareil par l'utilisateur, les pompes sont désactivées. no: Le message d'état est réinitialisé automatiquement/les pompes sont validées dès qu'aucune humidité n'est détectée.
Réglages d'usine :	no
Indication :	Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Capteur d'humidité : réinitialisation automatique après rupture de câble

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow bLLc$

(blbc = broken wire latch). Le réglage vaut pour tous les capteurs d'humidité connectés.

8.8.8.	Finalisation pour décider si l'alarme pour rupture de câble doit être réinitialisée manuellement ou bien s'éteint d'elle-même en cas de signal de mesure valable.
Plage de paramètres :	YES: L'état est signalé jusqu'au nouveau démarrage d'appareil/l'acquittement de l'erreur par l'utilisateur, les pompes sont désactivées. no: Le message d'état s'éteint/les pompes sont de nouveau validées dès que le capteur d'humidité est de nouveau reconnu.
Réglages d'usine :	YES
Indication :	Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Verrouillage de menu

Si vous souhaitez protéger le menu contre un accès non autorisé, saisissez ici une valeur pour le code de verrouillage. Certains points de menu sont ainsi accessibles seulement après la saisie du code correct.

Ce réglage permet de désactiver voire d'activer le verrouillage de menu.

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow LOC$

Plage de paramètres :	de 0 à 9999
Réglages d'usine :	0 (verrouillage de touches désactivé)
Indication :	Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Vitesse de transmission en bauds Modbus RTU

Le débit de transfert standard est de 19200 bps. Dans les limites définies, il peut être adapté à chaque application. Les options du présentoir sont indiquées en kbps (19.2 correspond à 19200 bps). Les caractéristiques de l'interface numérique ne sont pas affectées par la réinitialisation de l'appareil aux réglages d'usine!

Ce menu n'est disponible que pour les périphériques avec l'option « Digital Output Modbus RTU ».

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow bRud$

8.8.8.

Détermination du débit de transmission de l'interface numérique.

Plage de paramètres :

1.15.2

Réglages d'usine :

1920

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Parité Modbus RTU

La parité par défaut est pair/even, impaire ou pas de parité sont sélectionnables. Le nombre de bits d'arrêt est réglé automatiquement en fonction des paramètres respectifs. Si aucune parité n'est définie, deux bits d'arrêt sont utilisés, sinon un seul. Les caractéristiques de l'interface numérique ne sont pas affectées par la réinitialisation de l'appareil aux réglages d'usine!

Ce menu n'est disponible que pour les périphériques avec l'option « Digital Output Modbus RTU ».

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow PRc_{i}$

8.8.8.

Ce réglage permet de rétablir les réglages d'usine.

Plage de paramètres :

nonE odd

EUEn

Réglages d'usine :

EUEn

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Modbus RTU ID appareils

Sélection de l'identifiant de périphérique pour la communication via l'interface numérique. L'identifiant peut être choisi dans les limites définies, la valeur par défaut est 10. Les caractéristiques de l'interface numérique ne sont pas affectées par la réinitialisation de l'appareil aux réglages d'usine!

Ce menu n'est disponible que pour les périphériques avec l'option « Digital Output Modbus RTU ».

8888

Détermination de l'identifiant.

Plage de paramètres :

1.247

Réglages d'usine :

10

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

BF440021 ° 03/2024

nouveau démarrage

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow rE5L$

(*-E5L* = restart)



L'appareil effectue un nouveau démarrage, tous les paramétrages sont conservés. Tous les messages d'erreur sont réinitialisés.

Le capteur d'humidité est réinitialisé indépendamment des réglages effectués dans les menus $\frac{1}{N}$ Le et $\frac{1}{N}$ $\frac{1}{N}$.

Plage de paramètres :

YES: Exécution du nouveau démarrage. L'écran indique les versions de logiciel de l'appareil et revient à l'affichage de valeur de mesure.

no: Quitter le menu sans nouveau démarrage.

Indication: Les paramétrages d'utilisateur sont conservés.

Réglages d'usine

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow rSL$



Ce réglage permet de rétablir les réglages d'usine.

Plage de paramètres :

YE5 : rétablissement des réglages d'usine. **no** : Quitter le menu sans modifications.

Réglages d'usine :

no

Remarque:

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Exit sous-menu 1

Affichage \rightarrow Sous-menu \rightarrow \cancel{E}



En sélectionnant, on revient au menu principal.

5.3.4.1 Sous-menu 2 (sortie analogique 1)

La température réelle du refroidisseur est indiquée à la sortie analogique. Ce menu n'est disponible que pour les périphériques avec l'option « Digital Output Modbus RTU ».

Comportement de signal

En mode de fonctionnement normal (nDP), la température réelle est indiquée à l'endroit de mesure. À des fins de test, les valeurs constantes H, , Lo ou HRLF peuvent être générées. Dans ce cas, un signal analogique est produit à la sortie analogique dont la valeur est indiquée dans le tableau.

Constante	Sortie de courant 4 – 20 mA	Sortie de tension 2 − 10 V	
hi	20 mA	10 V	
Π,	12 mA	6 V	
Lo	4 mA	2 V	
noP	4 – 20 mA	2 – 10 V	

Après le test, replacer impérativement le comportement de signal en fonctionnement normal (noP).

Anzeige $\rightarrow LoP \rightarrow Rol \rightarrow cout$



Ce réglage permet de décider comment se comporte la sortie analogique.

Plage de paramètres :	ooP = Operation (fonctionnement normal), h, , Lo, hALF
Réglages d'usine :	noP
Indication :	Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de menu actif.

Sélection -> Signal de sortie

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow Rol \rightarrow out$



Sélection du type de signal de sortie.

Plage de paramètres : , Sortie d'état 4... 20 mA

Sortie d'état 2... 10 V

Réglages d'usine :

Remarque : Débrancher l'appareil de mesure avant la reconversion !

Ce sous-menu n'est pas visible en cas de verrouillage de touche actif.

Exit sous-menu 2

Affichage $\rightarrow LoP \rightarrow Rol \rightarrow E$



En sélectionnant, on revient au sous-menu 1.

5.3.5 Définir le menu favorisé

La touche **F** voire **Func** (touche de fonction) vous permet de définir un menu favorisé auquel vous pourrez accéder plus tard par une seule pression de touche.

- Affichez le menu que vous souhaitez définir comme favori. Le fait que ce menu puisse être ou non verrouillé n'a aucune d'importance.
- Pressez la touche de fonction pendant plus de 3 s.
 Le menu actuel est défini comme favori. Le message Func apparaît brièvement sur l'afficheur.
- Revenez à l'affichage avec **ESC** ou **E** (Exit).

Si vous souhaitez maintenant afficher le menu favorisé, pressez le touche F voire Func.

INDICATION! Le menu favorisé est également accessible en cas de verrouillage de menu.

5.4 Utilisation de l'interface numérique

Concernant l'interface numérique de l'appareil, il s'agit d'un protocole Modbus RTU communiquant physiquement via RS485 (2 fils). Le refroidisseur joue le rôle de l'esclave dans la communication.

L'interface Modbus permet l'accès direct aux données de processus et de diagnostic ainsi que le paramétrage en cours de fonctionnement.

5.5 Configuration Modbus

Les réglages mentionnés ci-dessous correspondent au réglage standard. En cas d'interface active, les paramètres peuvent être ajustés.

1 bit de départ

8 bits de données

1 bit de parité (configurable)

1 bit d'arrêt (*)

Vitesse de transmission en bauds : 19200 bps (configurable)

ID d'appareil: 10 (configurable)

(*) La longueur d'un Modbus Frame comprend toujours 11 bits. Si l'interface est configurée avec 0 bit de données, le nombre de bits d'arrêt passe automatiquement à 2.

BF440021 • 03/2024

5.6 Communication Modbus

Une communication via Modbus RTU est toujours initiée par le maître (Request). L'esclave répond (en général) par une Response à la Request. Une Modbus RTU Frame pour une Request/Response a toujours la configuration suivante :

Champ d'adresse (A)	Code de fonction (FC)	Données (Data)	CRC
1 octet	1 octet	1 252 octets	2 octets

Les adresses de registre et les données sont transférées au format Big Endian.

Chaque registre représente une valeur 16 bits, l'information étant représentée dans différents types de données. Le type de données et le code de fonction nécessaire sont attribués aux registres respectifs dans les tableaux suivants.

Concernant la lecture/l'écriture de types de données dont le volume dépasse celle d'un registre individuel, plusieurs registres doivent être contactés.

Codes de fonction acceptés :

Code de fonction (FC)	Valeurs FC
Read Holding Registers	3
Write Multiple Registers	16

Types de données :

Désignation	Nombre d'octets	Nombre de registres	
Float	4	2	
Int16	2	1	
Uint16	2	1	
Int32	4	2	
Uint32	4	2	

5.7 Registre Modbus

Description	FC	Adresse	Accès	Type de données	Défaut	Min	Max	Sélection	Résolu- tion	Unité
Valeur de mesure de température de bloc	3	2000	R	Float	-	-	-	-	0,5	°C
État de température de bloc	3	2002	R	Uint32	-	-	-	Bit 0 := défaillance Bit 1. 15 := réservé Bit 16 := capteur non étalonné Bit 17 := initialisation/mesure non valable Bit 18 := phase transitoire Bit 19 := limite de charge atteinte Bit 20 := valeur mesurée en dehors de la plage de consigne	-	-
Valeur de mesure étape de pré-réfrigération	3	2004	R	Float				Bit 21. 31 : = inoccupé	0,5	°C
État étape de pré-réfrigération	3	2004	R	Uint32	-	-	-	Bit 0 := défaillance Bit 1. 15 := réservé Bit 16 := capteur non étalonné Bit 17 := initialisation/mesure non valable Bit 18 := phase transitoire Bit 19 := limite de charge atteinte Bit 20 := Bit 21. 31 := inoccupé	-	-
Valeur de consigne de température de bloc	3, 16	5000	R/W	Float	5,0	3,0	20,0	-	0,5	°C
Tolérance d'alarme positive Valeur de consigne	3, 16	5002	R/W	Float	3,0	1,0	7,0	-	1,0	K
Tolérance d'alarme négative Valeur de consigne	3, 16	5004	R/W	Float	- 3,0	- 3,0	- 1,0	-	1,0	K
Mémoire de signal erreur capteur d'humidité	3, 16	9002	R/W	Uint16	2	-	-	1 : = non 2 : = oui	-	-
Mémoire de signal alarme d'humidité	3, 16	9003	R/W	Uint16	1	-	-	1 : = non 2 : = oui	-	-
Sensibilité Capteur d'humidité 1	3, 16	9004	R/W	Uint16	1 (avec FF 2 (sans FF	•	-	0 : = Sensibilité faible 1 : = Sensibilité haute 2 : = Capteur d'humidité inactif	-	-
Sensibilité Capteur d'humidité 2	3, 16	9005	R/W	Uint16	1 (avec FF 2 (sans FF	•	-	0 : = Sensibilité faible 1 : = Sensibilité haute 2 : = Capteur d'humidité inactif	-	-
Sélection de l'unité d'affichage	3, 16	9006	R/W	Uint16	1	-	-	1:= °C 2:= °F	-	-

Série TC-Double

Description	FC	Adresse	Accès	Type de données	Défaut	Min	Max	Sélection	Résolu- tion	Unité
Sélection du type d'échangeur de chaleur	3, 16	9007	R/W	Uint16	2	-	-	2 := acier 3 := verre 4 := PVDF	-	-
Désactivation/activation de la (des) pompe(s) à condensat	3, 16	9008	R/W	Uint16	3	-	-	3 : = pompe active 4 : = pompe inactive	-	-
Modbus : Sélection de vitesse de transmission en bauds	3, 16	9009	R/W	Uint16	3	-	-	1 : = 4800 2 : = 9600 3 : = 19200 4 : = 38400 5 : = 57600 6 : = 115200	-	_
Modbus : Sélection de parité	3, 16	9010	R/W	Uint16	2	-	-	0 : = sans 1 : = impair 2 : = pair	-	-
Modbus : Sélection d'adresse d'appareil	3, 16	9011	R/W	Uint16	10	1	247	-	1	-
Verrouillage de menu	3, 16	9012	R/W	Uint16	0	0	9999	-	1	-
TEST	3	9990	R	Uint32	12648430	-	-	-	1	-
TEST_UINT16	3, 16	9992	R/W	Uint16	206	0	65535	-	1	-
TEST_INT16	3, 16	9993	R/W	Int16	- 206	- 32768	32767	-	1	-
TEST_UINT32	3, 16	9994	R/W	Uint32	2766	0	4294967 295	-	1	-
TEST_INT32	3, 16	9996	R/W	Int32	- 2766	0x8000000 0	0x7fffffff	f-	1	-
TEST_Float	3, 16	9998	R/W	Float	- 10,5			-	-	-
Vue d'ensemble de registre d'état	3	10000	R	Uint16	0			Bit 0 : = informations état sur registre 10001 Bit n : = informations état sur registre 10000 + n + 1	-	-
Registre d'état 1	3	10001	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 : = état de l'appareil Bit 1 : = appareil dans l'état d'erreur Bit 2 : = plage de température de consigne dépassée Bit 3 : = plage de température de consigne inférieure à 4 : = bit 5 : = bit 6 : = capteur d'humidité 1 connecté Bit 7 : = capteur d'humidité 2 connecté		-
Registre d'état 2	3	10002	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 : = Bit 1 : = Bit 2 : = Phase d'initialisation Bit 3 : =	-	-

7 4 0 0	Description	FC	Adresse	Accès	Type de données	Défaut	Min	Max	Sélection	Résolu- tion	Unité
0001									Bit 4 : = Bit 5 : = Bit 6 : = FF1 Alarme d'humidité Bit 7 : = FF2 Alarme d'humidité		
	Registre d'état 3	3	10003	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 := Pompe péristaltique désactivée Bit 1 := Bit 2 := Bit 3 := Bit 4 := Bit 5 := Bit 6 := Commande de la pompe à gaz désactivée Bit 7 :=	-	-
	Registre d'état 4	3	10004	R	Uint16	0	-	-		-	-
	Registre d'erreur 1	3	10005	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 := erreur de communication Affichage Bit 1 := erreur de communication Contrôleur Bit 2 := erreur de communication panneau de contrôle 2 bit 3 := erreur de configuration Contrôleur Bit 4 := erreur Contrôleur EEPROM Bit 5 := erreur ventilateur bit 6 := bit 7 := erreur générale de logiciel	-	-
	Registre d'erreur 2	3	10006	R	Uint16	0	-	-		-	-
,	Registre d'erreur 3 – capteur d'humidité 1	3	10007	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 := Bit 1 := Bit 2 := rupture de câble Bit 3 := Bit 4 := Bit 5 := Bit 6 := Bit 7 :=	-	-
	Registre d'erreur 4 – capteur d'humidité 2	3	10008		Uint16	0	-	-	Bit 0 := Bit 1 := Bit 2 := rupture de câble Bit 3 := Bit 4 := Bit 5 := Bit 6 := Bit 7 :=	-	-

	1	١		5
	1	ľ		_
	:			•
	:			•
	(r	l)
	•			
	٠			
	ı	٢	Į	٥
	i	٢		١
	•			5
	:			
	١	ζ		
	٠			
	۹	ζ)
ι	4	ľ		١
	١			
	ı	٢	Ī	
	Í	Ų	i	١
	ı			
	•			
	٠			
	:			_
	1	į)
			1	Ī
	١	L	j	ι
	ì	ŕ		
	١	۰		

Description	FC	Adresse	Accès	Type de données	Défaut	Min	Max	Sélection	Résolu- tion	Unité
Registre d'erreur 5 - PT100.1	3	10009	R	Uint16	0	-	-	Bit 0 := erreur générale Bit 1 := court-circuit/sous- température Bit 2 := rupture de câble/surchauffe Bit 3 := variation de la valeur mesurée Bit 4 := bit 5 := bit 6 := bit 7 :=	-	-
Registre d'erreur 6- PT100.2	3	10010	R	Uint16	0	-	-		-	-
Registre d'erreur 7	3	10011	R	Uint16	0	-	-	-	-	-
Registre d'erreur 8	3	10012	R	Uint16	0	-	-	-	-	-
Registre d'erreur 9	3	10013	R	Uint16	0	-	-	-	-	-
Registre d'erreur 10	3	10014	R	Uint16	0	-	-	-	-	-
Charge de régulateur 1	3	10017	R	Unit16	-	0	100	-	10	%
Charge régulateur 2	3		R	Unit16	-	0	100	-	10	%
Durée de fonctionnement d'appareil	3	10100	R	Float	-	0	-	-	6 min	h
Nouveau démarrage d'appareil/ Réinitialisation d'appareil	16	11000	W	Unit16	0x00	-	-	86 : = Nouveau démarrage d'appareil 17 : = réinitialisation aux réglages d'usine	-	-
Réinitialisation Capteur d'humidité 1	16	11002	W	Uint16	170	-	-	-	-	-

Exemple:

Registre 5000 = 0x1388

Lecture de la valeur de consigne de la température de bloc

	A	FC	Registre de départ HI	Registre de départ LO	Nombre de registres HI	Nombre de registres LO		CRC	CRC
Request	0x0A (10)	0x03 (3)	0x13	0x88	0x00 (0)	0x02 (2)		0x41	0xDE
	A	FC	Nombre d'octets	DATA 3	DATA 2	DATA 1	Data 0	CRC	CRC
Response	0x0A (10)	0x03 (3)	0x04	0x40	0xA0	0x00	0x00	0x55	0x11

6 Entretien

Aucun travail de maintenance spécial n'est nécessaire sur le refroidisseur dans sa version de base.

Différentes options peuvent être inclues selon le type de refroidisseur. Dans ce cas-ci, les travaux de maintenance suivants doivent être effectués à intervalles réguliers :

- Option Pompe péristaltique : Vérification des tuyaux (voir chapitre Changer le tuyau de la pompe péristaltique (option) [> page 35])
- Option filtre: Vérification du l'élément du filtre (voir chapitre Changement de l'élément de filtre (option) [> page 36])
- Option Capteur d'humidité : Calibrage du capteur d'humidité (voir chapitre Calibrage du capteur d'humidité (option) [> page 36])
- Option Pompe pour gaz de mesure : Vérifier que les soupapes ne sont pas encrassées. Après 500 heures de fonctionnement, les vis de la baque de fixation sont à resserrer à 3 Nm. (voir chapitre Changement des valves d'admission et des soupapes d'échappement de la pompe pour gaz de mesure (en option) [> page 37])

Lors de toute opération de maintenance, respecter les points suivants :

- L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.
- Effectuez seulement les travaux de maintenance décrits dans ces instructions de commande et d'installation.
- Lorsque vous effectuez des travaux de maintenance de toute sorte, respectez les dispositions de sécurité et d'exploitation.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales.

DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution




- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



DANGER

Gaz/condensats toxiques et irritants

Le gaz de mesure/les condensats peuvent être nocifs pour la santé.





- b) Coupez l'arrivée de gaz lors de tous travaux d'entretien et de réparation.
- c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz/condensats toxiques/irritants. Portez l'équipement de protection approprié.







BF440021 ° 03/2024

7 Entretien et réparation

Si une panne se produit en fonctionnement, vous trouverez dans ce chapitre des indications de détection et de résolution.

Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à notre service :

Tél.: +49-(0)2102-498955 ou votre représentant compétent

Vous trouverez de plus amples informations sur nos services de maintenance et de mise en service sous https://www.buehler-technologies.com/service.

Si le fonctionnement n'est pas correct après l'élimination d'éventuelles perturbations et après la mise sous tension, l'appareil doit être vérifié par le fabricant. À cet effet, veuillez expédier l'appareil dans un emballage approprié à :

Bühler Technologies GmbH

- Réparation/Maintenance -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Allemagne

Ajoutez en outre à l'emballage la déclaration de décontamination RMA remplie et signée. Dans le cas contraire, il nous sera impossible de traiter votre demande de réparation.

Le formulaire se trouve en annexe à ce mode d'emploi. Il peut également être demandé par courriel :

service@buehler-technologies.com.

7.1 Recherche de panne et résolution

Problème/Défaillance	Cause possible	Assistance
Condensat dans la sortie de	 Récipient collecteur de condensat plein 	 Vider le récipient collecteur de condensat
gaz	 Valve éventuellement bloquée dans le pur- geur de condensat automatique 	 Rincer dans les deux directions
	 Refroidisseur surchargé 	 Respecter les paramètres limites
Débit de gaz diminué	 Voies de gaz bouchées 	Démonter l'échangeur thermique et le net- toyer
		– le cas échéant, remplacer l'élément de filtre
	 Sortie de condensat gelée 	 Expédier l'appareil
Sur-température	- Point de fonctionnement pas encore atteint	Attendre (20 min max.)
	 Puissance de refroidissement trop faible, bien que le refroidisseur fonctionne 	 Faire particulièrement attention à ne pas cou- vrir les fentes d'aération (accumulation de chaleur)
	 Débit/point de rosée/température de gaz trop élevé(e) 	 Respecter les paramètres limites/Prévoir un séparateur primaire
	 Ventilateur intégré à l'arrêt 	 Vérifier et remplacer le cas échéant
Sous-température	 Régulation défectueuse 	 Expédier le refroidisseur
Défaillance Communication	 Raccord bus défaillant 	 Contrôler les raccordements électriques
Modbus	 Ligne de terminaison défectueuse 	– Contrôlez la ligne de bus
	 Contrôler la configuration de bus 	 Vérifier/réinitialiser la configuration

7.1.1 Messages d'erreur sur l'écran

Si une erreur apparaît, « Ecc. » est affiché sur l'écran. Le(s) numéro(s) d'erreur est/sont affiché(s) en pressant la touche « 📤 ».

Après détection de l'erreur, les messages d'erreur restent affichés tant que l'appareil n'est pas redémarré, ou que l'erreur soit acquittée en appuyant sur la touche « Func ». L'acquittement fonctionne uniquement lorsque les circonstances de l'erreur ne sont plus présentes.

Causes / Assistance : Dans la liste suivante sont indiquées les causes et mesures les plus probables pour les erreurs respectives. Si les mesures indiquées ne devaient pas vous aider, veuillez vous adresser à notre service.

Problème/Défaillance	Cause possible	Assistance					
Aucun affichage	 Aucune tension secteur Conduite de raccordement desserrée 	Vérifier la conduite d'alimentationVérifier le fusible					
	 Écran défectueux 	 Vérifier les raccordements 					
(en continu)	(La version logicielle de l'écran est affichée). – Pas de communication vers le régulateur	 Vérifier les raccordements 					
Error	 Une erreur est détectée 	 Lecture du numéro d'erreur comme décrit ci-dessus 					
Error 01	– Défaillance de régulateur	 Acquitter l'erreur (dysfonctionnement temporaire) Couper la tension d'alimentation électrique durant env. 5 s 					
		 Informer le service 					
8.8.8.	– Défaillance du régulateur 2	Acquitter l'erreur (dysfonctionnement temporaire)					
		 Couper la tension d'alimentation électrique du- rant env. 5 s 					
		Informer le service					
Error 03	 Défaillance de microcontrôleur/MCP2 	 Informer le service 					
Error 04	Erreur EEPROM	 Informer le service 					
8.8.8.8.	 Défaut du ventilateur/ventilateur hors service 	Vérifier ventilateur (bloqué ?)Vérifier raccordement					
Error 22	- Rupture de câble Capteur d'humidité 1	Contrôler la conduite du capteur d'humiditéContrôler le capteur d'humidité					
Error 32	 Rupture de câble Capteur d'humidité 2 	Contrôler la conduite du capteur d'humiditéContrôler le capteur d'humidité					
Error 40	 Erreur générale Capteur de température 1 (température de bloc) 	 Capteur possiblement défectueux 					
Error 41	 Sous-température/Court-circuit Capteur de température 1 	 Vérifier le raccordement du capteur de température 					
Error 42	 Sur-température/Court-circuit Capteur de température 1 	 Vérifier le raccordement du capteur de tempéra- ture 					
Error 43	 Fluctuation de la valeur mesurée Capteur de température 1 	 Vérifier le raccordement du capteur de tempéra- ture 					
Error 50	 Erreur générale Capteur de température 2 (température de bloc) 	 Capteur possiblement défectueux 					
Error 51	 Sous-température/Court-circuit Capteur de température 2 	 Vérifier le raccordement du capteur de tempéra- ture 					
Error 52	 Sur-température/Court-circuit Capteur de température 2 	 Vérifier le raccordement du capteur de tempéra- ture 					
Error 53	 Fluctuation de la valeur mesurée Capteur de température 2 	 Vérifier le raccordement du capteur de température 					

BF440021 · 03/2024 Bühler Technologies GmbH 33

Texte d'état	Cause possible	Assistance		
H2o.1	Alarme d'humidité Capteur d'humidité 1	SécherVérifier le récipient collecteur de condensat		
0.0.0.0. init	- Phase d'initialisation	– Attendre		
PuMP	 Pompes désactivées 	 Réactiver les pompes dans le menu 		
dt dt	 Uniquement lors d'une régulation active du Delta T : La température du bloc ne se trouve pas dans la plage de température définie. Le refroidisseur se trouve encore en « phase de démarrage ». Température ambiante variable Puissance de refroidissement non suffisante 	 Attendre de voir si la température cible est atteinte Contrôler la température ambiante /la puissance obtenue Selon le processus : adapter les seuils d'alarme 		
(clignote-ment)	– Sur-/Sous-température	 voir chapitre « Recherche de cause de panne et ré- solution » 		

7.2 Indications de sécurité

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un cadre extérieur à ses spécifications.
- Les réparations sur le matériel doivent être effectuées uniquement par des personnels autorisés de Bühler.
- Effectuez des travaux de modification, de montage ou d'entretien uniquement si ceux-ci sont décrits dans les instructions d'utilisation et d'installation.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

DANGER

Tension électrique

Danger d'électrocution



- a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.
- b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.
- c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.
- d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.



DANGER

Gaz/condensats toxiques et irritants

Le gaz de mesure/les condensats peuvent être nocifs pour la santé.





- b) Coupez l'arrivée de gaz lors de tous travaux d'entretien et de réparation.
- c) Lors des travaux d'entretien, protégez-vous des gaz/condensats toxiques/irritants.

 Portez l'équipement de protection approprié.







ATTENTION

Risque pour la santé en cas de non-étanchéité de l'échangeur de chaleur



L'échangeur de chaleur est rempli d'un agent de refroidissement à base de glycol. En cas de non-étanchéité de l'échangeur de chaleur :

- a) évitez tout contact avec la peau et les yeux.
- b) En cas de fuite de l'échangeur de chaleur, ne remettez pas le refroidisseur en marche. Le refroidisseur doit être réparé par le fabricant.

7.3 Nettoyage et démontage de l'échangeur de chaleur

Les échangeurs thermiques ne doivent être remplacés ou entretenus que s'ils sont bouchés ou abîmés. Dans le cas où ils se bouchent, nous recommandons de vérifier si ce problème peut être évité à l'avenir en utilisant un filtre.


- Couper l'alimentation de gaz.
- Éteindre l'appareil et débrancher toutes les fiches (p. ex. fiche de raccordement d'analyseur de sortie d'état, entrée d'alimentation etc.).
- Débrancher les raccords de gaz et l'écoulement du condensat.
- Tirer l'échangeur thermique vers le haut.
- Nettoyer le nid de refroidissement (trou dans le bloc de refroidissement), étant donné que les échangeurs thermiques sont utilisés avec de la graisse siliconée.
- Rincer l'échangeur thermique jusqu'à élimination complète des impuretés.
- Lubrifier l'échangeur thermique sur la surface extérieure refroidie à l'aide de graisse siliconée.
- Introduire de nouveau l'échangeur dans le nid de refroidissement en effectuant un mouvement de rotation.
- Rétablir les raccords de gaz et l'écoulement du condensat. L'entrée de gaz est marquée en rouge.
- Rétablir l'alimentation en tension/l'admission de gaz et attendre la disponibilité à fonctionner.
- Ouvrir l'admission de gaz.

7.4 Changement du fusible du refroidisseur de gaz de mesure

- Couper l'alimentation de gaz.
- Mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche d'alimentation.
- Le cas échéant détacher le capteur d'humidité du filtre ou de l'adaptateur.
- Desserrer les vis de fixation du capot.
- Retirer prudemment le capot. Le capot possède des composants qui font saillie vers l'intérieur et, le cas échéant, peuvent provoquer des dommages.

L'écran est fixé au capot et connecté à l'électronique sur le corps de base. La connexion par fiche peut être débranchée. Les pompes de circulation voire de condensat sont connectées à l'électronique. Les connexions ne peuvent pas être desserrées.

- Le fusible se trouve sur la platine sous un capuchon en plastique. Changer le fusible et remettre le capuchon en place. Prenez en compte la tension d'alimentation pour choisir le bon fusible fin.
- Rétablir la connexion par fiche de l'affichage et remettre le couvercle en place. Serrer les vis de fixation.
- Rétablir l'alimentation en tension ainsi que l'admission de gaz.

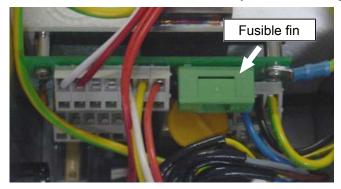

7.5 Changer le tuyau de la pompe péristaltique (option)

- Couper l'alimentation de gaz.
- Éteindre l'appareil et débrancher toutes les fiches (p. ex. fiche de raccordement de sortie d'alarme, entrée d'alimentation etc.).
- Retirer le tuyau d'alimentation et d'évacuation de la pompe péristaltique (respectezles indications de sécurité!).
- Desserrer la vis à tête moletée centrale sans la dévisser entièrement. Basculer la vis vers le bas
- Retirer le couvercle vers le haut.
- Extraire les raccords sur les côtés et retirer le tuyau.
- Remplacer le tuyau (pièce de rechange Bühler) et monter la pompe péristaltique dans l'ordre inverse.
- Rétablir l'alimentation en tension ainsi qu'en gaz.

7.6 Changement de l'élément de filtre (option)

ATTENTION

Émanations de gaz du filtre



Le filtre ne doit pas être sous pression lorsqu'il est démonté. Ne réutilisez pas les pièces ou joints toriques endommagés.

- Couper l'alimentation de gaz.
- Mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche d'alimentation.
- Tirer la bride tout en maintenant le verre de filtre.
- Tout en maintenant la tête de filtre et en effectuant de légers mouvements de va-et-vient, retirer le verre vers le bas.
- Retirer l'élément de filtre usagé puis en placer un nouveau.
- Vérifier le joint, le remplacer le cas échéant.
- Tout en maintenant la tête de filtre et en effectuant de légers mouvements de va-et-vient, emboîter la bride et veiller à une bonne assise.
- Rétablir l'alimentation en tension ainsi que l'admission de gaz.

INDICATION! Les réglementations légales pour la mise au rebut d'éléments de filtre doivent être respectées.

7.7 Séchage du capteur d'humidité (option)

Après une infiltration d'humidité, le capteur d'humidité doit être séché.

- Couper l'alimentation de gaz.
- Mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche d'alimentation.
- Desserrer l'écrou d'accouplement de la ligne de raccordement du capteur d'humidité et extraire la ligne.
- Tourner le capteur d'humidité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'extraire.
- Sécher le capteur d'humidité.
- Replacer le capteur d'humidité et serrer le vissage avec précautions.
- Emboîter la ligne de raccordement et serrer l'écrou d'accouplement.
- Rétablir l'alimentation en tension ainsi que l'admission de gaz.

7.8 Calibrage du capteur d'humidité (option)

- Lorsque les capteurs d'humidité ont été remplacés, il doivent être recalibrés.
- S'assurer que le gaz sec a été dirigé par le refroidisseur.
- Sélectionner et confirmer le menu du refroidisseur.



- Sélectionner le point du menu du capteur d'humidité.



- L'écran indique (Reset).
- En confirmant l'écran, le capteur d'humidité est calibré.

Un aperçu exact du guidage par menu se trouve dans le chapitre « Fonctionnement et maniement ».

7.9 Changement des valves d'admission et des soupapes d'échappement de la pompe pour gaz de mesure (en option)






Démontez tout d'abord les raccords à visser.

Extrayez la valve d'admission voire d'évacuation en la tournant au moyen d'un tournevis large et plat.

Attention : Dans le cas des corps de pompe PVDF et PVDF avec soupape by-pass, des bagues d'étanchéité PFTE sont intégrées dans les entrées et sorties de gaz. Elles sont également jointes à votre kit de pièces de rechange pour soupape. Retirez les bagues d'étanchéité usagées avant de mettre les neuves en place.

Les valves d'admission et d'évacuation sont identiques. Leur position de montage détermine leur fonctionnalité. Comme indiqué sur la figure, les valves sont bleues d'un côté et noires de l'autre. De plus, les valves sont caractérisées par « EIN » voire « IN » pour Admission et « AUS » voire « OUT » pour Évacuation.

Soupape d'admission




Concernant l'assemblage de la pompe pour gaz de mesure, effectuez les étapes dans l'ordre inverse. Lors du serrage des valves d'admission et d'évacuation, respectez impérativement le couple de vissage prescrit maximal de 1 Nm. **ATTENTION! Un serrage plus important des valves conduit à une déformation durable du corps de pompe, ce qui nécessiterait un remplacement.**


Lors de la mise en place des raccords à visser, veillez à l'étanchéité du raccord.


7.10 Remplacement du joint torique de soupape by-pass (en option)

- Desserrer les deux vis sur la plaque de soupape et extraire avec précaution la totalité de l'unité.
- Humidifier le nouveau joint torique avec une graisse pour joint torique appropriée (température d'utilisation continue minimum 145 °C, par exemple Fluoronox S90/2) et l'appliquer sur la broche.
- Introduire avec précaution la totalité de l'unité dans le carter de pompe et serrer les vis.

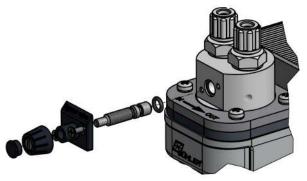

7.11 Changement du joint à soufflet (en option)





Pour changer le soufflet, dévissez-le avec précaution du coulisseau en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites attention à ne pas perdre les éventuelles rondelles d'ajustement.

Avant de remettre en place le soufflet, faites attention à ce que celui-ci ne présente aucun dégât.

Le montage se fait à la main en suivant les étapes en sens inverse.

7.12 Pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, nous vous demandons d'indiquer le type d'appareil et le numéro de série.

Vous pouvez trouver des ensembles de rééquipement et des ensembles supplémentaires dans notre catalogue.

Vous devriez avoir une réserve des pièces de rechanges suivantes :

Article n°	Désignation
9100100007	Module d'affichage MCD400
9100030265	Module d'interface Modbus RTU
9144050080	Câble de raccordement Module d'affichage de platine de régulateur, 400 mm
9144051038	Câble de connexion Module d'interface Modbus RTU
9144050091	Câble de raccordement Mainboards
9100130380	Platine de microcontrôleur MCP2.2
9100132380	Platine de microcontrôleur MCP2.2 ADON
4011000	Adaptateur de débit de type G, PVDF G1/4
40110001	Adaptateur de débit de type NPT, PVDF NPT 1/4"
4011005	Adaptateur de débit de type G, acier inoxydable, G 1/4
40110051	Adaptateur de débit de type NPT, acier inoxydable, NPT 14"
9110000013	Fusible à fil fin de refroidisseur de gaz de mesure 230 V, 5 x 20 mm, 2,5 A inertie
9110000031	Fusible à fil fin de refroidisseur de gaz de mesure 115 V, 5 x 20 mm, 5 A inertie
4111100	Capteur d'humidité FF-3-N, sans câble
9144050081	Capteur d'humidité Câble de raccordement, 300 mm
9144050082	Capteur d'humidité Câble de raccordement, 450 mm
449600062	Ventilateur, 12 V DC avec sortie d'état
9100010185	Circuit imprimé de réseau
9100011187	Module de contrôle
voir fiche de données 450020	Pompes péristaltiques CPdouble
voir fiche technique 450011	Pompe pour gaz de mesure P1.x

7.12.1 Consommables et accessoires

N° d'article	Désignation
4510008	Dérivateur de condensat automatique AK 5.2 (uniquement fonctionnement sous pression)
4510028	Dérivateur de condensat automatique AK 5.5 (uniquement fonctionnement sous pression)
4410004	Dérivateur de condensat automatique AK 20 (uniquement fonctionnement sous pression)
4410001	Dérivateur de condensat automatique 11 LD V 38 (uniquement fonctionnement sous pression)
41030050	Élément de rechange de filtre F2 ; VE 5 pièces
9144050038	Câble pour sortie analogique Température de refroidisseur 4 m
4410005	Récipient collecteur de condensat GL1, 0,4 l
44920035012	Tuyau de rechange pompe à condensat, Tygon (Norprene), raccord de tuyau coudé
44920035016	Tuyau de rechange pompe à condensat, Tygon (Norprene), raccord de tuyau coudé et vis (métriques)
44920035017	Tuyau de rechange pompe à condensat, Tygon (Norprene), raccord de tuyau coudé et vis (en pouces)
4228003	Joint à soufflet pour pompe P1
9009398	Joint torique pour pompe by-pass P1
4228066	Jeu de soupape d'entrée/de sortie 70 °C pour pompe P1

8 Mise au rebut

L'échangeur de chaleur contient un liquide de refroidissement à base de glycol.

Lors de la mise au rebut des produits, les prescriptions légales nationales respectivement applicables doivent être prises en compte et respectées. Aucun risque pour la santé et l'environnement ne doit résulter de la mise au rebut.

Le symbole de poubelle barrée sur roues apposé sur les produits de Bühler Technologies GmbH signale des consignes de mise au rebut particulières au sein de l'Union Européenne (UE) applicables aux produits électriques et électroniques.



Le symbole de poubelle barrée signale que les produits électriques et électroniques ainsi désignés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être éliminés de manière appropriée comme appareils électriques et électroniques.

Bühler Technologies GmbH s'occupe volontiers de la mise au rebut de votre appareil arborant ce sigle. Veuillez pour ceci envoyer votre appareil à l'adresse ci-dessous.

La loi nous oblige à protéger nos employés des risques causés par des appareils contaminés. Nous ne pouvons donc effectuer la mise au rebut de votre ancien appareil que si celui-ci ne contient pas d'agents de fonctionnement agressifs, corrosifs ou nocifs pour la santé et l'environnement. Nous vous prions donc de faire preuve de compréhension. Pour chaque appareil électrique et électronique usagé, il convient d'établir le formulaire « Formulaire RMA et déclaration de décontamination » disponible sur notre site Internet. Le formulaire rempli doit être apposé sur l'emballage de manière visible de l'extérieur.

Pour le retour d'appareils électriques et électroniques usagés, veuillez utiliser l'adresse suivante :

Bühler Technologies GmbH WEEE Harkortstr. 29 40880 Ratingen Allemagne

Tenez compte des règles en matière de protection de données et du fait que vous êtes responsable de l'absence de toute donnée personnelle sur les anciens appareils rapportés par vos soins. Assurez-vous donc de bien supprimer toute donnée personnelle lors de la restitution de votre appareil usagé.

9 Pièces jointes

9.1 Données techniques refroidisseur à gaz

Caractéristiques techniques du refroidisse	eur de gaz			
Disponibilité à fonctionner	après 10 minutes max.			
Température ambiante	de 5 °C à 60 °C			
Point de rosée de sortie de gaz préréglé : réglable :	5 °C 2 °C20 °C			
Type de protection	IP 20			
Boîtier	Acier inoxydable, b	rossé		
Dimensions d'emballage	env. 427 x 300 x 293	3 mm		
Poids incl. échangeur thermique	env. 11,5 kg env. 15 kg pour une phase de développement complète			
Données électriques	Appareil sans extension		Appareil avec extension (pompe péristaltique + pompe à gaz)	
	230 V AC	115 V AC	230 V AC	115 V AC
	+ 5/- 10 %	+ 5/- 10 %	+- 5 %	+- 5 %
	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz
	1,6 A	3,2 A	2,1 A	4,1 A
	278 W/350 VA	296 W/370 VA	390 W/487 VA	377 W/472 VA
Puissance de commutation sortie d'état	max. 250 V AC, 150 V DC 2 A, 50 VA, hors tension			
Raccordements électriques	Fiche selon EN 175301- 803			
Raccordements de gaz	Échangeur thermique voir tableau « Vue d'ensemble des échangeurs thermiques » Filtre, adaptateur de capteur d'humidité, pompe à gaz, G1/4 ou NPT 1/4" voire tuyau ou tube métrique/pouces			
Éléments en contact avec les fluides Filtre : Capteur d'humidité : Échangeur thermique : Pompe péristaltique : Tubulure :	voir « Données techniques Options » voir « Données techniques Options » voir tableau « Vue d'ensemble des échangeurs thermiques » voir « Données techniques Options » PTFE/Viton			

9.2 Caractéristiques techniques options

Données techniques Sortie analogique Température du refroidisseur

Signal	4-20 mA voire 2-10 correspond à une température de refroidisseur de -20 °C à +60 °C
Raccordement	Ficher M12x1, DIN EN 61076-2-101

Données techniques Interface numérique

Signal	Modbus RTU (RS-485)
Raccordement	Ficher M12x1, DIN EN 61076-2-101

Données techniques Capteur d'humidité FF-3-N

Température ambiante	de 3°C à 50 °C
pression de service max. avec FF-3-N	2 bar
Matériau	PVDF, PTFE, résine époxy, acier inoxydable 1.4571, 1.4576

Caractéristiques techniques de pompe péristaltique Cpdouble

Température ambiante	de 0°C à 55 °C
Puissance de débit	0,3 l/h (50 Hz) / 0,36 l/h (60 Hz) avec tuyau standard
Entrée de vide	max. 0,8 bar
Pression d'entrée	max.1bar
Pression de sortie	1bar
Tuyau	4 x 1,6 mm
Type de protection	IP 44
Matériaux	
Tuyau :	Norprene (standard), Marprene, Fluran

Raccordements : PVDF

Caractéristiques techniques Pompe pour gaz de mesure P1


Température ambiante	de 0 °C à 50 °C
Pression de fonctionnement	max. 1,3 bar abs.
Débit de convoyage nominal	280 l/h (pour p = 1 bar abs.)
Matériaux en contact avec le fluide selon configuration	la PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Viton, PFA

Données techniques Filtre AGF-PV-30-F2

Température ambiante	de 3°C à 100 °C
pression de service max. avec filtre	4 bar
Surface de filtre	60 cm ²
Finesse de filtre	2 μm
Volume mort	57 ml
Matériau :	
Filtre:	PVDF, verre Duran (pièces en contact avec les fluides)
Joint:	Viton
Élément de filtre :	PTFE fritté

9.3 Schéma de procédé

Organigramme:

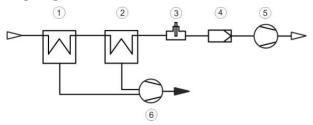


1 Échangeur de chaleur 2 /refroidissement préalable	4 Filtre (en option)
2 Échangeur de chaleur 1/refroidissement subséquent	5 Pompe pour gaz de mesure (en option)
3 Capteur d'humidité (en option)	6 Pompe de condensat (en option)

9.4 Courbes de puissance


Le TC-Double 6111 est conçu pour une température ambiante allant jusqu'à 40 °C. Une puissance de refroidissement suffisante est disponible avant d'atteindre cette température. Au contraire, le TC-Double 6112 est utilisable pour des températures plus élevées jusqu'à une température nominale de 60 °C. Veuillez respecter la puissance de refroidissement existante.


Type TC-Double 6111 320 Puissance de refroidissement (kJ/h) 280 240 200 160 120 80 40 0 10 25 30 35 Température ambiante (°C) TC-Double 6111 PTV en série PTS en série •••• PTG en série

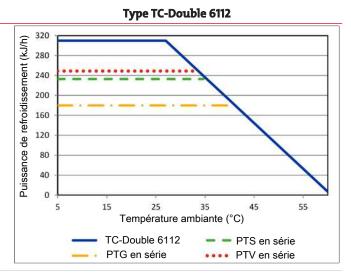

Remarque: Les courbes limites pour les échangeurs thermiques s'appliquent pour un point de rosée de 50 °C.

Le TC-Double+ 6111 est conçu pour des températures ambiantes allant jusqu'à 40 °C. Une puissance de refroidissement suffisante est disponible avant d'atteindre cette température. Le TC-Double+ 6112 au contraire est utilisé pour des températures plus élevées jusqu'à 60 °C nominal. Veuillez respecter la puissance de refroidissement existante.

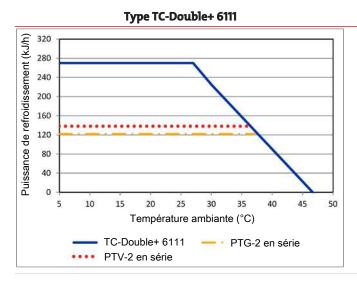

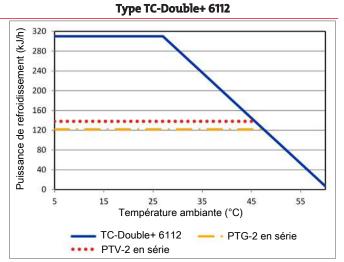

Remarque : Les courbes limites pour les échangeurs thermiques s'appliquent pour un point de rosée de 50 °C.

9.5 Échangeur thermique

9.5.1 Description échangeur de chaleur

L'énergie du gaz de mesure et en première approche la performance de refroidissement sollicitée Q est déterminée par les trois paramètres température de gaz ϑ_G , point de rosée τ_e (taux d'humidité) et débit v. Pour des raisons physiques, le point de rosée de sortie augmente avec l'énergie de gaz. Les limites suivantes pour le débit maximal sont déterminées pour un point de travail normé de τ_e = 50 °C et ϑ_G = 70 °C. Le débit maximal ν_{max} est indiqué en NI/h d'air refroidi, c'est-à-dire après la condensation de la vapeur d'eau. Les valeurs peuvent diverger pour les autres points de rosée et températures d'entrée de gaz. Les liens physiques sont cependant si nombreux qu'une représentation sera exclue. Si certains points ne sont pas clairs, veuillez nous consulter ou utiliser notre programme d'organisation.

9.5.2 Vue d'ensemble de l'échangeur thermique

TC-Double

Échangeur de chaleur	2x PTS 2x PTS-I ²⁾	2x PTG 2x PTG-I ²⁾	2x PTV 2x PTV-I ²⁾
Matériaux en contact avec les fluides	Acier inoxydable	Verre PTFE	PVDF
Débit v _{max} 1)	450 N1/h	250 Nl/h	250 Nl/h
Point de rosée d'entrée T _{e,max} 1)	70 °C	70 °C	70 °C
Température d'entrée de gaz $\vartheta_{\sf G, max}$ 1)	180 °C	140 °C	140 °C
Max. Puissance de refroidissement Q _{max}	310 kJ/h	215 kJ/h	295 kJ/h
Pression de gaz p _{max}	3 bar (160 bar sur demande)	3 bar	2 bar
Pression différentielle Δp (v=150 l/h) au total	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Volumes morts V _{mort} au total	59 ml	59 ml	115 ml
Raccordements gaz (métrique)	6 mm	GL 14 (6 mm) 3)	DN 4/6
Raccordements gaz (en pouces)	1/4"	GL 14 (1/4") 3)	1/4"-1/6"
Purgeur de condensat (métrique)	G3/8	GL 25 (12 mm) ³⁾	G3/8
Purgeur de condensat (en pouces)	NPT 3/8"	GL 25 (1/2") 3)	NPT 3/8"

¹⁾ Tenant compte de la puissance maximale de refroidissement du refroidisseur.

TC-Double+

Échangeur de chaleur	2x PTG-2 2x PTG-2-I ²⁾	2x PTV-2 2x PTV-2-I ²⁾
Matériaux en contact avec les fluides	Verre PTFE	PVDF
Débit v _{max} 1)	250 Nl/h	250 Nl/h
Point de rosée d'entrée T _{e,max} 1)	70 °C	70 °C
Température d'entrée de gaz $\vartheta_{G, max}$ 1)	140 °C	140 °C
Max. Puissance de refroidissement Q_{max}	230 kJ/h	215 kJ/h
Pression de gaz p _{max}	3 bar	2 bar
Pression différentielle Δp (v=150 l/h) au total	20 mbar	20 mbar
Volumes morts V _{mort} au total	59 ml	115 ml
Raccordements gaz (métrique)	GL 14 (6 mm) 3)	DN 4/6
Raccordements gaz (en pouces)	GL 14 (1/4") 3)	1/4"-1/6"
Purgeur de condensat (métrique)	GL 25 (12 mm) ³⁾	G3/8
Purgeur de condensat (en pouces)	GL 25 (1/2") 3)	NPT 3/8"

¹⁾ Tenant compte de la puissance maximale de refroidissement du refroidisseur.


²⁾ Les types comprenant un I sont pourvus de filetages NPT, voire de tubes en pouces.

³⁾ Diamètre intérieur de la bague d'étanchéité.

²⁾ Les types comprenant un I sont pourvus de filetages NPT, voire de tubes en pouces.

³⁾ Diamètre intérieur de la baque d'étanchéité.

9.6 Dimensions (mm)

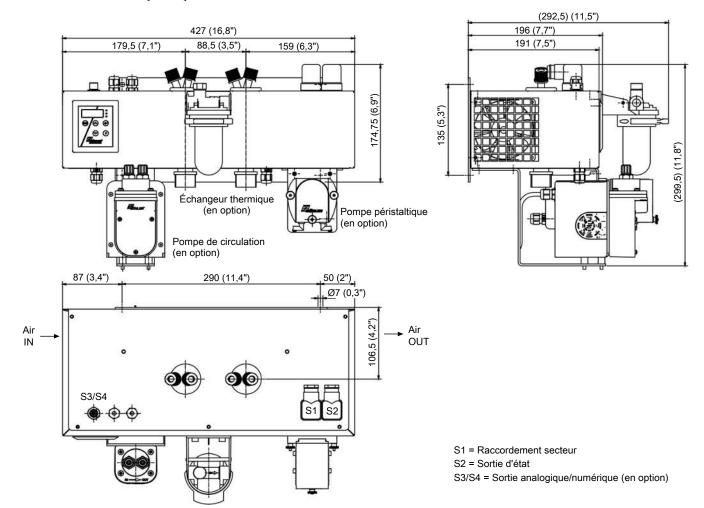

10 Documents joints

- Déclaration de conformité KX440008
- RMA Déclaration de décontamination

EU-Konformitätserklärung EU-declaration of conformity



Hiermit erklärt Bühler Technologies GmbH, dass die nachfolgenden Produkte den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie Herewith declares Bühler Technologies GmbH that the following products correspond to the essential requirements of Directive

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive)

in ihrer aktuellen Fassung entsprechen.

in its actual version.

Folgende Richtlinien wurden berücksichtigt:

The following directives were regarded:

2014/30/EU (EMV/EMC)

Produkt / products:

Peltier-Messgaskühler / Peltier sample gas cooler

Typ / type:

TC-Double, TC-Double+

Die Betriebsmittel dienen der Aufbereitung des Messgases, um das Analysengerät vor Restfeuchtigkeit im Messgas zu schützen.

The equipment is intended for conditioning of sample gas to protect the analyser from residual humidity in the sample gas.

Das oben beschriebene Produkt der Erklärung erfüllt die einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 61326-1:2013

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher für diese Konformitätserklärung ist Herr Stefan Eschweiler mit Anschrift am Firmensitz.

The person authorized to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company's address

Ratingen, den 17.02.2023

Stefan Eschweiler

Geschäftsführer - Managing Director

Frank Pospiech

Geschäftsführer - Managing Director

UK Declaration of Conformity



The manufacturer Bühler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product complies with the requirements of the following UK legislation:

Electrical Equipment Safety Regulations 2016

The following legislation were regarded:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Product:

Peltier sample gas cooler

Types:

TC-Double

TC-Double+

The equipment is intended for conditioning of sample gas to protect the analyser from residual humidity in the sample gas.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

EN 61326-1:2013

Ratingen in Germany, 17.02.2023

Stefan Eschweiler

Managing Director

Frank Pospiech

Managing Director

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung Formulaire RMA et déclaration de décontamination



$\overline{}$			/ h I	,		
ᆔ	ΛΔ_	NIr	/ Nh	IMARA	dΔ	renvoi

Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Le numéro d'autorisation de retour (RMA) est mis à votre disposition par votre interlocuteur à la vente ou au service. Lors du renvoi d'un appareil usagée en vue de sa mise au rebut, veuillez saisir "WEEE" dans le champ du n° RMA.

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à nous renvoyer cette déclaration de décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir également complètement au sens de la santé de nos employés.

déclaration de décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir égale	ment complètement au sens de la santé de nos employés.						
Firma/ Société	Ansprechpartner/ Interlocuteur						
Firma/ Société	Name/ Nom						
Straße/ Rue	Abt./ Dépt.						
PLZ, Ort/ CP, localité	Tel./ Tél.						
Land/ Pays	E-Mail						
Gerät/ Appareil	Serien-Nr./ N° de série						
Anzahl/ Nombre	Artikel-Nr./ N° d'article						
Auftragsnr./ Numéro de commande	Attiker-NL/ IV d'atticle						
Grund der Rücksendung/ Motif du retour	bitte spezifizieren/ veuillez spécifier						
•							
☐ Kalibrierung/ Calibrage ☐ Modifikation/ Modification							
Reklamation/ Réclamation Reparatur/ Réparation Elektroaltgerät/ Appareil électrique usagé (WEEE)							
andere/ autre							
Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ L'appareil a-t-il été util	liné 2						
	etrieben wurde./ Non, car l'appareil n'a pas été utilisé avec des sub-						
stances dangereuses pour la santé.	strieber wurde./ Nori, car rapparen rra pas ete utilise avec des sub-						
☐ Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminie	ert wurde./ Non, car l'appareil a été nettoyé et décontaminé en						
bonne et due forme. ☐ Ja, kontaminiert mit:/ Oui, contaminé avec:							
explosiv/ entzündlich/ brandfördernd/ komprimierte ätze							
explosif inflammable comburant Gase/ cor	rrosif Lebensgefahr/ fährdend/ heitsschädlich/ fährdend/						
gaz comprimés	toxique, danger dangereux pour nocif pour la dangereux pour de mort la santé santé l'environnement						
Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Merci de joindre la fiche technique de	sécurité						
Das Gerät wurde gespült mit:/ L'appareil a été rincé avec:							
Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer	Cette déclaration a été correctement complétée et signée par une per						
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-	sonne autorisée. L'envoi des appareils et composants (décontaminés) se						
ten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.	fait selon les conditions légales.						
Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die	Si la marchandise nous est retournée sans avoir été nettoyée, donc tou-						
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister	jours contaminée, la société Bühler se réserve le droit de faire nettoyer le						
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.	produit par un prestataire externe et de vous envoyer la facture corres-						
Firmenstempel/ Cachet de l'entreprise	pondante.						
Timonatemper Gaeriet de Fernieprise	Datum/ Date						



rechtsverbindliche Unterschrift/ Signature autorisée

Dekontaminierungserklärung

Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierungserklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie auf der Webseite unseres Unternehmens.

Éviter la modification et la détérioration du module à expédier

L'analyse d'unités défectueuses est un élément essentiel de l'Assurance Qualité de la société Bühler Technologies GmbH. Pour garantir une analyse pertinente, la marchandise doit être si possible contrôlée en l'état. Aucune modification ne doit être réalisée ni autre dommage se produire car les causes pourraient alors être masquées ou toute analyse serait rendue impossible.

Manipulation des modules à sensibilité électrostatique

Dans le cas d'unités électroniques, il peut s'agir de composants sensibles aux charges électrostatiques. Les composants doivent être traités en respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Selon le cas, les composants devraient être remplacés à un poste de travail ESD. Si cela n'est pas possible, des mesures respectant les directives en matière de décharges électrostatiques devraient être prises lors du remplacement. Le transport ne doit être réalisé que dans des conditions respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Les emballages des composants doivent être en conformité avec les directives en matière de décharges électrostatiques. Utilisez selon le cas l'emballage de pièces de rechange ou choisissez vous-même un emballage en conformité avec les directives en matière de décharges électrostatiques.

Montage de pièces de rechange

Veillez lors de l'insertion d'une pièce de rechange à ce que les conditions décrites ci-dessus soient respectées. Veillez à ce que le montage du produit et de tous les composants soit fait de manière appropriée. Remettez tous les câbles dans leur état d'origine avant la mise en service du produit. En cas de doute, adressez-vous au fabricant du produit pour avoir plus d'informations.

Renvoi d'appareils électriques usagés en vue de leur mise au rebut

Si vous souhaitez expédier un produit électrique manufacturé par Bühler Technologies GmbH en vue de sa mise au rebut correcte, veuillez saisir "WEEE" dans le champ du n° RMA. Pour le transport, joignez à l'appareil usagé la déclaration de décontamination entièrement remplie et bien visible de l'extérieur. Vous trouverez davantage d'informations concernant la mise au rebut des appareils électriques usagés sur le site Internet de notre entreprise.

