



## Bombas de gas de medición

P4.3, P4.83

## Manual de funcionamiento e instalación

Manual original





Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen  
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20  
Internet: [www.buehler-technologies.com](http://www.buehler-technologies.com)  
E-Mail: [analyse@buehler-technologies.com](mailto:analyse@buehler-technologies.com)

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Tenga en cuenta especialmente las indicaciones de advertencia y seguridad. En caso contrario podrían producirse daños personales o materiales. Bühler Technologies GmbH no tendrá responsabilidad alguna en caso de que el usuario realice modificaciones por cuenta propia o en caso de uso inadecuado del dispositivo.

Todos los derechos reservados. Bühler Technologies GmbH 2024

#### Información del documento

Nº de documento.....BS420010

Versión.....05/2024

## Tabla de contenido

|       |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                                                  | 2  |
| 1.1   | Uso conforme a las especificaciones .....                                                           | 2  |
| 1.2   | Estructura de número de artículo .....                                                              | 3  |
| 1.3   | Suministro .....                                                                                    | 4  |
| 1.4   | Descripción del producto .....                                                                      | 4  |
| 2     | Avisos de seguridad .....                                                                           | 5  |
| 2.1   | Avisos importantes .....                                                                            | 5  |
| 2.2   | Avisos de peligro generales .....                                                                   | 6  |
| 3     | Transporte y almacenamiento .....                                                                   | 8  |
| 4     | Construcción y conexión .....                                                                       | 9  |
| 4.1   | Requisitos del lugar de instalación .....                                                           | 9  |
| 4.1.1 | Instalación al aire libre/Colocación en exteriores .....                                            | 9  |
| 4.2   | Montaje .....                                                                                       | 9  |
| 4.3   | Disposición específica por gases de muestreo húmedos .....                                          | 10 |
| 4.3.1 | Conversión del cabezal de la bomba colgante .....                                                   | 10 |
| 4.4   | Conexión de las líneas de gas .....                                                                 | 11 |
| 4.5   | Conexiones eléctricas .....                                                                         | 11 |
| 5     | Uso y funcionamiento .....                                                                          | 13 |
| 5.1   | Encender la bomba tomamuestras para gas .....                                                       | 13 |
| 5.2   | Funcionamiento de la bomba tomamuestras para gas .....                                              | 14 |
| 6     | Mantenimiento .....                                                                                 | 15 |
| 6.1   | Sustitución de válvulas de entrada y de salida .....                                                | 16 |
| 6.2   | Cambio del fuelle y de la combinación de carnero / excéntrica .....                                 | 16 |
| 6.3   | Cambio de la junta tórica de la válvula de drenaje (opcional) .....                                 | 17 |
| 7     | Servicio y reparación .....                                                                         | 18 |
| 7.1   | Búsqueda y eliminación de fallos .....                                                              | 18 |
| 7.2   | Piezas de repuesto .....                                                                            | 19 |
| 8     | Eliminación .....                                                                                   | 20 |
| 9     | Anexo .....                                                                                         | 21 |
| 9.1   | Características técnicas .....                                                                      | 21 |
| 9.2   | Curvas de flujo .....                                                                               | 21 |
| 9.3   | Dimensiones .....                                                                                   | 22 |
| 9.4   | Dimensiones de juego de tuberías/juego de mangueras para P4.83 con funcionamiento en paralelo ..... | 23 |
| 10    | Documentación adjunta .....                                                                         | 24 |

# 1 Introducción

## 1.1 Uso conforme a las especificaciones

Las bombas de gases de muestreo han sido fabricadas para uso industrial.

La disposición de dos bombas sobre un motor con doble eje proporciona una solución económica para sistemas de análisis con dos vías de gas independientes. Para usos en los que sea necesario un tiempo de reflexión rápido se puede aumentar el caudal de la bomba P4.83 mediante el acoplamiento de ambas vías de gas.

La bomba de gases de muestreo solo está concebida para bombear medios en estado gaseoso. No se puede utilizar con líquidos.

Tenga en cuenta las indicaciones más detalladas de los apartados [Descripción del producto](#) [> Página 4] y [Uso y funcionamiento](#) [> Página 13], así como las indicaciones descritas en las hojas de datos en relación al uso previsto específico, las combinaciones de materiales disponibles y los límites de presión y temperatura.

### PELIGRO



#### Atmósfera potencialmente explosiva

Peligro de explosión por uso en zonas con peligro de explosión

El activo circulante **no** se puede utilizar en zonas con peligro de explosión.

**No se permite** el paso por el dispositivo mezclas de gases inflamables o explosivos.

En caso de instalación al aire libre deberá garantizarse una suficiente protección climática, ver apartado [Requisitos del lugar de instalación](#) [> Página 9].

## 1.2 Estructura de número de artículo

El dispositivo se entrega con diferentes variantes de equipamiento. En el número de artículo de la placa de características se muestra la variante exacta.

En la placa indicadora se encuentra el número de pedido, así como el número de identificación y el número de artículo que contiene un código en el que cada cifra (x) corresponde a un equipo en concreto:

| 42 | xx | x | x | x | x | x | 9 | 0 | 0 | 0 | Característica del producto                                  |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Modelo básico</b>                                         |
| 80 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P4.3, 2 x 400 l/h                                            |
| 81 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P4.83, 2 x 800 l/h                                           |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Tensión del motor</b>                                     |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 230 V 50/60 Hz; 1,4/1,2 A                                    |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115 V 50/60 Hz; 2,4/2,2 A                                    |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Posición cabezal de bomba</b>                             |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Posición normal perpendicular                                |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | girada 180°                                                  |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Material del cuerpo de la bomba</b>                       |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PTFE                                                         |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Acero inoxidable 1.4571                                      |
| 3  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | PTFE con válvula de derivación <sup>1)</sup>                 |
| 4  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Acero inoxidable 1.4571 con válvula de drenaje <sup>1)</sup> |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Material válvula</b>                                      |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hasta 100°C; PTFE/PVDF <sup>2)</sup>                         |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hasta 160°C; PTFE/PEEK                                       |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Racores roscados (con voltaje de 230 V)</b>               |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cuerpo de la bomba PTFE</b>                               |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cuerpo de la bomba acero inoxidable</b>                   |
| 9  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DN 4/6 (estándar)                                            |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 mm (estándar)                                              |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 mm                                                         |
| 3  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3/8"-1/4"                                                    |
| 4  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1/4"-1/8"                                                    |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1/4"-1/6"                                                    |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Racores roscados (con voltaje de 115 V)</b>               |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cuerpo de la bomba PTFE</b>                               |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Cuerpo de la bomba acero inoxidable</b>                   |
| 9  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1/4"-1/6" (estándar)                                         |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1/4" (estándar)                                              |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 mm                                                         |
| 3  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3/8"                                                         |
| 5  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1/4"-1/8"                                                    |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DN 4/6                                                       |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 mm                                                         |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Accesorios de montaje</b>                                 |
| 9  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | incl. soporte de montaje y tope                              |
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Set de conexión para servicio en paralelo</b>             |
| 0  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sin                                                          |
| 1  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Juego de mangueras PVDF/PTFE <sup>3)</sup>                   |
| 2  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Juego de tubos 1.4571/1.4401 <sup>3)</sup>                   |

<sup>1)</sup> no disponible con funcionamiento en paralelo.

<sup>2)</sup> no disponible en P4.83.

<sup>3)</sup> solo disponible en P4.83.

Si hay especificaciones para un tipo de bomba se describen aparte en este manual de instrucciones.

Al realizar la conexión, tenga en cuenta las características de la bomba y al realizar el pedido de repuestos asegúrese de que las versiones sean las correctas (ejemplo: válvula).

## 1.3 Suministro

| P4.3                                      | P4.83                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 x bombas de gases de muestreo con motor | 2 x bombas de gases de muestreo con motor         |
| 4 x topes caucho-metal                    | 4 x topes caucho-metal                            |
| 1 x soporte de montaje                    | 1 x soporte de montaje                            |
| Documentación del producto                | Documentación del producto                        |
|                                           | en caso necesario, 1 x set de conexión (opcional) |

## 1.4 Descripción del producto

Las bombas de gases de muestreo solo están concebidas para bombear medios en estado gaseoso. No se pueden utilizar con líquidos.

Preste atención a los datos adjuntos a este manual en relación al uso previsto, las combinaciones de materiales disponibles, así como la presión y los límites de temperatura. También tenga en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.

Si durante el funcionamiento el gas de muestreo está húmedo, pueden surgir condensaciones en las tuberías y en el cuerpo de la bomba. En esos casos el cabezal de la bomba se debe montar de forma colgada (ver el punto [Conversión del cabezal de la bomba colgante](#) [> Página 10]).

## 2 Avisos de seguridad

### 2.1 Avisos importantes

Solamente se puede ejecutar este aparato si:

- se utiliza el producto bajo las condiciones descritas en el manual de uso e instalación y se lleva a cabo su ejecución de acuerdo con las placas de indicaciones y para el fin previsto. Bühler Technologies GmbH no se hace responsable de las modificaciones que haga el usuario por cuenta propia,
- se tienen en cuenta los datos e identificaciones en las placas indicadoras.
- se mantienen los valores límite expuestos en la hoja de datos y en el manual,
- se conectan de forma correcta los dispositivos de control / medidas de seguridad,
- se llevan a cabo las tareas de servicio y reparación que no están descritas en este manual por parte de Bühler Technologies GmbH,
- se utilizan refacciones originales.

Este manual de instrucciones es parte del equipo. El fabricante se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los datos de funcionamiento, las especificaciones o el diseño. Conserve el manual para su futuro uso.

### Palabras clave para advertencias

|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELIGRO</b>     | Palabra clave para identificar un peligro de riesgo elevado que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones corporales graves de no evitarse. |
| <b>ADVERTENCIA</b> | Palabra clave para identificar un peligro de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones corporales graves.                  |
| <b>ATENCIÓN</b>    | Palabra clave para identificar un peligro de riesgo pequeño que, de no evitarse, puede tener como consecuencia daños materiales o lesiones corporales leves.          |
| <b>INDICACIÓN</b>  | Palabra clave para información importante sobre el producto sobre la que se debe prestar atención en cierta medida.                                                   |

### Señales de advertencia

En este manual se utilizan las siguientes señales de advertencia:

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Señal general de advertencia            |  | Señal general de obligación      |
|  | Peligro por voltaje eléctrico           |  | Desconectar de la red            |
|  | Peligro por inhalación de gases tóxicos |  | Utilizar mascarilla              |
|  | Peligro por materiales corrosivos       |  | Utilizar protección para la cara |
|  | Advertencia de peligro de explosión     |  | Utilizar guantes                 |
|  | Peligro de superficies calientes        |                                                                                     |                                  |

## 2.2 Avisos de peligro generales

Las tareas de mantenimiento solo pueden ser realizadas por especialistas con experiencia en seguridad laboral y prevención de riesgos.

Deben tenerse en cuenta las normativas de seguridad relevantes del lugar de montaje, así como las regulaciones generales de las instalaciones técnicas. Prevenga las averías, evitando de esta forma daños personales y materiales.

### El usuario de la instalación debe garantizar que:

- Estén disponibles y se respeten las indicaciones de seguridad y los manuales de uso.
- Se respeten las disposiciones nacionales de prevención de accidentes.
- Se cumpla con los datos aportados y las condiciones de uso.
- Se utilicen los dispositivos de seguridad y se lleven a cabo las tareas de mantenimiento exigidas.
- Se tengan en cuenta las regulaciones vigentes respecto a la eliminación de residuos.
- se cumplan las normativas nacionales de instalación.

### Mantenimiento, reparación

Para las tareas de mantenimiento y reparación debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Las reparaciones en el equipo solo pueden llevarse a cabo por personal autorizado por Bühler.
- Solamente se deben llevar a cabo las tareas de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalación.
- Utilizar solamente repuestos originales.
- No instalar piezas de repuesto dañadas o defectuosas. En caso necesario, realiza una revisión visual antes de la instalación para detectar posibles daños evidentes de las piezas de repuesto.

Al realizar tareas de mantenimiento de cualquier tipo deben respetarse las instrucciones de seguridad y de trabajo del país de aplicación.

#### PELIGRO

#### Voltaje eléctrico



Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el dispositivo de la red durante todas las tareas.
- Asegúre el dispositivo contra una reconexión involuntaria.
- El dispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.
- Confirme que el suministro de tensión es el correcto.



#### PELIGRO

#### Gases tóxicos y corrosivos



El gas de medición conducido por el aparato puede resultar perjudicial para la salud al inhalarlo o al entrar en contacto con la piel.

- Antes de la puesta en funcionamiento del aparato compruebe la estanqueidad de su sistema de medición.
- Asegúrese de que los gases nocivos se eliminan de forma segura.
- Antes de comenzar las tareas de mantenimiento y reparación desconecte el suministro de gas y limpie los conductos de gas con aire o gas inerte. Asegure los conductos de gas contra una abertura inesperada.
- Utilice medios de protección contra gases tóxicos o corrosivos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de protección correspondiente



#### PELIGRO

#### Atmósfera potencialmente explosiva



Peligro de explosión por uso en zonas con peligro de explosión

El activo circulante **no** se puede utilizar en zonas con peligro de explosión.

**No se permite** el paso por el dispositivo mezclas de gases inflamables o explosivos.

**CUIDADO****Peligro de vuelco**

Daños materiales en el dispositivo.  
Proteja el dispositivo para evitar que se vuelque, se deslice o se caiga.

**CUIDADO****Superficies calientes**

Peligro de quemaduras  
Durante el funcionamiento pueden surgir, según el tipo de producto y los parámetros de funcionamiento, temperaturas en la carcasa > 50 °C.  
De acuerdo con las condiciones de montaje del lugar puede que sea necesario señalar la zona con un letrero de advertencia.

### 3 Transporte y almacenamiento

Los productos solamente se pueden transportar en su embalaje original o en un equivalente adecuado.

Si no se utiliza, se deberá proteger el equipo contra humedad o calor. Se debe conservar en un espacio a cubierto, seco y libre de polvo con una temperatura de entre -20 °C hasta +40 °C (de -4 °F a 104 °F). Para evitar daños en los cojinetes, es necesario garantizar un entorno libre de vibraciones ( $v_{eff} < 0,2 \text{ mm/s}$ ).

El almacenamiento en exteriores **no** está permitido. En principio, el usuario debe aplicar todas las normativas vigentes relacionadas con la prevención de daños por rayos, que pueden provocar problemas en la bomba de gases de muestreo.

El espacio de almacenamiento no puede albergar bajo ningún concepto dispositivos que generen ozono, como por ejemplo fuentes de luz fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio o aparatos eléctricos de alta tensión.

Tras un periodo largo de almacenamiento o inactividad, antes de la puesta en marcha se ha de medir la resistencia de aislamiento de la bobina fase contra fase y fase contra masa. Las bobinas húmedas pueden llevar a pueden ocasionar corrientes de fuga, saltos de chispas y descargas disruptivas. La resistencia de aislamiento del estator ha de contar con por lo menos  $1,5 \text{ M}\Omega$  en una temperatura de bobinado de 20 °C (68 °F). Si los valores son menores es necesario secar la bobina.

El eje del motor se ha de girar de vez en cuando para asegurar un lubricado completo duradero del cojinete. Para ello desenrosque los tres tornillos en estrella (9) de la tapa del soporte (8) y retírela. Ahora está visible el mecanismo de manivela (10). En este puede girar el eje del motor.

**La asignación de los números de posición puede consultarse en el esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 adjunto.**

#### CUIDADO



#### Peligro de aplastamiento

Peligro de aplastamiento de los dedos

¡Evite pillarse los dedos entre la excéntrica y la biela de empuje!

## 4 Construcción y conexión

Antes de su instalación, compruebe si el dispositivo tiene desperfectos. Estos pueden tratarse de daños en las carcasas, las líneas de conexión a la red, etc. No utilice nunca dispositivos en los que se aprecien desperfectos.

### 4.1 Requisitos del lugar de instalación

#### CUIDADO



#### Daños en el dispositivo

Proteja el equipo, en especial las conexiones y tuberías de gas, contra polvo, caída de objetos y golpes externos.

#### Rayo

El usuario ha de adaptarse a todas las normativas vigentes, así como la prevención de daños por rayos que puedan suponer daños en el dispositivo.

La cubierta no debe afectar a la ventilación y el aire de salida, incluso de las unidades contiguas, no debe aspirarse de nuevo.

En el montaje sin soporte de montaje Bühler se debe respetar una distancia suficiente (al menos 40 mm) entre el motor y el panel trasero.

Las bombas de gases de muestreo están establecidas para alturas de instalación de  $\leq 1000$  m sobre NM. Están disponibles en diferentes variantes, cuyas características técnicas pueden variar entre sí.

Por tanto, debe tener siempre en cuenta los datos específicos de cada dispositivo disponibles en la placa de características de las bombas y los motores, así como los valores límite individuales (ver características técnicas).

#### 4.1.1 Instalación al aire libre/Colocación en exteriores

Las bombas de gases de muestreo no han sido diseñadas especialmente para su instalación al aire libre o colocación en exteriores. Las condiciones de instalación y climáticas determinan el tipo de protección necesaria y, en ciertos casos, otro tipo de medidas necesarias como:

- La suficiente protección climática
- Ajuste de los intervalos de mantenimiento (por ej. limpieza y reemplazo de piezas de desgaste)

Aplique medidas apropiadas y las revisiones habituales para evitar daños en el dispositivo provocados por:

- Corrosión
- Radiación solar (picos de temperatura y daños por radiación UV)
- Humedad por condensación (por ej. por cambios rápidos de temperatura o tiempos de inactividad)
- Congelación
- Insectos y microorganismos
- Otros animales, como roedores, etc.

Tenga en cuenta que en caso de instalación al aire libre/colocación en exteriores también deberá garantizarse el cumplimiento de todos los parámetros técnicos de funcionamiento del dispositivo. Se trata concretamente de:

- Temperaturas de funcionamiento máximas y mínimas
- Tipo de protección

### 4.2 Montaje

#### CUIDADO



#### Daños en el dispositivo

Proteja el equipo, en especial las conexiones y tuberías de gas, contra polvo, caída de objetos y golpes externos.

Al instalar P4 en las placas de montaje, utilice la consola de pared proporcionada utilizando los topes caucho-metal proporcionados. No está permitido el funcionamiento sin topes caucho-metal. Los topes caucho-metal se han de utilizar en caso de que se vaya a montar la bomba sobre una subestructura ya disponible. Los orificios de montaje del soporte de montaje y de las patas del motor los encontrará en las características técnicas al final del manual de uso e instalación.

## 4.3 Disposición específica por gases de muestreo húmedos

Si durante un funcionamiento el gas de muestreo está húmedo, pueden surgir condensaciones en las tuberías y en el cuerpo de la bomba. En esos casos el cabezal de la bomba se ha de montar de forma colgada (el cuerpo de la bomba mira hacia abajo).

Si la bomba no se hubiera pedido ya de tal forma, se puede proceder al cambio en el lugar.

Coloque el conducto entre la salida de gas y el conducto de trasvase de la condensación de forma inclinada, para evitar que la condensación se escape y no se acumule en la bomba o el conducto.

### 4.3.1 Conversión del cabezal de la bomba colgante

#### CUIDADO




#### Daños en el dispositivo

Sobre todo en el caso del cabezal de bomba colgante se ha de proteger el soporte de la bomba contra la entrada de polvo y pequeñas partículas. En este caso la ranura no se puede cerrar de forma directa. Si no se puede asegurar este procedimiento, no se puede llevar a cabo el cambio del cabezal de bomba colgante.

Para realizar estos cambios sírvase del esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 del anexo.

- Retire los tres tornillos de estrella (9) y saque la cubierta de la consola (8) del soporte de la bomba (5). Entonces quedarán a la vista el mecanismo de manivela (10) y la brida del motor según el tipo de bomba de la brida intermedia.
- El soporte de la bomba está fijado a la brida con cuatro tornillos hexagonales (7) y arandelas elásticas (6). Desenrózquelo por completo, sujete bien el soporte de la bomba y gírelo para el centrado de la brida en 180°.
- Monte de nuevo todos los componentes en orden inverso. Tenga en cuenta el par de apriete de los tornillos hexagonales (7) de 3 Nm.

¡No está permitido un montaje diferido a 90° del cabezal de la bomba!

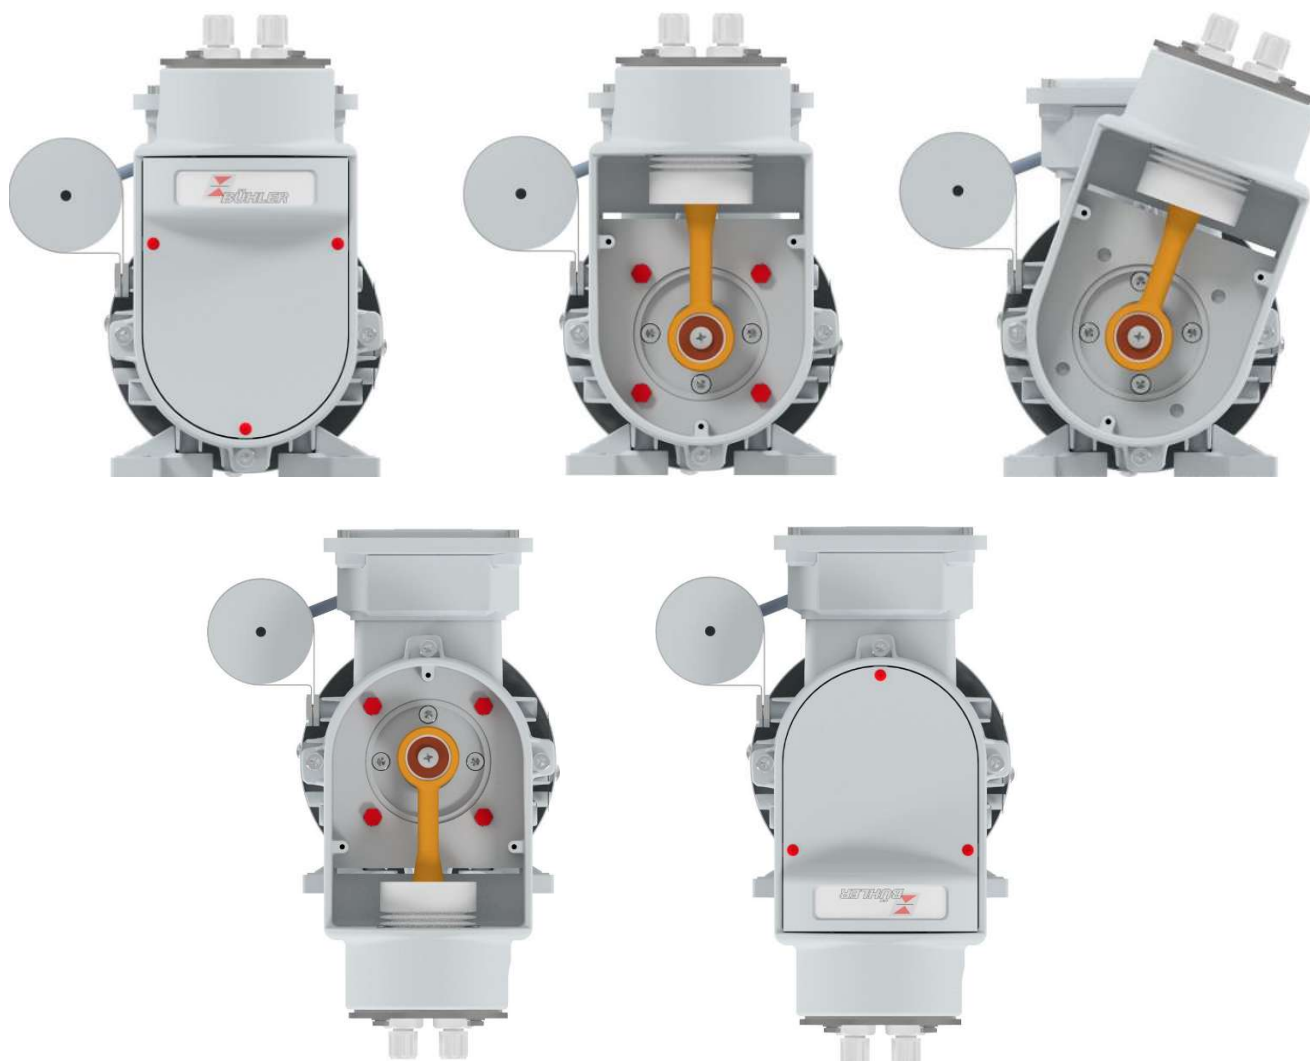

## 4.4 Conexión de las líneas de gas

Las bombas han de estar previstas de las conexiones que ha elegido. Compare el número de artículo en la placa indicadora con la estructura de número de artículo en el capítulo «Introducción».

Evite instalaciones erróneas, como conexiones a cuerpos de plástico. Si no hubiera otra opción en casos aislados, atornille las uniones roscadas metálicas con cuidado y en ningún caso de forma violenta en el cuerpo PTFE de las bombas.

Coloque los tubos de tal forma que el tubo en la entrada y en la salida se mantenga elástico gracias a un tramo suficiente (la bomba se mueve).

### Funcionamiento individual

Cuando las bombas se utilizan en funcionamiento individual, se deben cerrar las vías de gas en los respectivos cabezales de las bombas. Las entradas están indicadas con **"In"** (Inlet) y las salidas con **"Out"** (Outlet). Asegúrese de que las conexiones de las líneas de gas estén conectadas herméticamente.

### Funcionamiento paralelo (solo P4.83)

En funcionamiento paralelo, los cabezales de las bombas se unen con ayuda del set de unión. Aquí se deberán unir, respectivamente, las salidas y las entradas de cada bomba entre sí. Las entradas están indicadas con **"In"** (Inlet) y las salidas con **"Out"** (Outlet). La vía de gas se conecta en la respectiva pieza en T del set de unión. La tuerca de racor para la fijación del set de unión es un componente de la bomba.

## 4.5 Conexiones eléctricas

### ADVERTENCIA



#### Voltaje eléctrico peligroso

La conexión solamente se puede llevar a cabo por especialistas formados.

### CUIDADO



#### Tensión de red incorrecta

Una tensión de red incorrecta puede destrozar el dispositivo. Comprobar en la conexión que la tensión de red sea la correcta de acuerdo con la placa indicadora.

La bomba de gases de muestreo debe estar asegurada contra un calentamiento no permitido, contra una sobrecarga (interruptor de protección del motor).

Es necesario tener en cuenta la potencia de la corriente nominal para la configuración del interruptor de protección (ver placa indicadora de motor).

Asegúrese de que el motor de la bomba cuente con una tensión y frecuencia correctas. Tolerancia de voltaje  $\pm 5\%$ , tolerancia de frecuencia  $\pm 1\%$ , según el valor de medición.

Conecte la bomba de gases de muestreo de acuerdo con el esquema eléctrico correspondiente (ver abajo). Si hay un esquema eléctrico diferente en la tapa de la caja de conexiones, este tiene prioridad en cualquier caso. El par de apriete establecido para las tuercas del tablero de bornes es de 1,5 Nm.

Procure que el cable de conexión disponga de suficientes medios de descarga de tracción. La zona de apriete de la unión roscada de cable es de 6-10 mm. El par de apriete establecido para la unión roscada de cable es de 5 Nm.

Las secciones transversales de los conectores y de las salidas a tierra se han de ajustar a la potencia de la corriente nominal. Utilice como mínimo una sección transversal de conexión de 1,5 mm<sup>2</sup>.

Asegúrese de conectar las siguientes conexiones de conductores de protección a su conductor de protección local de acuerdo con los requisitos oficiales:


- Conexión de conductor de protección dentro de la caja de bornes del motor.
- Conexión de conductor de protección en el soporte de montaje.

Las corrientes de compensación eléctricas no pueden pasar por esta conexión.

En la caja de bornes no puede haber elementos extraños, suciedad o humedad. Los orificios de entrada de cables que no vayan a utilizarse deben sellarse con tapones aprobados para este uso (como Atex, IECEx).

Para mantener correctamente la protección IP especificada por el fabricante, al cerrar la caja de conexiones con la tapa asegúrese de que el sellado original esté correctamente colocado y apriete los tornillos.

Imprescindible el cumplimiento de los datos que difieran en la placa de características. Todos los datos de la placa de características deben corresponderse con las condiciones del lugar de ejecución.

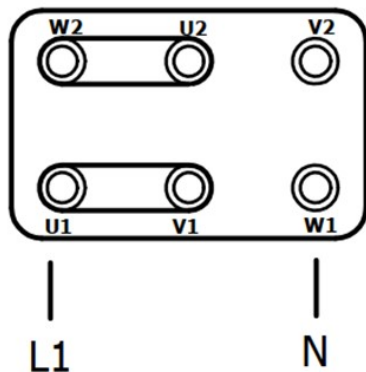

## 5 Uso y funcionamiento

### INDICACIÓN



¡No se puede utilizar el dispositivo fuera de sus especificaciones!

### CUIDADO



#### Superficies calientes

Peligro de quemaduras

Durante el funcionamiento pueden surgir, según el tipo de producto y los parámetros de funcionamiento, temperaturas en la carcasa > 50 °C.

De acuerdo con las condiciones de montaje del lugar puede que sea necesario señalar la zona con un letrero de advertencia.

### PELIGRO



#### Gases tóxicos y corrosivos

El gas de medición conducido por el aparato puede resultar perjudicial para la salud al inhalarlo o al entrar en contacto con la piel.

- Antes de la puesta en funcionamiento del aparato compruebe la estanqueidad de su sistema de medición.
- Asegúrese de que los gases nocivos se eliminan de forma segura.
- Antes de comenzar las tareas de mantenimiento y reparación desconecte el suministro de gas y limpie los conductos de gas con aire o gas inerte. Asegure los conductos de gas contra una abertura inesperada.
- Utilice medios de protección contra gases tóxicos o corrosivos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de protección correspondiente



## 5.1 Encender la bomba tomamuestras para gas

### Antes de encender el dispositivo deberá comprobarse que:

- Las conexiones de mangueras y eléctricas no estén dañadas y que estén instaladas correctamente.
- No haya ninguna pieza de la bomba tomamuestras para gas desmontada (p. ej., tapa).
- La entrada y salida de gas en la bomba tomamuestras para gas no estén bloqueadas.
- La presión inicial sea inferior a 0,5 bar.
- Para el estrangulamiento inferior a 150 l/h (para cada cabezal del P4.3) o 400 l/h (para cada cabezal del P4.83) haya disponible un bypass en funcionamiento continuo.
- Se cumplan con los parámetros ambientales.
- Se cumpla con la información de la placa de características.
- La tensión y la frecuencia del motor coincidan con los valores de red.
- Las conexiones eléctricas estén fijadas firmemente y los dispositivos de monitorización estén conectados y configurados debidamente.
- Los orificios de entrada de aire y las superficies de refrigeración estén limpios.
- Se lleven a cabo las medidas de limpieza; ¡toma a tierra!
- El motor esté fijado debidamente.
- La tapa de la caja de conexiones esté cerrada y las guías de los conductos estén aisladas de forma adecuada.

### Al activar el dispositivo, compruebe que:

- no aparecen ruidos o vibraciones extrañas.
- no aumenta ni se reduce el volumen del caudal. Esto puede indicar un defecto del fuelle.

## 5.2 Funcionamiento de la bomba tomamuestras para gas

La bomba tomamuestras para gas ha sido diseñada exclusivamente para el transporte de medios gaseosos. No es apta para líquidos.

La bomba tomamuestras para gas debe funcionar sin presión inicial. No está permitida una presión inicial superior a 0,5 bar. La salida de gas no deberá estar bloqueada. El caudal para cada cabezal de las bombas deberá ser de, como mínimo, de 50 l/h para la bomba P4.3 e inferior a 200 l/h para la bomba P4.83. Para un estrangulamiento inferior a 150 l/h para la bomba P4.3 e inferior a 400 l/h para la bomba P4.83 en funcionamiento continuo, la cantidad de caudal deberá ser regulada a través de un bypass. En este caso se debe seleccionar la versión con válvula de drenaje.

### INDICACIÓN



Una aceleración fuerte reduce la vida útil del fuelle.

En bombas con válvula de drenaje integrada se puede regular la potencia de salida. ¡No emplee demasiada fuerza al girar la válvula o esta podría sufrir daños! La zona de giro de la válvula soporta aproximadamente 7 vueltas.

## 6 Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento en el dispositivo se han de llevar a cabo en frío.

Para las labores de mantenimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Las labores de mantenimiento solo pueden ser realizadas por personal especializado con experiencia en seguridad laboral y prevención de riesgos.
- Solo deben llevarse a cabo las labores de mantenimiento descritas en este manual de uso e instalación.
- Al realizar cualquier labor de mantenimiento deben cumplirse siempre las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
- Utilice únicamente piezas de recambio originales.

### INDICACIÓN



Al realizar las tareas de mantenimiento sírvese del esquema de montaje del anexo.

### PELIGRO

#### **Voltaje eléctrico**



Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el dispositivo de la red durante todas las tareas.
- Asegúre el dispositivo contra una reconexión involuntaria.
- El dispositivo solamente puede ser abierto por especialistas formados.
- Confirme que el suministro de tensión es el correcto.



### PELIGRO

#### **Gases tóxicos y corrosivos**



El gas de medición conducido por el aparato puede resultar perjudicial para la salud al inhalarlo o al entrar en contacto con la piel.

- Antes de la puesta en funcionamiento del aparato compruebe la estanqueidad de su sistema de medición.
- Asegúrese de que los gases nocivos se eliminan de forma segura.
- Antes de comenzar las tareas de mantenimiento y reparación desconecte el suministro de gas y limpie los conductos de gas con aire o gas inerte. Asegure los conductos de gas contra una abertura inesperada.
- Utilice medios de protección contra gases tóxicos o corrosivos durante el mantenimiento. Utilice el equipo de protección correspondiente



### CUIDADO

#### **Peligro de vuelco**



Daños materiales en el dispositivo.

Proteja el dispositivo para evitar que se vuelque, se deslice o se caiga.

### CUIDADO

#### **Salida de gas**



El dispositivo no se puede encontrar bajo presión durante el desmontaje.

### CUIDADO

#### **Superficies calientes**



Peligro de quemaduras

Durante el funcionamiento pueden surgir, según el tipo de producto y los parámetros de funcionamiento, temperaturas en la carcasa > 50 °C.

De acuerdo con las condiciones de montaje del lugar puede que sea necesario señalar la zona con un letrero de advertencia.

Según la calidad del gas de muestreo a transportar puede ser necesario cambiar las válvulas en la entrada y en la salida con relativa frecuencia. Encontrará una descripción del cambio de piezas en el apartado Sustitución de válvulas de entrada y de salida.

Si las válvulas tienen mucha suciedad tras un corto periodo de uso, se debe utilizar un filtro de partículas antes de la bomba. Esto aumenta la vida útil de forma considerable.

Los tornillos del anillo de fijación se han de apretar tras aprox. 500 horas de funcionamiento con 3 Nm.

## 6.1 Sustitución de válvulas de entrada y de salida

**Para realizar esta tarea de mantenimiento sírvase del esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 del anexo.**

- Desmonte los racores roscados (18) del cuerpo de la bomba (13).
- Desenrosque la válvula (17) con un destornillador de cabeza plana. En el caso de los cuerpos de bomba de acero inoxidable, bajo las válvulas se encuentran los denominados desplazadores (20). Estos sirven para reducir el volumen muerto y es imprescindible que permanezcan instalados en los cuerpos de bomba.
- Enrosque las nuevas válvulas en el cuerpo de la bomba y apriételas con máx. 1 Nm. Al hacerlo, tenga en cuenta la dirección de instalación correcta de la válvula. Las válvulas para una temperatura de entrada de gas permitida de máx. 100 °C son de color negro/rojo, para máx. 160 °C de color gris/naranja. El lado rojo o naranja corresponde a la entrada de gas y el lado negro o gris a la salida de gas. Las válvulas de la entrada de gas están marcadas como «EIN» y «IN» y las de la salida de gas con «AUS» y «OUT». El etiquetado que se ve al mirar el cuerpo de la válvula desde arriba se corresponde con la función de la válvula.
- Por último, monte los racores roscados de nuevo en el cuerpo de la bomba. Reemplace los anillos de sellado (19) dañados en los racores roscados de acero inoxidable.
- Compruebe que la bomba de gases de muestreo esté sellada.
- Realice una prueba de funcionamiento. En la misma se deben de alcanzar como mínimo los siguientes valores:  
Exceso de presión: P4.3 = 1,7 bar; P4.83 = 3,5 bar  
Presión insuficiente: P4.3 = -0,65 bar; P4.83 = -0,75 bar  
Caudal: P4.3 = 400 l/h; P4.83 = 800 l/h

Introduzca la tarea de mantenimiento con los valores de prueba en el «Registro de funcionamiento (plantilla de copia)» de la bomba de gas de muestreo.

## 6.2 Cambio del fuelle y de la combinación de carnero / excéntrica

### INDICACIÓN



### Restricciones para el cambio de excéntrica/biela

No se permite el cambio por separado de la excéntrica, de la biela o del cojinete. Solamente el grupo montado previamente de fábrica excéntrica/biela puede ser cambiado por el usuario.

**Para realizar esta tarea de mantenimiento sírvase del esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 del anexo.**

1. Retire los tres tornillos de estrella (9) y saque la cubierta de la consola (8) del soporte de la bomba (5).
2. Limpie la bomba de gases de muestreo de polvo y cualquier tipo de suciedad. Retirar la suciedad establecida con un paño húmedo limpio (no utilizar productos de limpieza con disolventes).
3. Retire los 4 tornillos hexagonales (16) y las arandelas elásticas (15) situados en la parte superior del cuerpo de bomba (13). Los cuerpos de bomba PTFE cuentan con un anillo de fijación (14) para obtener una mejor presión superficial.
4. Saque el cuerpo de la bomba con cuidado hacia arriba del soporte de la bomba. Asegúrese de que el fuelle (12) no se extienda en exceso. Si el cuerpo de la bomba se adhiere al fuelle, intente aflojarlo girándolo con cuidado.
5. Mantenga el fuelle ligeramente por encima del empujador (10) y desenrósquelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Si solamente cambia el fuelle, puede continuar con la instalación a partir del punto 14.
6. Desmonte los 4 tornillos hexagonales (7) y las arandelas de resorte (6) y retire el soporte de la bomba de la brida.
7. Afloje y retire el tornillo prisionero (11) de la excéntrica del accionamiento de manivela (10). Este tendrá bien un hexágono interior (SW 2) o bien accionamiento Torx (TX 8). Utilice la herramienta adecuada.
8. A continuación levante con cuidado la manivela para sacarla del eje. Esto funciona mejor con 2 destornilladores grandes de cabeza plana.
9. Limpie el eje y, si es necesario, quite los restos de la corrosión por fricción, etc. Controle el tamaño adecuado 11k6.
10. Lubrique el eje con un aceite no resinoso antes del montaje.
11. Introduzca el nuevo accionamiento de manivela en el eje y ajuste el orificio de bloqueo del tornillo prisionero con el orificio correspondiente en el eje. Evite el uso de herramientas de impacto, ya que estas podrían dañar los rodamientos.

12. Coloque de nuevo el tornillo prisionero con un adhesivo para tornillos de consistencia media y apriételo con 1,5 Nm. Tenga sobre todo en cuenta que el lápiz de rosca del tornillo prisionero encaje correctamente en el orificio del eje.
13. A continuación, vuelva a pasar el soporte de la bomba por la manivela, oriéntela hacia arriba o gírela 180° y vuelva a fijarla con los tornillos hexagonales (7) y las arandelas de resorte (6); par de apriete 3 Nm.
14. Revise si hay daños y suciedad en el sellado y en los pliegues del fuelle.
15. Inserte el fuelle desde arriba en el soporte de la bomba y gírelo con las manos en el sentido de las agujas del reloj hacia el empujador de la manivela.
16. Limpie el cuerpo de la bomba y compruebe si el sellado presenta daños.
17. Coloque el cuerpo de la bomba sobre el fuelle y gírelo hasta la posición requerida en relación con la entrada y salida de gas. En principio no tiene importancia en qué dirección se monta el cuerpo de la bomba. No obstante, asegúrese de que el etiquetado del anillo de fijación o del cuerpo de la bomba coincida con la válvula instalada y su función. Una válvula de entrada no presenta diferencias con una válvula de salida. Su localización en el montaje confirma su función. Las válvulas siempre están marcadas con «EIN» o «IN» para la entrada y «AUS» o «OUT» para la salida.
18. Vuelva a fijar el cuerpo de la bomba con los 4 tornillos hexagonales (16) y arandelas elásticas (15), en el caso de los cuerpos de PTFE con el anillo de fijación, y apriete después los tornillos en cruz con 1 Nm y después con 3 Nm.
19. Para terminar, vuelva a montar la tapa del soporte con los 3 tornillos de estrella.
20. Compruebe que la bomba de gases de muestreo esté sellada.
21. Realice una prueba de funcionamiento. En la misma se deben de alcanzar como mínimo los siguientes valores:  
Exceso de presión: P4.3 = 1,7 bar; P4.83 = 3,5 bar  
Presión insuficiente: P4.3 = -0,65 bar; P4.83 = -0,75 bar  
Caudal: P4.3 = 400 l/h; P4.83 = 800 l/h

Introduzca la tarea de mantenimiento con los valores de prueba en el «Registro de funcionamiento (plantilla de copia)» de la bomba de gas de muestreo.

## 6.3 Cambio de la junta tórica de la válvula de drenaje (opcional)

**Para realizar esta tarea de mantenimiento sírvase del esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 del anexo.**

- Suelte ambos tornillos (24) y saque con cuidado del cuerpo de la bomba (13) la unidad al completo, compuesta por placa de válvula (23), husillo (22) y junta tórica (21) en el cabezal giratorio (26). En los cuerpos de bomba VA, gire el alojamiento del husillo (25) con una llave SW13 en el sentido de las agujas del reloj para sacarlo y retire la unidad al completo.
- Quite la junta tórica antigua del husillo.
- Humedezca la nueva junta tórica con un engrasante adecuado (temperatura de uso continuo mín. 215 °C, por ej. Fluoronox S90/2) y colóquela con cuidado en el husillo.
- Coloque de nuevo toda la unidad enroscándola en el cuerpo de la bomba y apriete de nuevo los tornillos o el alojamiento del husillo.
- Compruebe que la bomba de gases de muestreo esté sellada.

## 7 Servicio y reparación

Si se produce un fallo de funcionamiento, busque en este capítulo información sobre posibles causas y cómo solucionarlos.

Solo puede realizar reparaciones en el equipo personal autorizado por Bühler.

Ante cualquier pregunta, consulte a nuestro servicio técnico:

**Tel.: +49-(0)2102-498955** o a su persona de contacto habitual

Consulte más información sobre nuestros servicios personalizados de instalación y mantenimiento en <https://www.buehler-technologies.com/service>.

Si tras resolver eventuales problemas y conectar el equipo a la tensión de red, este siguiera sin funcionar correctamente, entonces, el equipo deberá ser revisado por parte del fabricante. Envíe, para ello, el equipo embalado adecuadamente a la siguiente dirección:

**Bühler Technologies GmbH**

**- Reparatur/Service -**

**Harkortstraße 29**

**40880 Ratingen**

**Alemania**

Adjunte al paquete la declaración de descontaminación RMA cumplimentada y firmada. De lo contrario, no se podrá tramitar su encargo de reparación.

El formulario se encuentra anexo a este manual y puede solicitarse también por correo electrónico:

**service@buehler-technologies.com.**

### 7.1 Búsqueda y eliminación de fallos

#### CUIDADO



#### Riesgo por dispositivo defectuoso

Posibles daños físicos o materiales.

- a) Apague el dispositivo y desconéctelo de la red.
- b) Elimine de forma inmediata la avería en el dispositivo. No se puede volver a poner en funcionamiento el dispositivo hasta que se haya eliminado la avería.



#### CUIDADO



#### Superficies calientes

Peligro de quemaduras

Durante el funcionamiento pueden surgir, según el tipo de producto y los parámetros de funcionamiento, temperaturas en la carcasa > 50 °C.

De acuerdo con las condiciones de montaje del lugar puede que sea necesario señalar la zona con un letrero de advertencia.

| Avería              | Causa                                                                  | Solución                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La bomba no arranca | – Se ha interrumpido la alimentación o no está conectada correctamente | – Comprobar la conexión o el fusible y el interruptor                                                                                                  |
|                     | – Motor defectuoso                                                     | – Cambiar motor                                                                                                                                        |
| La bomba no bombea  | – Válvulas defectuosas o sucias                                        | – Cambiar o vaciar las válvulas con cuidado o ver apartado <a href="#">Sustitución de válvulas de entrada y de salida</a> [> Página 16].               |
|                     | – Válvula de derivación abierta                                        | – Cerrar válvula de derivación                                                                                                                         |
|                     | – Junta tórica de la válvula de derivación defectuosa                  | – debe repararse por el servicio técnico de Bühler o ver <a href="#">Cambio de la junta tórica de la válvula de drenaje (opcional)</a> [> Página 17].  |
|                     | – Un fuelle desgarrado                                                 | – puede repararse por el servicio técnico de Bühler o ver <a href="#">Cambio del fuelle y de la combinación de carnero / excéntrica</a> [> Página 16]. |
| La bomba hace ruido | – Un mecanismo de manivela desviado                                    | – puede repararse por el servicio técnico de Bühler o ver <a href="#">Cambio del fuelle y de la combinación de carnero / excéntrica</a> [> Página 16]. |

| Avería                                 | Causa                                          | Solución                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo de seguridad se dispara | – Daños en el motor-cojinete                   | – Cambiar motor                                                                                                                                        |
|                                        | – Cortocircuito de bobinado y bornes           | – Medir la resistencia de aislamiento                                                                                                                  |
|                                        | – Se ha superado el tiempo de puesta en marcha | – Comprobar las condiciones de arranque                                                                                                                |
| Mal rendimiento                        | – Fuga                                         | – Apretar los tornillos cabezales y tener en cuenta el par de giro del motor (ver apartado <a href="#">Mantenimiento</a> [> Página 15]).               |
|                                        | – Un fuelle desgarrado                         | – puede repararse por el servicio técnico de Bühler o ver <a href="#">Cambio del fuelle y de la combinación de carnero / excéntrica</a> [> Página 16]. |
|                                        | – Válvulas defectuosas o sucias                | – Cambiar o vaciar las válvulas con cuidado o ver apartado <a href="#">Sustitución de válvulas de entrada y de salida</a> [> Página 16].               |

Tab. 1: Búsqueda y solución de fallos

## 7.2 Piezas de repuesto

A la hora de pedir repuestos debe indicar el tipo de dispositivo y el número de serie.

Encontrará los componentes para el reequipamiento y la extensión en nuestro catálogo.

Los siguientes repuestos están disponibles:

| Repuesto | N.º de artículo          | Posición en esquema de montaje 42/025-Z02-01-2 |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------|
| P4.3     | Fuelle                   | 12a                                            |
|          | Sistema excéntrica-biela | 10a, 11                                        |
|          | Juego válvulas 100 °C    | 2x 17a                                         |
|          | Juego válvulas 160 °C    | 2x 17b                                         |
|          | Junta tórica derivación  | 21a                                            |
| P4.83    | Fuelle                   | 12b                                            |
|          | Sistema excéntrica-biela | 10c, 11                                        |
|          | Juego válvulas 160 °C    | 2x 17b                                         |
|          | Junta tórica derivación  | 21a                                            |

Tab. 2: Repuestos y recambios

## 8 Eliminación

A la hora de desechar los productos, deben tenerse en cuenta y respetarse las disposiciones legales nacionales aplicables. El desecho no debe suponer ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado para productos de Bühler Technologies GmbH indica que deben respetarse las instrucciones especiales de eliminación dentro de la Unión Europea (UE) para productos eléctricos y electrónicos.



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que los productos eléctricos y electrónicos así marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Deberán eliminarse adecuadamente como residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Bühler Technologies GmbH puede desechar sus dispositivos marcados de esta forma. Para hacerlo así, envíe el dispositivo a la siguiente dirección.



Estamos legalmente obligados a proteger a nuestros empleados frente a los posibles peligros de los equipos contaminados. Por lo tanto, le pedimos que comprenda que únicamente podemos desechar su dispositivo usado si no contiene materiales operativos agresivos, cáusticos u otros que sean dañinos para la salud o el medio ambiente. **Para cada residuo de aparato eléctrico y electrónico se debe presentar el formulario «Formulario RMA y declaración de descontaminación» que tenemos disponible en nuestra web. El formulario completado debe adjuntarse al embalaje de manera que sea visible desde el exterior.**

Utilice la siguiente dirección para devolver equipos eléctricos y electrónicos usados:

Bühler Technologies GmbH  
WEEE  
Harkortstr. 29  
40880 Ratingen  
Alemania

Tenga en cuenta también las reglas de protección de datos y su responsabilidad de garantizar que no haya datos personales en los dispositivos usados que devuelva. Por lo tanto, debe asegurarse de eliminar sus datos personales de su antiguo dispositivo antes de devolverlo.

## 9 Anexo


### 9.1 Características técnicas

#### Características técnicas P4.3/P4.83


|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal:                                                       | Ver instrucciones de pedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corriente nominal:                                                     | Ver instrucciones de pedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de protección:                                                    | eléctrica IP55<br>mecánica IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                                                                  | aprox. 12,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volumen muerto:                                                        | 2 x 8,5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FM C-US (solo 115 V)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N.º permiso FM:                                                        | 3038101/3038101C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiental:                                                 | máx. 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura del medio:                                                 | Válvulas PTFE/PVDF máx. 100° C<br>Válvulas PTFE/PEEK máx. 160° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiales de las partes en contacto con el medio según tipo de bomba: | PTFE / PVDF (bomba estándar con válvulas de 100° C)<br>+ PEEK (bomba estándar con válvulas de 160° C)<br>+ Viton (bomba estándar con válvulas de 100° C y válvula de drenaje)<br>+ PCTFE, Viton (bomba estándar con válvulas de 160° C y válvula de drenaje)<br>+ 1.4571 (cuerpo de bomba VA)<br>+ 1.4401, Viton (unión roscada VA)<br>+ Viton (cuerpo de bomba VA con válvula de drenaje) |

### 9.2 Curvas de flujo


**P4.3 (por cabezal)**

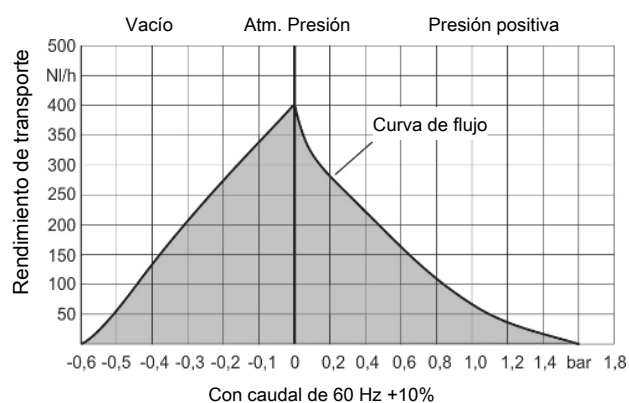


**P4.83 (por cabezal)**

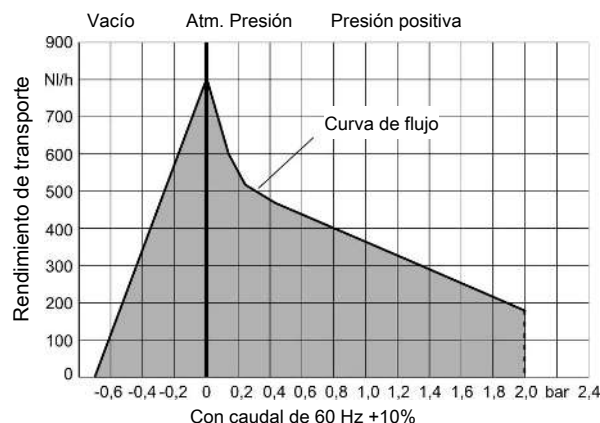

**P4.83 (con conexión en paralelo)**

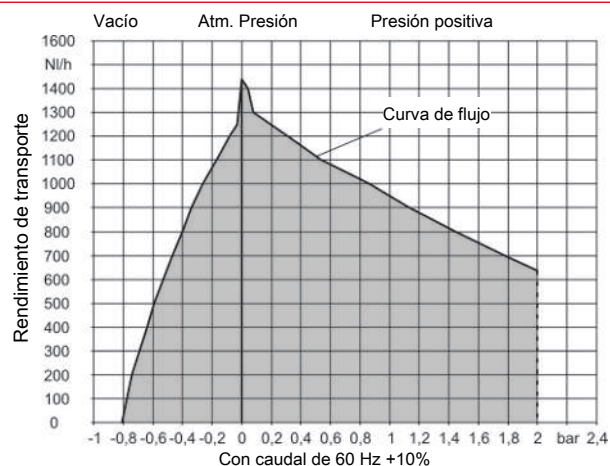



## 9.3 Dimensiones

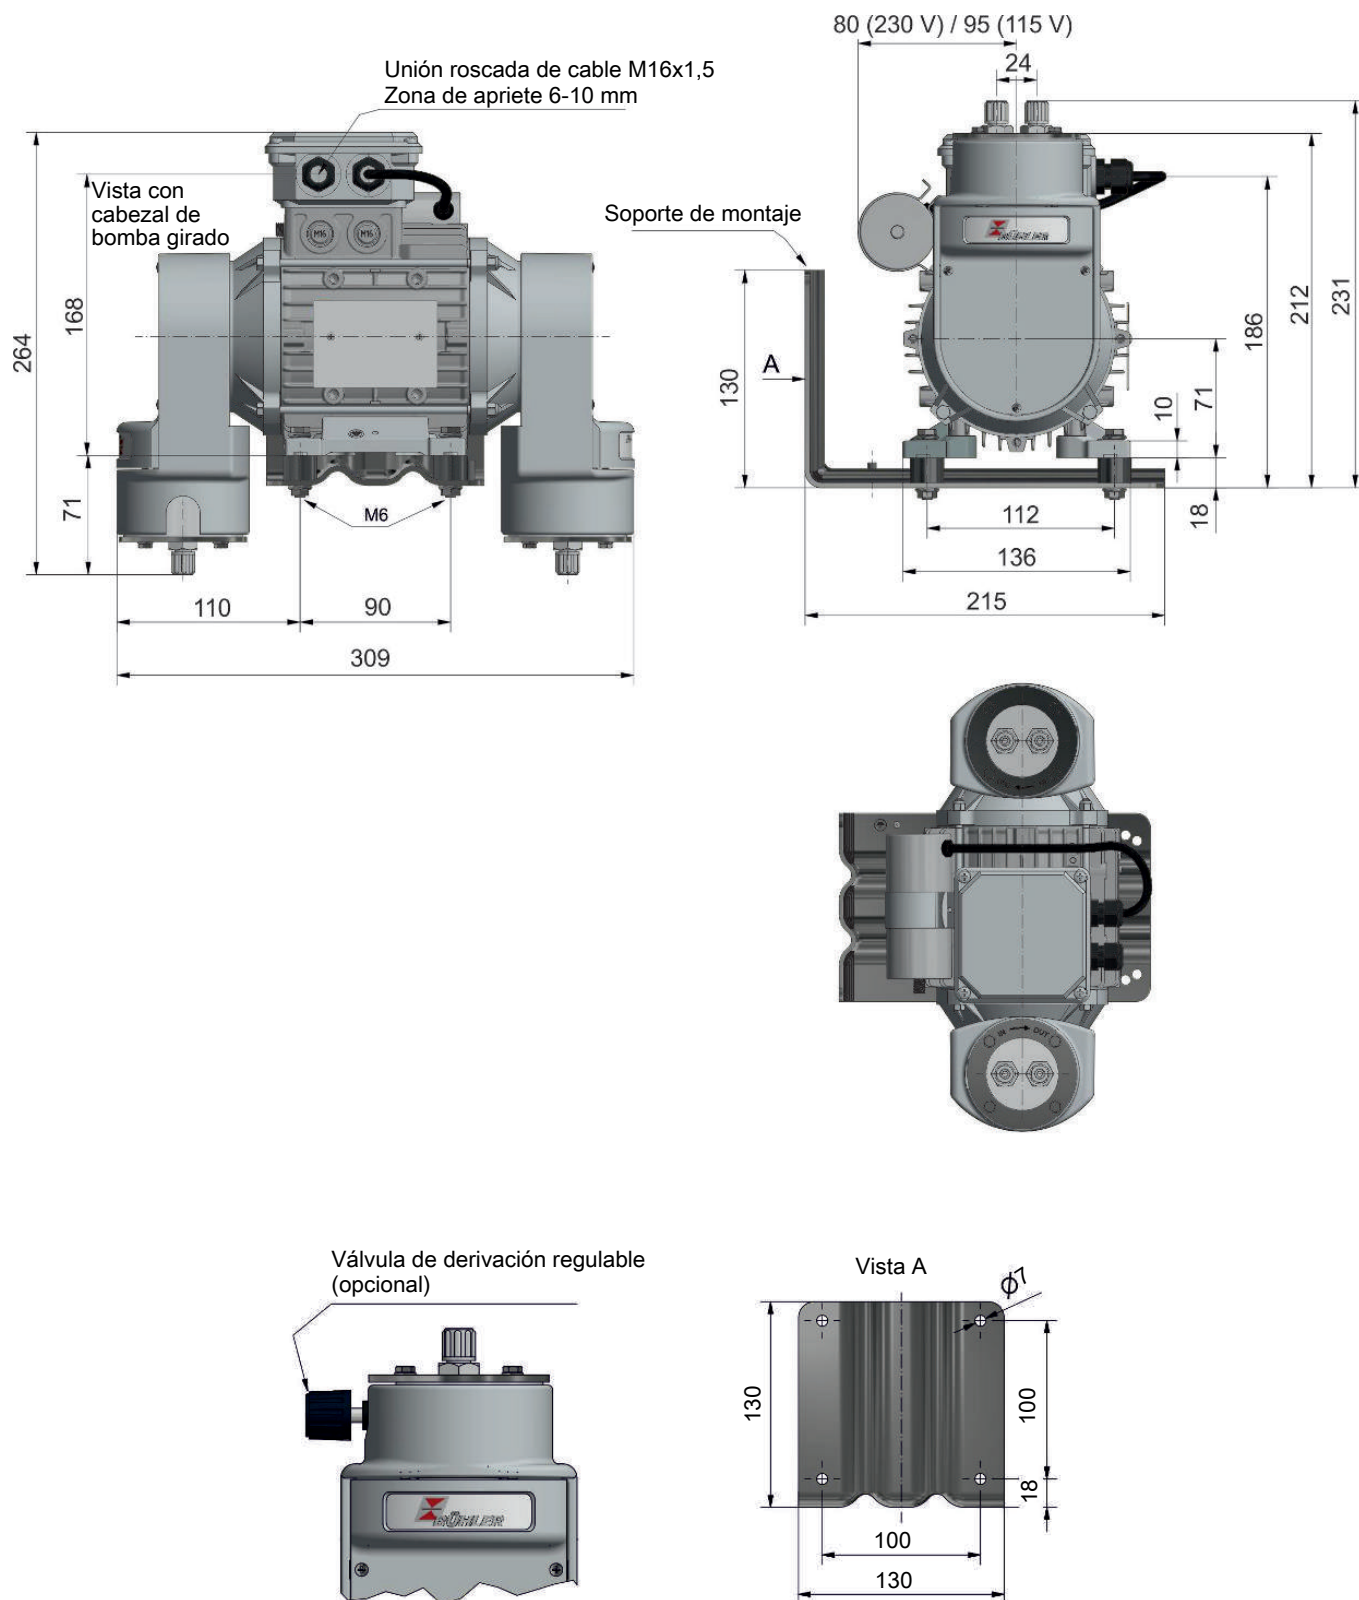

Modo de instalación:


- 1) La bomba debe instalarse de forma horizontal
- 2) El cabezal de bomba debe girarse durante la instalación si es necesario. En el transporte de gases con parte de condensados debe montarse con las válvulas hacia abajo.

## 9.4 Dimensiones de juego de tuberías/juego de mangueras para P4.83 con funcionamiento en paralelo

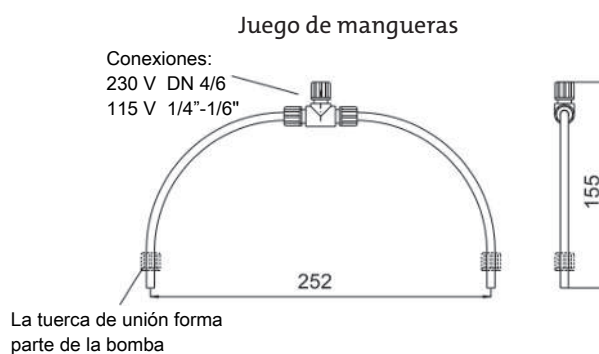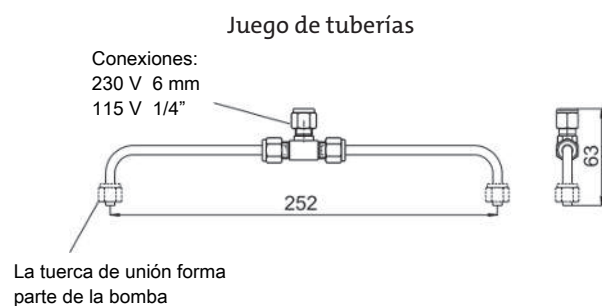

## 10 Documentación adjunta

- Esquemas: 42/025-Z02-01-2, 42/025-Z02-03-2
- Declaración de conformidad: KX 42 0002
- Manual de uso: Motor eléctrico
- Certificados: FM21NUS0010, FM21NCA0007
- RMA - Declaración de descontaminación

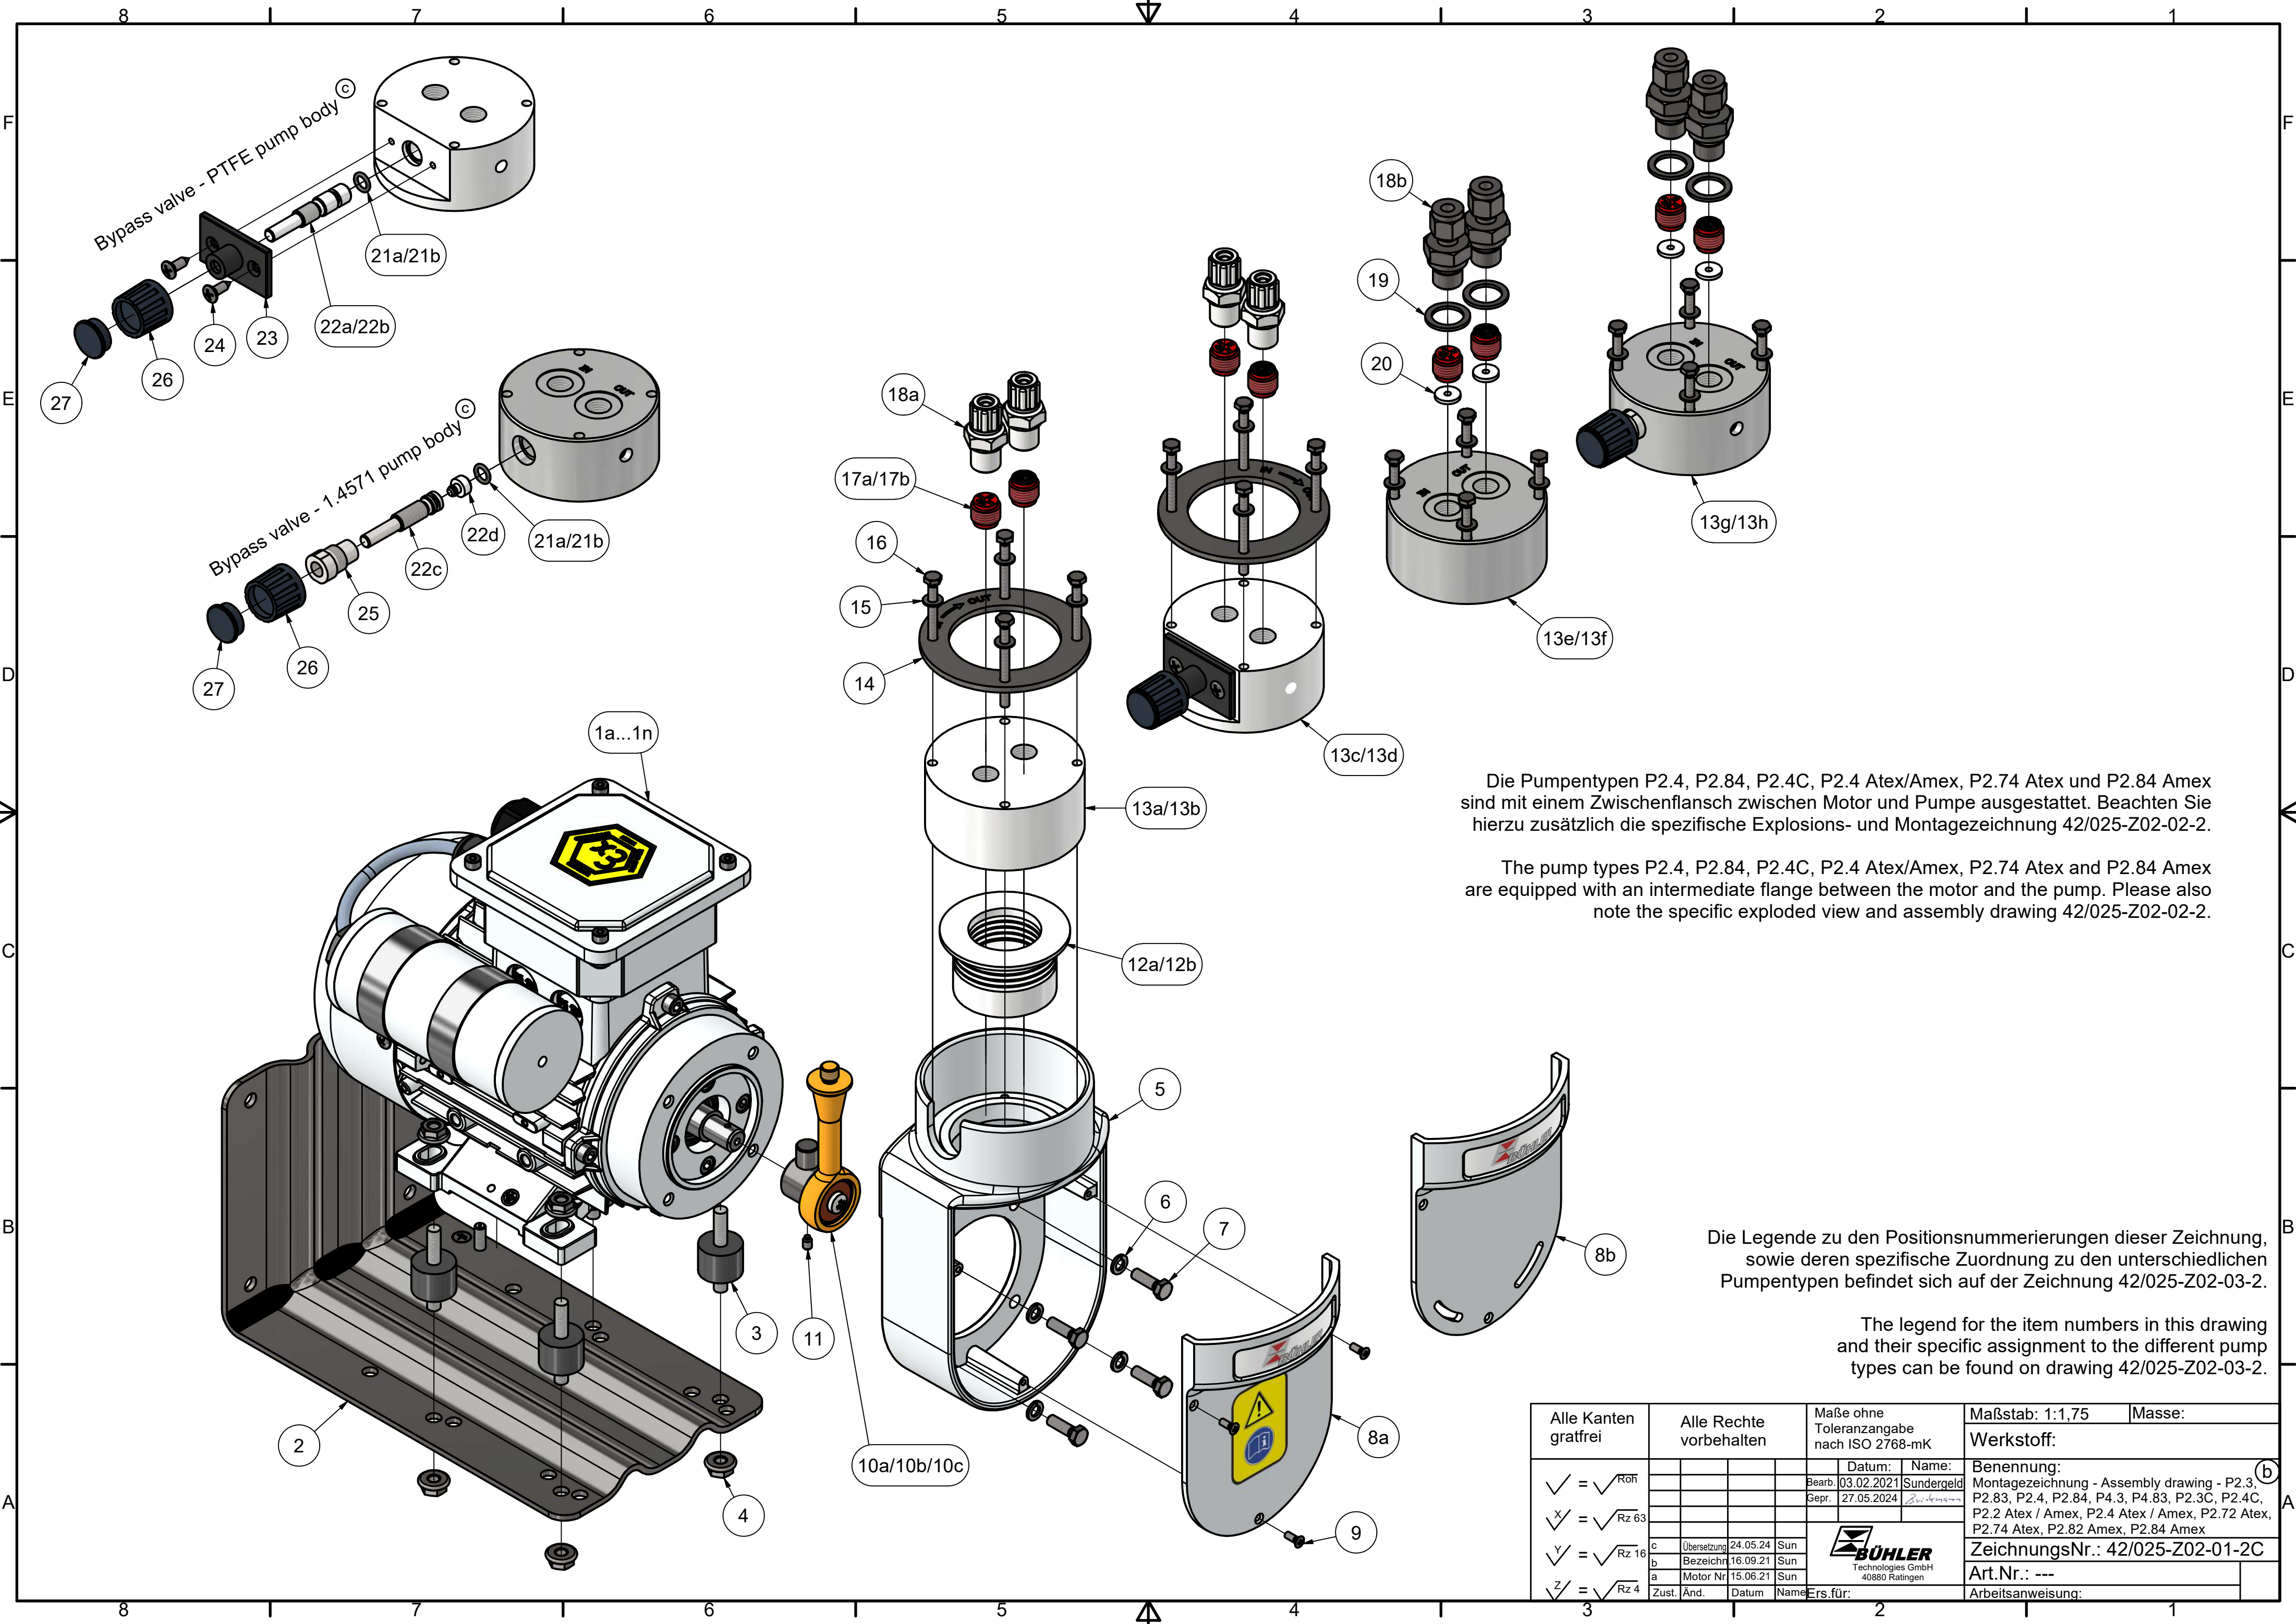

Die Pumpentypen P2.4, P2.84, P2.4C, P2.4 Atex/Amex, P2.74 Atex und P2.84 Amex sind mit einem Zwischenflansch zwischen Motor und Pumpe ausgestattet. Beachten Sie hierzu zusätzlich die spezifische Explosions- und Montagezeichnung 42/025-Z02-02-2.

The pump types P2.4, P2.84, P2.4C, P2.4 Atex/Amex, P2.74 Atex and P2.84 Amex are equipped with an intermediate flange between the motor and the pump. Please also note the specific exploded view and assembly drawing 42/025-Z02-02-2.

Die Legende zu den Positionsnummerierungen dieser Zeichnung, sowie deren spezifische Zuordnung zu den unterschiedlichen Pumpentypen befindet sich auf der Zeichnung 42/025-Z02-03-2.

The legend for the item numbers in this drawing and their specific assignment to the different pump types can be found on drawing 42/025-Z02-03-2.

|                         |               |                            |     |                                                 |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|
| Alle Kanten<br>gratfrei |               | Alle Rechte<br>vorbehalten |     | Maße ohne<br>Toleranzangabe<br>nach ISO 2768-mK |                                                                                                                                                         | Maßstab: 1:1,75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Masse: |  |            |
|                         |               |                            |     |                                                 |                                                                                                                                                         | Werkstoff:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
| ✓ = √R0f                |               |                            |     |                                                 | Datum:                                                                                                                                                  | Name:           | <div>Benennung:<br/>Montagezeichnung - Assembly drawing - P2.3,<br/>P2.83, P2.4, P2.84, P4.3, P4.83, P2.3C, P2.4C,<br/>P2.2 Atex / Amex, P2.4 Atex / Amex, P2.72 Atex,<br/>P2.74 Atex, P2.82 Amex, P2.84 Amex</div> <div>ZeichnungsNr.: 42/025-Z02-01-2C</div> <div>Art.Nr.: ---</div> <div>Arbeitsanweisung:</div> |        |  |            |
| ✓x = √Rz 63             |               |                            |     |                                                 | Bearb.                                                                                                                                                  | 03.02.2021      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  | Sundergeld |
|                         |               |                            |     |                                                 | Gepr.                                                                                                                                                   | 27.05.2024      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
| ✓y = √Rz 16             |               |                            |     |                                                 |  <div><b>BÜHLER</b><br/>Technologies GmbH<br/>40880 Ratingen</div> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
|                         |               |                            |     |                                                 |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
| ✓z = √Rz 4              | c Übersetzung | 24.05.24                   | Sun |                                                 | Zust.                                                                                                                                                   | Änd.            | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name   |  |            |
|                         | b Bezeichn    | 16.09.21                   | Sun |                                                 |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
|                         | a Motor Nr    | 15.06.21                   | Sun |                                                 |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |
|                         |               |                            |     |                                                 | Ers. für:                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |

| Zeichnungsnummer/Drawing no. 42/025-Z02-03-2   Rev.C   Date: 24.05.2024   Autor: Sundergeld                   |                                                                               |                                                                            | Legende und spezifische Zuordnung der Positionsnummern aus den Montagezeichnungen<br>Legend and specific assignment for the item numbers of the assembly drawings |       |      |       |      |       |       |       |           |           |           |           |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Änderung: C = Übersetzungskorrektur => pump "head">"body"   Geprüft am: 27.05.2024   Prüfer: <i>B. Kötter</i> |                                                                               |                                                                            | 42/025-Z02-01-2 & 42/025-Z02-02-2                                                                                                                                 |       |      |       |      |       |       |       |           |           |           |           |            |            |            |            |
| Pos. No.                                                                                                      | Description                                                                   | Beschreibung                                                               | P2.3                                                                                                                                                              | P2.83 | P2.4 | P2.84 | P4.3 | P4.83 | P2.3C | P2.4C | P2.2 Atex | P2.2 Amex | P2.4 Atex | P2.4 Amex | P2.72 Atex | P2.74 Atex | P2.82 Amex | P2.84 Amex |
| 1a                                                                                                            | Motor 230V 50/60Hz                                                            | Motor 230V 50/60Hz                                                         | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | ---  | ---   | X     | X     | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1b                                                                                                            | Motor 115V 50/60Hz                                                            | Motor 115V 50/60Hz                                                         | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | ---  | ---   | X     | X     | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1c                                                                                                            | Motor 230/400V 50/60Hz                                                        | Motor 230/400V 50/60Hz                                                     | X                                                                                                                                                                 | X     | X    |       | ---  | ---   | X     | X     | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1d                                                                                                            | Motor 230V 50/60Hz with two shaft ends                                        | Motor 230V 50/60Hz mit 2 Wellenenden                                       | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | X    | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1e                                                                                                            | Motor 115V 50/60Hz with two shaft ends                                        | Motor 115V 50/60Hz mit 2 Wellenenden                                       | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | X    | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 1f                                                                                                            | Motor 230V 50/60Hz Atex, IECEX                                                | Motor 230V 50/60Hz Atex, IECEX                                             | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | X         | ---       | X         | ---       | X          | X          | ---        | ---        |
| 1g                                                                                                            | Motor 115V 50/60Hz Atex, IECEX                                                | Motor 115V 50/60Hz Atex, IECEX                                             | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | X         | ---       | X         | ---       | X          | X          | ---        | ---        |
| 1h                                                                                                            | Motor 380-420V 50Hz Atex, IECEX                                               | Motor 380-420V 50Hz Atex, IECEX                                            | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | X         | ---       | X         | ---       | X          | X          | ---        | ---        |
| 1i                                                                                                            | Motor 500V 50Hz Atex, IECEX                                                   | Motor 500V 50Hz Atex, IECEX                                                | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | X         | ---       | X         | ---       | X          | X          | ---        | ---        |
| 1j                                                                                                            | Motor 230V 50/60Hz Cl.I, Div.2                                                | Motor 230V 50/60Hz Cl.I, Div.2                                             | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | ---       | X         | ---       | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 1k                                                                                                            | Motor 115V 50/60Hz Cl.I, Div.2                                                | Motor 115V 50/60Hz Cl.I, Div.2                                             | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | ---       | X         | ---       | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 2                                                                                                             | Montagekonsole                                                                | Mounting bracket                                                           | X                                                                                                                                                                 | X     | ---  | ---   | X    | X     | X     | ---   | X         | X         | ---       | ---       | X          | ---        | X          | ---        |
| 3                                                                                                             | Gummi-Metall-Puffer                                                           | Shock absorber                                                             | X                                                                                                                                                                 | X     | ---  | ---   | X    | X     | X     | ---   | X         | X         | ---       | ---       | X          | ---        | X          | ---        |
| 4                                                                                                             | Mutter DIN 6923 - M6                                                          | Nut DIN 6923 - M6                                                          | X                                                                                                                                                                 | X     | ---  | ---   | X    | X     | X     | ---   | X         | X         | ---       | ---       | X          | ---        | X          | ---        |
| 5                                                                                                             | Pumpenkonsole                                                                 | Pump housing                                                               | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 6                                                                                                             | Federring DIN 127 B5,1                                                        | Spring washer DIN 127 B5,1                                                 | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 7                                                                                                             | Schraube DIN 933 M5x16                                                        | Screw DIN 933 M5x16                                                        | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 8a                                                                                                            | Konsolendeckel - standard                                                     | Cover - standard                                                           | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | ---   | ---   | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 8b                                                                                                            | Konsolendeckel mit Schlitzten                                                 | Cover with slots                                                           | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | X     | X     | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 9                                                                                                             | Schraube DIN 966 M3x8                                                         | Screw DIN 966 M3x8                                                         | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 10a                                                                                                           | Kurbeltrieb für 400l/h Pumpen (Stößel gold)                                   | Crank drive for 400l/h pumps (plunger gold)                                | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 10b                                                                                                           | Kurbeltrieb für 700l/h Pumpen (Stößel grün)                                   | Crank drive for 700l/h pumps (plunger green)                               | ---                                                                                                                                                               | ---   | ---  | ---   | ---  | ---   | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | X          | X          | ---        | ---        |
| 10c                                                                                                           | Kurbeltrieb für 800l/h Pumpen (Stößel schwarz)                                | Crank drive for 800l/h pumps (plunger black)                               | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | X          | X          |
| 11                                                                                                            | Schraube DIN 915 M4x6 oder ISO 4028 M4X6 TX 8                                 | Screw DIN 915 M4x6 or ISO 4028 M4X6 TX 8                                   | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 12a                                                                                                           | Faltenbalg für 400l/h Pumpen (4 Falten)                                       | Below for 400l/h pumps (4 folds)                                           | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 12b                                                                                                           | Faltenbalg für 700l/h und 800l/h Pumpen (8 Falten)                            | Below for 700l/h and 800l/h pumps (8 folds)                                | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | X          | X          | X          | X          |
| 13a                                                                                                           | Pumpenkörper - PTFE für 400l/h Pumpen                                         | Pump body - PTFE for 400l/h pumps                                          | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 13b                                                                                                           | Pumpenkörper - PTFE für 800l/h Pumpen                                         | Pump body - PTFE for 800l/h pumps                                          | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | X          | X          |
| 13c                                                                                                           | Pumpenkörper - PTFE mit Bypassventil für 400l/h Pumpen                        | Pump body - PTFE with bypass valve for 400l/h pumps                        | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 13d                                                                                                           | Pumpenkörper - PTFE mit Bypassventil 800l/h Pumpen                            | Pump body - PTFE with bypass valve for 800l/h pumps                        | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | X          | X          |
| 13e                                                                                                           | Pumpenkörper - 1.4571 für 400l/h und 700l/h Pumpen                            | Pump body - 1.4571 for 400l/h and 700l/h pumps                             | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | ---        | ---        |
| 13f                                                                                                           | Pumpenkörper - 1.4571 für 800l/h Pumpen                                       | Pump body - 1.4571 for 800l/h pumps                                        | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | X          | X          |
| 13g                                                                                                           | Pumpenkörper - 1.4571 mit Bypassventil für 400l/h und 700l/h Pumpen           | Pump body - 1.4571 with bypass valve for 400l/h and 700l/h pumps           | X                                                                                                                                                                 | ---   | X    | ---   | X    | ---   | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | ---        | ---        |
| 13h                                                                                                           | Pumpenkörper - 1.4571 mit Bypassventil für 800l/h Pumpen                      | Pump body - 1.4571 with bypass valve for 800l/h pumps                      | ---                                                                                                                                                               | X     | ---  | X     | ---  | X     | ---   | ---   | ---       | ---       | ---       | ---       | ---        | ---        | X          | X          |
| 14                                                                                                            | Montagering - nur für PTFE Pumpenkörper                                       | Mounting ring - only for pump bodys made of PTFE                           | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 15                                                                                                            | Spannscheibe DIN 6796 d=4                                                     | Clamping washer DIN 6796 d=4                                               | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 16                                                                                                            | Schraube DIN 933 M4x45                                                        | Screw DIN 933 M4x45                                                        | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 17a                                                                                                           | Ventil - geeignet bis zu 100°C Gaseingangstemperatur                          | Valve - suitable up to 100°C gas inlet temperature                         | X                                                                                                                                                                 | ---   | ---  | ---   | X    | ---   | X     | ---   | X         | X         | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 17b                                                                                                           | Ventil - geeignet bis zu 160°C Gaseingangstemperatur                          | Valve - suitable up to 160°C gas inlet temperature                         | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 18a                                                                                                           | Kunststoff Einschraubverschraubung - diverse Typen - siehe Pumpendatenblätter | Plastic fitting - various types - see pump data sheets                     | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 18b                                                                                                           | Edelstahl Rohrverschraubung - diverse Typen - siehe Pumpendatenblätter        | Stainless steel fitting - various types - see pump data sheets             | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 19                                                                                                            | Dichtring - nur für Edelstahl Pumpenkörper                                    | Sealing ring - only for pump bodys made of 1.4571                          | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 20                                                                                                            | Verdränger - nur für Edelstahl Pumpenkörper                                   | Displacer - only for pump bodys made of 1.4571                             | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 21a                                                                                                           | O-Ring - FKM                                                                  | O-Ring made of FKM                                                         | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 21b                                                                                                           | O-Ring - FFKM                                                                 | O-Ring made of FFKM                                                        | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 22a                                                                                                           | Spindel für Bypassventil - geeignet bis zu 100°C Gaseingangstemperatur        | Spindle for PTFE bypass valve - suitable up to 100°C gas inlet temperature | X                                                                                                                                                                 | ---   | ---  | ---   | X    | ---   | X     | ---   | X         | X         | ---       | ---       | ---        | ---        | ---        | ---        |
| 22b                                                                                                           | Spindel für Bypassventil - geeignet bis zu 160°C Gaseingangstemperatur        | Spindle for PTFE bypass valve - suitable up to 160°C gas inlet temperature | ---                                                                                                                                                               | X     | X    | X     | ---  | X     | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 22c                                                                                                           | Spindel für Edelstahl Bypassventil                                            | Spindle for 1.4571 bypass valve                                            | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 22d                                                                                                           | Spindelspitze                                                                 | Spindle tip                                                                | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 23                                                                                                            | Montageplatte Bypassventil                                                    | Mounting plate bypass valve                                                | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 24                                                                                                            | Schraube DIN 7982 4,2x13                                                      | Screw DIN 7982 4,2x13                                                      | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | ---        | ---        | X          | X          |
| 25                                                                                                            | Spindelaufnahme                                                               | Spindle holder                                                             | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 26                                                                                                            | Drehknopf                                                                     | Knob                                                                       | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 27                                                                                                            | Deckel                                                                        | Cover                                                                      | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |
| 28                                                                                                            | Zwischenflansch                                                               | Intermediate flange                                                        | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 28a/28b                                                                                                       | Kupplungsnahe                                                                 | Coupling hub                                                               | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 28c                                                                                                           | Kupplungsstern                                                                | Spider                                                                     | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 29                                                                                                            | Kupplungsflansch                                                              | Coupling flange                                                            | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 30                                                                                                            | Montagering                                                                   | Mounting ring                                                              | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 31                                                                                                            | Schraube DIN 933 M6x20                                                        | Screw DIN 933 M6x20                                                        | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 32                                                                                                            | Unterlegscheibe DIN 125 A6,4                                                  | Washer DIN 125 A6,4                                                        | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 33                                                                                                            | Unterlegscheibe DIN 125 A5,3                                                  | Washer DIN 125 A5,3                                                        | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     | ---  | ---   | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| 34                                                                                                            | Schraube DIN 933 M5x20                                                        | Screw DIN 933 M5x20                                                        | ---                                                                                                                                                               | ---   | X    | X     |      |       | ---   | X     | ---       | ---       | X         | X         | ---        | X          | ---        | X          |
| X                                                                                                             | Kompletter Pumpenkopf - diverse Kombinationsmöglichkeiten                     | Complete pump head - various combinations                                  | X                                                                                                                                                                 | X     | X    | X     | X    | X     | X     | X     | X         | X         | X         | X         | X          | X          | X          | X          |

**EG-/EU Konformitätserklärung**  
**EC/EU Declaration of Conformity**



Hiermit erklärt Bühler Technologies GmbH,  
dass die nachfolgenden Produkte den  
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie

**2006/42/EG**  
**(MRL)**

in ihrer aktuellen Fassung entsprechen.

Die Produkte sind Maschinen nach Artikel 2 a).

*Herewith declares Bühler Technologies GmbH  
that the following products correspond to the  
essential requirements of Directive*

**2006/42/EC**  
**(MD)**

*in its actual version.*

*The products are machines according to article 2 (a).*

**Produkt / products:** Messgaspumpen / *Sample gas pumps*  
**Typ / type:** P4.3, P4.83

Das Betriebsmittel ist für den Einbau in Gasanalysesystemen bestimmt und für das Fördern von  
ausschließlich gasförmigen Medien vorgesehen

*The equipment is designed for installation in gas analyser systems and is designed to transport only  
gaseous media.*

Das oben beschriebene Produkt der Erklärung erfüllt die einschlägigen  
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation  
legislation:*

**EN 809:1998+A1:2009 + AC:2010**

**EN 60204-1:2018**

Zusätzlich wurden berücksichtigt:  
*In addition, the following standards have been used:*  
**EN ISO 12100:2010**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

Dokumentationsverantwortlicher für diese Konformitätserklärung ist Herr Stefan Eschweiler mit  
Anschrift am Firmensitz.

*The person authorised to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company's  
address.*

Ratingen, den 15.09.2022

Stefan Eschweiler  
Geschäftsführer – *Managing Director*

Frank Pospiech  
Geschäftsführer – *Managing Director*

## UK Declaration of Conformity



The manufacturer Bühler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product complies with the requirements of the following UK legislation:

### **Machinery Safety Regulations 2008**

**Products:** Sample gas pumps  
**Types:** P4.3  
P4.83

The equipment is designed for installation in gas analyser systems and is designed to transport only gaseous media.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

**EN 809:1998+A1:2009 + AC:2010**

**EN 60204-1:2018**

In addition, the following standards have been used:

**EN ISO 12100:2010**

Ratingen in Germany, 01.11.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Eschweiler'.

Stefan Eschweiler  
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frank Pospiech'.

Frank Pospiech  
Managing Director



## Istruzioni di servizio

Prescrizioni sulla sicurezza uso e manutenzione del prodotto

Via Achille Grandi, 23 47030, San Mauro Pascoli (FC)

[www.orange1.eu](http://www.orange1.eu)

### Indicazioni sulle misure di sicurezza ed istruzioni per i motori trifase e i motori monofase

I simboli di seguito riportati servono da riferimento alle misure di sicurezza ed alle istruzioni supplementari contenute nelle presenti istruzioni di servizio.

Istruzioni speciali di sicurezza e garanzia

Pericolo



Attenersi strettamente alle misure di sicurezza ed alle istruzioni supplementari contenute nelle presenti istruzioni di servizio per la salvaguardia di persone e cose.



Le macchine elettriche rotanti presentano parti sotto tensione o in movimento e parti molto calde. Il trasporto, il collegamento per la messa in funzione e la manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato e responsabile (vedere IEC 364). Interventi inadeguati possono causare danni a persone e cose.



Tutti i lavori di collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato.

### UTILIZZO PRESCRITTO E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

I motori a bassa tensione sono destinati a impianti industriali e sono conformi alle norme armonizzate EN 60034/IEC34. Se non espressamente previsto è vietato l'utilizzo in zone classificate per pericolo di esplosione ed incendio. I motori sono adatti a temperature ambiente che vanno da -20°C a +40°C ed a luoghi con altitudine fino a 1000 m. s.l.m.



Controllare attentamente i dati indicati sulla targa prima della messa in funzione del motore. I motori in bassa tensione sono considerati come componenti da installare in altre macchine ai sensi della Direttiva Comunitaria sulle macchine 2006/42/EC. La messa in funzione è proibita fino ad avvenuto accertamento della conformità finale a tale direttiva. Le macchine elettriche rotanti alimentate da rete sono conformi alle norme EN 50081 e EN 50082 riguardanti fenomeni di compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2004/108/EC e non sono necessari particolari accorgimenti di schermatura. Nel caso di funzionamento intermittente, gli eventuali disturbi generati dai dispositivi di inserzione devono essere limitati mediante adeguati cablaggi.



I lavori sulla macchina elettrica devono avvenire a macchina ferma e scollegata dalla rete (compresi gli equipaggiamenti ausiliari). Se sono presenti protezioni elettriche, eliminare ogni possibilità di avviamento improvviso attenendosi alle specifiche raccomandazioni sull'impiego delle varie apparecchiature.



Nei motori monofase il condensatore può rimanere caricato tenendo temporaneamente in tensione i morsetti anche a motore fermo.

### TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO

Al ricevimento della fornitura accertarsi che non sussistano danni imputabili al trasporto e nell'eventualità dare comunicazione immediata, contestandoli allo spedizioniere ed astenendosi dalla messa in funzione.

Quando sono forniti con il motore, serrare saldamente i golfari a vite; poiché essi servono per il sollevamento del solo motore, non si devono sollevare macchine o accessori aggiuntivi ad esso accoppiati. Se necessario, fare ricorso a mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati. Se sul motore sono presenti due golfari utilizzare sempre entrambi per il sollevamento.

Se i motori vengono immagazzinati accertarsi che l'ambiente sia asciutto, senza polvere ed esente da vibrazioni (v eff. <0,2 mm/s) al fine di evitare danneggiamenti ai cuscinetti. Prima della messa in funzione misurare la resistenza di isolamento. Se si misurano valori di resistenza <1,5MΩ, essiccare l'avvolgimento. Per la procedura di essiccazione rivolgersi direttamente al nostro ufficio tecnico.

### INSTALLAZIONE



Tutte le operazioni di allacciamento elettrico devono essere eseguite da

personale qualificato con motore fermo disinserito e nell'impossibilità di essere riavviato.

Il rotore è equilibrato dinamicamente con mezza chiave. Gli organi di accoppiamento devono essere equilibrati con mezza chiave su mandrino liscio. Giunti e pulegge devono essere montati mediante apparecchiature apposite al fine di non danneggiare i cuscinetti del motore. Dopo il montaggio controllare che gli organi di accoppiamento siano ben fissi sull'estremità albero e spinti contro l'arresto. Se il mozzo dell'organo di accoppiamento fosse più corto dell'estremità d'albero la differenza dovrà essere compensata mediante bussola distanziatrice. Pulegge troppo piccole o troppo larghe compromettono il buon funzionamento dei cuscinetti.

I motori devono essere installati in posizione tale che l'aria di raffreddamento possa entrare ed uscire facilmente. La ventilazione non deve essere impedita e l'aria di scarico, anche di gruppi adiacenti, non deve essere riaspirata dalla ventola. Evitare di avere fonti di calore tali da influenzare la temperatura sia dell'aria sia del motore.

In caso di installazione all'aperto proteggere il motore con opportuni accorgimenti dall'irraggiamento solare e dalle intemperie, si consiglia di proteggere il motore con dispositivi salvamotore, limitatori elettronici di coppia qualora il motore non sia dotato di termistori.

Nel caso di ambienti con forti escursioni termiche ed ove si preveda la formazione di condensa, il motore deve essere dotato di apposite scaldiglie anticondensa, fuori di scolo sono da praticarsi nella posizione più idonea a seconda della posizione di installazione.



Nel caso di installazione di motori con flangia B14, assicurarsi che la lunghezza dei bulloni di fissaggio sia adeguata con il loro diametro e la profondità del foro: viti troppo lunghe possono causare danni all'avvolgimento del motore. Quando i fori sono forniti chiusi con viti e guarnizioni o-ring, ripristinare le guarnizioni in fase di accoppiamento.



Controllare il senso di rotazione a motore non accoppiato facendo attenzione di assicurare la linguetta al fine di evitarne un distacco violento durante la rotazione.

Se il senso di rotazione non è quello voluto, togliere tensione e quando il motore si sarà fermato:

nel caso di motore trifase scambiare tra loro due delle tre fasi

nel caso di motore monofase scambiare tra loro i cavi dell'avvolgimento ausiliario



L'allacciamento elettrico deve essere eseguito in modo sicuro e permanente: utilizzare adeguati capicorda.



Le parti metalliche del motore che normalmente non sono sotto tensione devono essere francamente collegate a terra mediante un cavo di sezione adeguata di colore giallo-verde, utilizzando l'apposito morsetto contrassegnato all'interno della scatola morsetteria.

Nella scatola morsetteria non devono essere presenti corpi estranei, sporcizia ed umidità. Chiudere gli imbocchi dei cavi qualora restino inutilizzati ed usare adeguati passacavi qualora non siano stati forniti con il motore. Controllare che il diametro del cavo sia compatibile con il pressacavo fornito od utilizzato.

Richiudere sempre il coperchio della scatola morsetteria per non alterare il grado di protezione previsto.

### COLLEGAMENTO



Il collegamento elettrico deve sempre essere eseguito da personale qualificato in accordo con le vigenti norme IEE, EN 60204 ed eventuali prescrizioni locali.




Fare sempre riferimento ai dati stampati sulla targa di tensione e frequenza per assicurarsi un corretto accoppiamento alla rete di alimentazione. Se non specificato si possono assumere tolleranze di ±5% sulla tensione e ±1% sulla frequenza indicati in targa.

I diagrammi di collegamento vengono normalmente forniti con il motore o sono stampati nella scatola morsetteria, qualora mancassero, fare riferimento a quelli forniti nel presente manuale.

Assicurarsi che, nel caso di avviamento stella/triangolo, il passaggio da stella a triangolo sia eseguito solo quando la corrente di avviamento sia diminuita al valore corrispondente a quello di stella: ciò è importante per evitare il rischio di sovraccarichi non ammessi.


Nel caso in cui il motore sia provvisto di protettore termico, collegare i cavi del protettore ad un contatto ausiliario del contattore sulla linea di alimentazione.

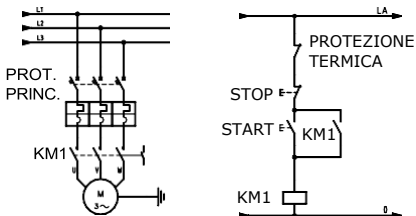

### FUNZIONAMENTO:

Una volta avviato il motore a pieno carico controllare che parta e giri silenziosamente, e che non si verifichino vibrazioni eccessive o forti rumori anomali.

Per un primo esame di un eventuale anomalia fare riferimento alla tabella in calce.

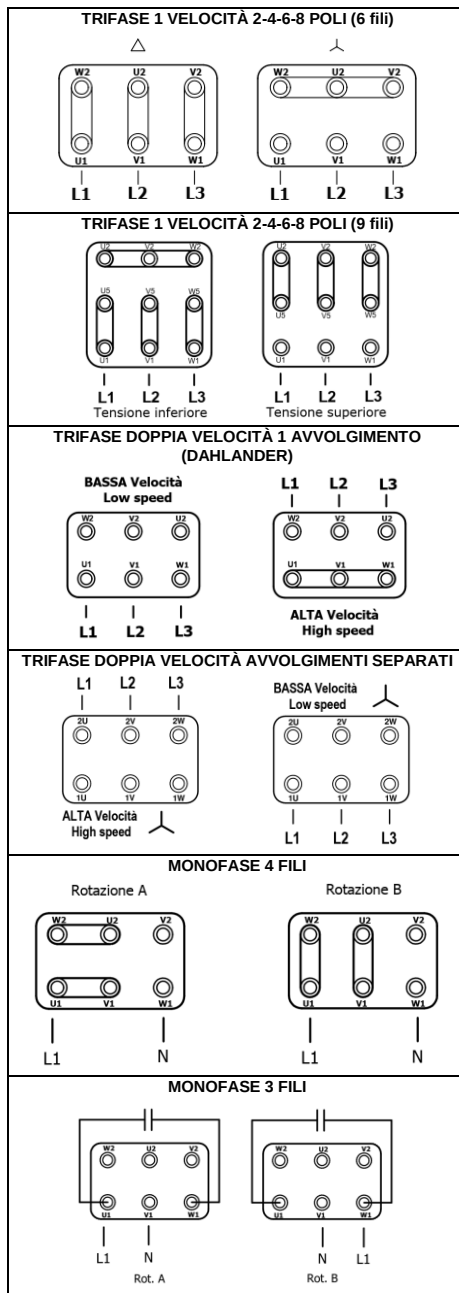

### MANUTENZIONE:

All'occorrenza e periodicamente (in funzione dell'ambiente e del servizio) verificare e ripristinare se necessario:

- la pulizia del motore (assenza di oli, sporcizia, residui di lavorazione) ed il libero passaggio dell'aria di ventilazione
- il corretto serraggio delle connessioni elettriche, degli organi di accoppiamento e fissaggio meccanico del motore
- le condizioni delle tenute statiche e rotanti
- il livello di vibrazione del motore (v eff <3,5 mm/s per Pn<15KW v eff <4,5 mm/s per Pn>15KW) il livello di rumore e nel caso questo si presenti anormale verificare il fissaggio motore, l'equilibratura della macchina accoppiata o l'esigenza di sostituzione dei cuscinetti.

| ANOMALIA                                                                                    |                     |                            | Possibili cause                                | Rimedio                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cuscinetto troppo caldo                                                                     | Cuscinetto rumoroso | Motore gira irregolarmente |                                                |                                        |
|                                                                                             |                     |                            | Cinghia troppo tesa                            | Diminuire la tensione della cinghia    |
|                                                                                             |                     |                            | Il giunto trasmette sforzi al motore           | Riallineare il motore o il giunto      |
|                                                                                             |                     |                            | Temperatura aria raffreddamento >40°C (104 °F) | Ristabilire temperatura raffreddamento |
|                                                                                             |                     |                            | Motore non montato correttamente               | Controllare la forma costruttiva       |
|                                                                                             |                     |                            | Sbilanciamento causato dalla puleggia o giunto | Controllare la bilanciatura            |
|                                                                                             |                     |                            | Fissaggio labile del motore                    | Controllare il fissaggio               |
| Se i rimedi sopra descritti non sono sufficienti, vi consigliamo di sostituire i cuscinetti |                     |                            |                                                |                                        |

| ANOMALIA  |              |                      |                       | Possibili cause                                              | Rimedio                                           |
|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Non parte | Troppo caldo | Diminuzione velocità | Intervento protezioni |                                                              |                                                   |
|           |              |                      |                       | Coppia resistente troppo alta                                | Controllare il motore e la coppia di carico       |
|           |              |                      |                       | Tensione alimentazione troppo bassa                          | Verificare rete di alimentazione                  |
|           |              |                      |                       | Interruzione di una fase                                     | Verificare rete di alimentazione                  |
|           |              |                      |                       | Errato collegamento                                          | Verificare con schema                             |
|           |              |                      |                       | Sovraccarico                                                 | Controllare dati di targa                         |
|           |              |                      |                       | Frequenza di inserzioni troppo elevata                       | Controllare il tipo di servizio indicato in targa |
|           |              |                      |                       | Ventilazione insufficiente                                   | Controllare i canali di ventilazione              |
|           |              |                      |                       | Corto circuito nell'avvolgimento o nella scatola morsetteria | Verificare resistenza isolamento                  |
|           |              |                      |                       | Eccessiva durata dell'avviamento                             | Verificare condizioni di avviamento               |



## Service instructions

### Safety prescriptions

#### Product use and maintenance

Via Achille Grandi, 23 47030, San Mauro Pascoli (FC)  
PROTEZIONE

### Indications on safety prescriptions and special instructions for three phase and single phase motors

These symbols will draw your attention to the safety measures and additional instructions given in these Operating Instructions.

Special instructions regarding safety and warning

For reasons of protection of persons and objects, follow the safety measures and additional instructions given in these Operating Instructions.

Electric rotating machines present dangers from live and rotating parts, and probably very hot surfaces. All work on them including transportation, connection, commissioning and maintenance must be by qualified and responsible specialists (IEC 364 must be observed). Inadequate work can lead to severe damage to persons and property.

All work on electrical connections to the motors must be performed only by qualified personnel.

### SPECIFIED USE AND WORKING CONDITIONS

These low voltage motors are only intended for use in industrial plants and are in accordance with the relevant sections of EN 60034/IEC34. Their use in hazardous areas is prohibited, unless explicitly indicated. The motors are suitable for ambient temperatures from -20°C (68°F) to +40°C (104°F) and altitudes <= 1000m above sea level.

It is imperative to observe the data printed on the nameplate before operating the motor. Low voltage motors are components to be installed into machines in accordance with Directive 2006/42/EC. Commissioning is not allowed until the conformity of the end product with this directive has been established. These asynchronous motors comply with EN 50081 and EN 50082 standards on electromagnetic compatibility for the EMC (2004/108/EC) Directive and no particular shielding is necessary when connected to a pure sinewave voltage supply.

Before working on the motor, ensure it has stopped and is disconnected from the power supply (including auxiliary equipment). If there is any form of automatic starting, automatic resetting, relays or remote starting, avoid any possibility of unexpected re-starting, paying attention to specific recommendations on equipment application.

In single phase motors, capacitors can remain temporarily charged resulting in live terminals even after the motor has stopped. Discharge all the capacitors and ground every terminal before touching any connection.

### TRANSPORT, STORAGE

On receipt verify that the motor has not been damaged during transport and in this case avoid any installation and communicate immediately to the transport service.

Eyebolts, when provided with the motor, must be tightened properly as they are suitable only for lifting the motor, no additional loads are allowed to be attached. If necessary use sufficiently dimensioned devices as a means of transport. Do not use any projection of the motor body to hang the motor for transport purposes. If two eyebolts are present on the motor use both for lifting. Store low voltage motors in a dry, dust free and low vibration (v eff <0,2 mm/s) area to prevent bearing damage. Before commissioning, the insulation resistance must be measured. In case of values < 1,5 MΩ the winding must be dried. Contact our technical department directly for information on the drying procedure.

### INSTALLATION

All work must only be done by qualified personnel with the low voltage motor and driven machine at standstill, electrically dead and locked against restart.

The rotor has been balanced dynamically with a half key fitted. The coupling components must also be balanced with a half key on a smooth mandrel. Coupling belts and pulleys must be assembled by suitable tools to protect the bearings.

After assembly check that the coupling components are well fixed on the shaft end; they must be properly pushed against the shaft shoulder. Where the hub of the coupling gear is shorter than the shaft end, compensate the difference by use of a bush spacer. Too large or too small pulleys can impair the shaft bearing life; similarly excessive belt tension can cause low bearing life or shaft breakage.

The motors must be installed in a proper position so that cooling air can go in and out easily. The ventilation must not be hindered and the outgoing air - also from adjacent units - must not be directly sucked in again.

Avoid heat sources near the motor that might affect the temperatures both of cooling air and of the motor.

In case of outdoor installation protect the motor from solar radiation and extremes of weather.

It is advisable to protect the motor with such as over-current devices and torque limiters where it is not protected by winding temperature transducers connected to appropriate switchgear.

In case of environments with wide thermal excursions and when can be preview the presence of moisture, the motor must be equipped with heaters. Drain holes must be positioned in places dependent on the installation configuration.

In case of installation of motors with face flange B14, make sure that the fixing screws are of a proper length compared to the tapped diameter: too long screws could damage the motor winding. In case of motor provided with screws and o-ring seals, such seals shall be replaced in the right position during the assembling.

Check the direction of rotation with the motor not coupled fastening the shaft key to avoid its violent ejection during rotation.

If the direction of rotation is not as desired, disconnect the motor and wait until the motor is completely stopped:

- in the case of three phase motors interchange two phases at the terminals
- in the case of single phase motors refer to the diagram supplied with the motor

Connection must be made in such a way that a durably safe, electrical connection is maintained: adequate cable and associated equipment must be used.

Metallic parts that are normally not energized must be connected to earth by means of green-yellow cable of a proper section using the earth terminal inside the terminal box.

The terminal box must be free of foreign bodies, dirt and humidity. Open cable gland holes must be sealed.

Use appropriate cable glands if these are not included with the motor. Check if the cable diameter is compatible with the cable gland installed.

Always close the terminal box cover in order not to invalidate the protection class of the motor.

### CONNECTION


The electrical connection must be done by qualified personnel in accordance with appropriate regulations such as IEE, EN 60204 and local prescriptions.

Always refer to the data printed on the nameplate for voltage and frequency to ensure the motor is appropriate for the mains supply. If not specified it is possible to assume tolerances of ±5% on voltage and ±1% on frequency indicated on the nameplate.

The connection diagrams are normally supplied together with the motor or are printed in the terminal box. If they are missing please refer to this manual or contact directly to our technical office.

Check and make sure that, in the case of star/delta start, the switching from star to delta can only be executed after the starting current of the star step has fallen; this is important because of the risk of not permitted operational loads.


In case the motor is provided with thermal protector connect the thermal protector cables to a auxiliary contact following the drawing:

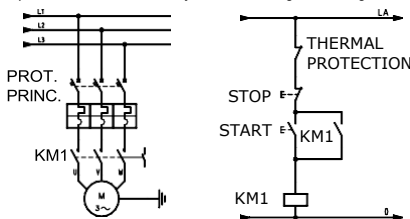

### OPERATION:

Once the motor is running at full load check if the motor starts freely and runs smoothly and ensure excessive vibrations and high noise are absent.

For a first check following a failure please refer to the table below.

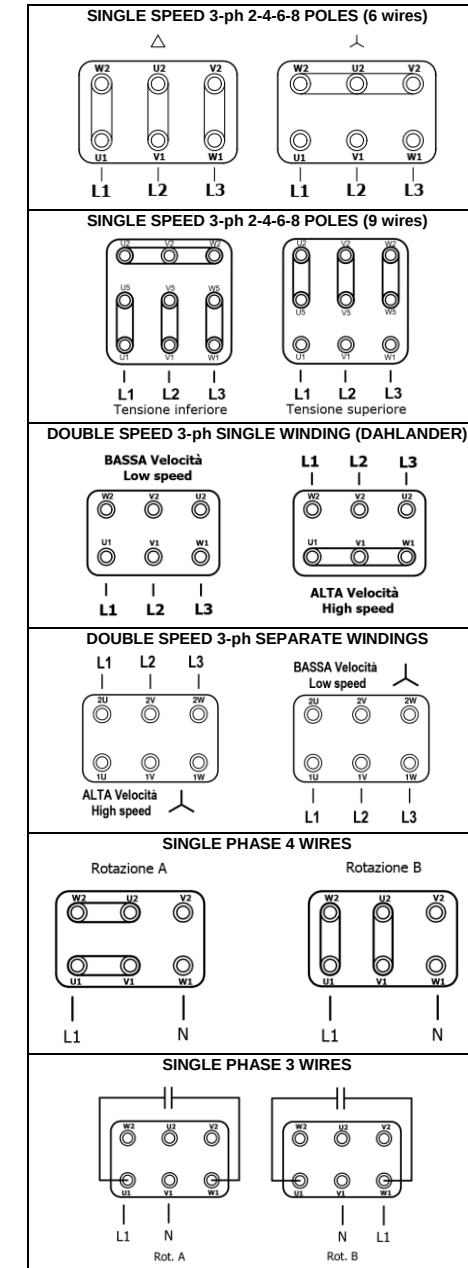

### MAINTENANCE:

If necessary and periodically (depending on the environment and duty) verify and maintain as necessary to ensure:

- motor cleanliness (oil, dirt and machining residuals absence) and free passage of cooling air
- correct tightening of electrical connections, of fastening screws
- free motor running with low vibration (v eff <3,5mm/s for Pn<15KW v eff <4,5 mm/s for Pn>15KW) and
- absence of anomalous noises; where there is high vibration and/or noise verify the motor fastenings, machine balancing and that the bearings are in good condition.

| FAULT                                                                                     |               |                     | Possible causes                        | Remedy                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Beating too hot                                                                           | Beating noise | Motor runs unevenly |                                        |                                   |
|                                                                                           |               |                     | Pulley tension too high                | Reduce pulley tension             |
|                                                                                           |               |                     | Coupling forces are pulling or pushing | Realign motor, correct coupling   |
|                                                                                           |               |                     | Coolant temperature above 40°C (104°F) | Adjust temperature of cooling air |
|                                                                                           |               |                     | Motor incorrectly mounted              | Correct the motor mounting        |
|                                                                                           |               |                     | Unbalance caused by pulley or coupling | Balance finely                    |
|                                                                                           |               |                     | Motor fastening insecure               | Improve fastening                 |
| If the remedies described here are insufficient, we recommend replacement of the bearings |               |                     |                                        |                                   |

| FAULT         |         |                 |                                 | Possible causes                            | Remedy                                         |
|---------------|---------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Doesn't start | Too hot | Speed reduction | Protective devices intervention |                                            |                                                |
|               |         |                 |                                 | Resisting torque is too high               | Reduce the load torque                         |
|               |         |                 |                                 | Mains voltage too low                      | Increase mains voltage                         |
|               |         |                 |                                 | Phase interruption                         | Check mains supply                             |
|               |         |                 |                                 | Wrong connection                           | Check with the wiring diagram                  |
|               |         |                 |                                 | Overload                                   | compare data on rating plate with measurements |
|               |         |                 |                                 | Switching frequency too high               | Observe rated duty type                        |
|               |         |                 |                                 | Insufficient ventilation                   | Check ventilation passages                     |
|               |         |                 |                                 | Short circuit of winding or terminal board | Measure insulation resistance                  |
|               |         |                 |                                 | Starting time exceeded                     | Reduce load torque/load inertia                |

FM Approvals  
1151 Boston Providence Turnpike  
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA  
T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com



# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

## HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT

This certificate is issued for the following equipment:

***P2.2 AMEX (P/N 4271XXXX99), P2.4 AMEX (P/N 4272XXXX99), P2.5 AMEX (P/N 4278XXXX99), P2.82 AMEX (P/N 4273XXXX99) and P2.84 AMEX (P/N 4274XXXX99) Rated 115V/230V AC, 50/60Hz, 1.7A/0.89A. Sample Gas Pumps.***

NI / I / 2 / BCD / T3, T4 Ta = -20 °C to +50 °C

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head and material of valves.

For ordinary locations:

***P2.3 (P/N 4256XXXX99), P2.4 (P/N 4257XXXX99), P2.5 (P/N 4258XXXX99), P2.83 (P/N 4263XXXX99), P2.84 (P/N 4264XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A and P4.3 (P/N 4280XXXX99), P4.83 (P/N 4281XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A . Sample Gas Pumps.***

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head, material of valves and accessories (only P4.XX)

### Equipment Ratings:

Nonincendive electric apparatus for use in Class I, II, Division 2, Groups A, B, C & D indoor hazardous (Classified) locations and for use in ordinary Locations

FM Approved for:

Bühler Technologies GmbH  
Ratingen D-40880 Germany



This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

|            |      |
|------------|------|
| Class 3600 | 1998 |
| Class 3611 | 2004 |
| Class 3810 | 2005 |


Original Project ID: 3038101

Approval Granted: May 24, 2010

Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended

| Report Number | Date | Report Number | Date |
|---------------|------|---------------|------|
|---------------|------|---------------|------|

FM Approvals LLC

  
J. E. Marquardt

Group Manager, Electrical

24 May 2010  
Date



Member of the FM Global Group

FM Approvals  
1151 Boston Providence Turnpike  
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA  
T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

## ELECTRICAL EQUIPMENT

This certificate is issued for the following equipment:

***P2.3 (P/N 4256XXXX99), P2.4 (P/N 4257XXXX99), P2.5 (P/N 4258XXXX99), P2.83 (P/N 4263XXXX99), P2.84 (P/N 4264XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A and P4.3 (P/N 4280XXXX99), P4.83 (P/N 4281XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A . Sample Gas Pumps.***

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head, material of valves and accessories (only P4.XX)

### Equipment Ratings:

Industrial electrical equipment meeting basic electrical, mechanical and fire protection requirements.

### FM Approved for:

Bühler Technologies GmbH  
Ratingen D-40880 Germany



Member of the FM Global Group

This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

|            |      |
|------------|------|
| Class 3600 | 2011 |
| Class 3611 | 2004 |
| Class 3810 | 2005 |


Original Project ID: 3038101

Approval Granted: 24 May 2010

Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended

| Report Number | Date          | Report Number | Date |
|---------------|---------------|---------------|------|
| 120709        | July 24, 2012 |               |      |

FM Approvals LLC

  
J. E. Marquedant  
Group Manager, Electrical

24 July 2012  
Date

# CERTIFICATE OF CONFORMITY



1. **ELECTRICAL EQUIPMENT PER US REQUIREMENTS**

2. **Certificate No:** FM21NUS0010

3. **Equipment:** Model P2.3, P2.4, P2.83, P2.84, P4.3 and P4.83 Sample Gas  
(Type Reference and Name) Pumps

4. **Name of Listing Company:** Bühler Technologies GmbH

5. **Address of Listing Company:** Harkortstrasse 29  
Ratingen  
D-40880  
Germany

6. The examination and test results are recorded in confidential report number:

3038101 dated 24<sup>th</sup> May 2010

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval standards and other documents:

FM Class 3810:2005

**Certificate issued by:**

J.E. Marquedant  
VP, Manager - Electrical Systems

24 September 2021

Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to [www.approvalguide.com](http://www.approvalguide.com)

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC, 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmapprovals.com](mailto:information@fmapprovals.com) [www.fmapprovals.com](http://www.fmapprovals.com)



# SCHEDULE



to US Certificate of Conformity No: FM21NUS0010

8. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.

9. **Equipment Ratings:**

The P2.3, P2.4, P2.83 and P2.84 pumps (models 4256\*\*\*\*9\*00, 4257\*\*\*\*9\*00, 4263\*\*\*\*9\*00 and 4264\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 1.5 to 1.6 A, or 2.3 to 2.78 A, depending upon motor utilized. The P4.3 and P4.83 pumps (models 4280\*\*\*\*9\*00 and 4281\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 2.55 to 2.8 A. The pumps are rated for an ambient temperature range of -20°C to +60°C.

10. **Description of Equipment:**

**General** – The sample pumps move sample gases from stacks to an analyzer. A sample pump consists of a motor and a pump head, which can be split by an intermediate flange with variable versions.

**Construction** – The sample pumps are of painted metal construction. The motors for the pumps provide a terminal box fitted with an M16x1.5 cable gland suitable for use with a 6 to 10 mm diameter cable.

**Model types** – Approved model number variants are as defined below.

**42aabcdef9g00. Sample Gas Pumps, where:**

aa = Base model: 56, 57, 63, 64, 80, 81

(where 56 = P2.3, 57 = P2.4, 63 = P2.83, 64 = P2.84, 80 = P4.3, 81 = P4.83)

b = Motor voltage: 2

c = Pump head position: 1, 2

d = Pump head material: 1, 2, 3, 4

e = Valve material: 1, 2

f = Screw-in connections: 9, 1, 2, 3, 5

g = Connection kit for parallel operation: 0, 1, 2

11. **Test and Assessment Procedure and Conditions:**

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.

12. **Schedule Drawings**

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

13. **Certificate History**

Details of the supplements to this certificate are described below:

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

# **SCHEDULE**



to US Certificate of Conformity No: FM21NUS0010

| Date                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>th</sup> May 2010       | Original Issue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 <sup>th</sup> July 2012      | <u>Supplement 1:</u><br>Report Reference: 120709 dated 24 <sup>th</sup> July 2012<br>Description of the Change: Create separate certificate for ordinary location certificate. Refer to FM21US0082X certificate history for changes to hazardous location pump variants under revision 120709.                                                                                                                                 |
| 24 <sup>th</sup> September 2021 | <u>Supplement 2:</u><br>Report Reference: RR228650 dated 24 <sup>th</sup> September 2021.<br>Description of the Change: Re-create certificate in new format. Reformat model number scheme in Certificate and Approval Guide listing. Remove erroneous references to FM Class 3600 and FM Class 3611 from certificate. Refer to FM21US0082X certificate history for changes to hazardous location pump variants under RR228650. |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)

# CERTIFICATE OF CONFORMITY



1. **ELECTRICAL EQUIPMENT PER US REQUIREMENTS**

2. **Certificate No:** FM21NUS0010

3. **Equipment:** Model P2.3, P2.4, P2.83, P2.84, P4.3 and P4.83 Sample Gas  
(Type Reference and Name) Pumps

4. **Name of Listing Company:** Bühler Technologies GmbH

5. **Address of Listing Company:** Harkortstrasse 29  
Ratingen  
D-40880  
Germany

6. The examination and test results are recorded in confidential report number:

3038101 dated 24<sup>th</sup> May 2010

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval standards and other documents:

FM Class 3810:2005

**Certificate issued by:**

J.E. Marquedant  
VP, Manager - Electrical Systems

2 December 2021

Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to [www.approvalguide.com](http://www.approvalguide.com)

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmapprovals.com](mailto:information@fmapprovals.com) [www.fmapprovals.com](http://www.fmapprovals.com)



# SCHEDULE



to US Certificate of Conformity No: FM21NUS0010

8. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.

9. **Equipment Ratings:**

The P2.3, P2.4, P2.83 and P2.84 pumps (models 4256\*\*\*\*9\*00, 4257\*\*\*\*9\*00, 4263\*\*\*\*9\*00 and 4264\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 1.5 to 1.6 A, or 2.3 to 2.78 A, depending upon motor utilized. The P4.3 and P4.83 pumps (models 4280\*\*\*\*9\*00 and 4281\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 2.55 to 2.8 A, or 2.8 to 3.4 A, depending upon motor utilized. The pumps are rated for an ambient temperature range of -20°C to +60°C.

10. **Description of Equipment:**

**General** – The sample pumps move sample gases from stacks to an analyzer. A sample pump consists of a motor and a pump head, which can be split by an intermediate flange with variable versions.

**Construction** – The sample pumps are of painted metal construction. The motors for the pumps provide a terminal box fitted with an M16x1.5 cable gland suitable for use with a 6 to 10 mm diameter cable.

**Model types** – Approved model number variants are as defined below.

**42aabcdef9g00. Sample Gas Pumps, where:**

aa = Base model: 56, 57, 63, 64, 80, 81

(where 56 = P2.3, 57 = P2.4, 63 = P2.83, 64 = P2.84, 80 = P4.3, 81 = P4.83)

b = Motor voltage: 2

c = Pump head position: 1, 2

d = Pump head material: 1, 2, 3, 4

e = Valve material: 1, 2

f = Screw-in connections: 9, 1, 2, 3, 5

g = Connection kit for parallel operation: 0, 1, 2

11. **Test and Assessment Procedure and Conditions:**

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.

12. **Schedule Drawings**

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

13. **Certificate History**

Details of the supplements to this certificate are described below:

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

# **SCHEDULE**



to US Certificate of Conformity No: FM21NUS0010

| Date                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>th</sup> May 2010       | Original Issue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 <sup>th</sup> July 2012      | <u>Supplement 1:</u><br>Report Reference: 120709 dated 24 <sup>th</sup> July 2012.<br>Description of the Change: Create separate certificate for ordinary location certificate. Refer to FM21US0082X certificate history for changes to hazardous location pump variants under revision 120709.                                                                                                                                |
| 24 <sup>th</sup> September 2021 | <u>Supplement 2:</u><br>Report Reference: RR228650 dated 24 <sup>th</sup> September 2021.<br>Description of the Change: Re-create certificate in new format. Reformat model number scheme in Certificate and Approval Guide listing. Remove erroneous references to FM Class 3600 and FM Class 3611 from certificate. Refer to FM21US0082X certificate history for changes to hazardous location pump variants under RR228650. |
| 2 <sup>nd</sup> December 2021   | <u>Supplement 3:</u><br>Report Reference: RR230190 dated 2 <sup>nd</sup> December 2021.<br>Description of the Change: Addition of alternate motor supplier/type, impacting equipment ratings field of certificate.                                                                                                                                                                                                             |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)



Member of the FM Global Group

FM Approvals  
1151 Boston Providence Turnpike  
P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA  
T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 [www.fmapprovals.com](http://www.fmapprovals.com)

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

## ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS

This certificate is issued for the following equipment:

***P2.3 (P/N 4256XXXX99), P2.4 (P/N 4257XXXX99), P2.5 (P/N 4258XXXX99), P2.83 (P/N 4263XXXX99),  
P2.84 (P/N 4264XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A and P4.3 (P/N 4280XXXX99), P4.83 (P/N  
4281XXXX99) Rated 115VAC, 50/60Hz, 1.7A . Sample Gas Pumps.***

x = denote power supply, position of pump head, material of pump head, material of valves and accessories (only P4.XX)

### Equipment Ratings:

Industrial electrical equipment meeting basic electrical, mechanical and fire protection requirements.

### FM Approved for:

Bühler Technologies GmbH  
Ratingen D-40880 Germany

This certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:


CSA C22.2 61010-1, 2004 Re-affirmed 2009

Original Project ID: 3038101  
Canadian Project ID: 3038101C

Approval Granted: *July 24, 2012*

| Subsequent Revision Reports / Date Approval Amended |      |               |      |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|------|
| Report Number                                       | Date | Report Number | Date |

FM Approvals LLC

  
J. E. Marquedant  
Group Manager, Electrical

*24 July 2012*  
Date

# CERTIFICATE OF CONFORMITY



1. **ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS**
2. **Certificate No:** FM21NCA0007
3. **Equipment:  
(Type Reference and Name)** Model P2.3, P2.4, P2.83, P2.84, P4.3 and P4.83 Sample Gas Pumps
4. **Name of Listing Company:** Bühler Technologies GmbH
5. **Address of Listing Company:** Harkortstrasse 29  
Ratingen  
D-40880  
Germany
6. The examination and test results are recorded in confidential report number:  
  
3038101C\_Rev120709 dated 24<sup>th</sup> July 2012
7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval standards and other documents:  
  
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:R2009
8. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.

## Certificate issued by:

J.E. Marquedant  
VP, Manager - Electrical Systems

24 September 2021  
Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to [www.approvalguide.com](http://www.approvalguide.com)

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)



# SCHEDULE



to Canadian Certificate of Conformity No: FM21NCA0007

9. Equipment Ratings:

The P2.3, P2.4, P2.83 and P2.84 pumps (models 4256\*\*\*\*9\*00, 4257\*\*\*\*9\*00, 4263\*\*\*\*9\*00 and 4264\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 1.5 to 1.6 A, or 2.3 to 2.78 A, depending upon motor utilized. The P4.3 and P4.83 pumps (models 4280\*\*\*\*9\*00 and 4281\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 2.55 to 2.8 A. The pumps are rated for an ambient temperature range of -20°C to +60°C.

10. Description of Equipment:

**General** – The sample pumps move sample gases from stacks to an analyzer. A sample pump consists of a motor and a pump head, which can be split by an intermediate flange with variable versions.

**Construction** – The sample pumps are of painted metal construction. The motors for the pumps provide a terminal box fitted with an M16x1.5 cable gland suitable for use with a 6 to 10 mm diameter cable.

**Model types** – Approved model number variants are as defined below.

**42aabcdef9g00. Sample Gas Pumps, where:**

aa = Base model: 56, 57, 63, 64, 80, 81

(where 56 = P2.3, 57 = P2.4, 63 = P2.83, 64 = P2.84, 80 = P4.3, 81 = P4.83)

b = Motor voltage: 2

c = Pump head position: 1, 2

d = Pump head material: 1, 2, 3, 4

e = Valve material: 1, 2

f = Screw-in connections: 9, 1, 2, 3, 5

g = Connection kit for parallel operation: 0, 1, 2

11. Test and Assessment Procedure and Conditions:

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Requirements.

12. Schedule Drawings

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

13. Certificate History

Details of the supplements to this certificate are described below:

| Date                       | Description     |
|----------------------------|-----------------|
| 24 <sup>th</sup> July 2012 | Original Issue. |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA

T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmapprovals.com](mailto:information@fmapprovals.com) [www.fmapprovals.com](http://www.fmapprovals.com)

# **SCHEDULE**



to Canadian Certificate of Conformity No: FM21NCA0007

| Date                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>th</sup> September 2021 | <u>Supplement 1:</u><br>Report Reference: RR228650 dated 24 <sup>th</sup> September 2021.<br>Description of the Change: Re-create certificate in new format. Reformat model number scheme in Certificate and Approval Guide listing. Refer to FM21CA0055X certificate history for changes to hazardous location pump variants under RR228650. |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)

# CERTIFICATE OF CONFORMITY



1. **ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS**
2. **Certificate No:** FM21NCA0007
3. **Equipment:** Model P2.3, P2.4, P2.83, P2.84, P4.3 and P4.83 Sample Gas  
**(Type Reference and Name)** Pumps
4. **Name of Listing Company:** Bühler Technologies GmbH
5. **Address of Listing Company:** Harkortstrasse 29  
Ratingen  
D-40880  
Germany
6. The examination and test results are recorded in confidential report number:  
3038101C\_Rev120709 dated 24<sup>th</sup> July 2012
7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval standards and other documents:  
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:R2009
8. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.

## Certificate issued by:

J.E. Marquedant  
VP, Manager - Electrical Systems

2 December 2021  
Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to [www.approvalguide.com](http://www.approvalguide.com)

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)



# SCHEDULE



to Canadian Certificate of Conformity No: FM21NCA0007

## 9. Equipment Ratings:

The P2.3, P2.4, P2.83 and P2.84 pumps (models 4256\*\*\*\*9\*00, 4257\*\*\*\*9\*00, 4263\*\*\*\*9\*00 and 4264\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 1.5 to 1.6 A, or 2.3 to 2.78 A, depending upon motor utilized. The P4.3 and P4.83 pumps (models 4280\*\*\*\*9\*00 and 4281\*\*\*\*9\*00) operate at 115 Vac, at a current of 2.55 to 2.8 A, or 2.8 to 3.4 A, depending upon motor utilized. The pumps are rated for an ambient temperature range of -20°C to +60°C.

## 10. Description of Equipment:

**General** – The sample pumps move sample gases from stacks to an analyzer. A sample pump consists of a motor and a pump head, which can be split by an intermediate flange with variable versions.

**Construction** – The sample pumps are of painted metal construction. The motors for the pumps provide a terminal box fitted with an M16x1.5 cable gland suitable for use with a 6 to 10 mm diameter cable.

**Model types** – Approved model number variants are as defined below.

### 42aabcdef9g00. Sample Gas Pumps, where:

aa = Base model: 56, 57, 63, 64, 80, 81

(where 56 = P2.3, 57 = P2.4, 63 = P2.83, 64 = P2.84, 80 = P4.3, 81 = P4.83)

b = Motor voltage: 2

c = Pump head position: 1, 2

d = Pump head material: 1, 2, 3, 4

e = Valve material: 1, 2

f = Screw-in connections: 9, 1, 2, 3, 5

g = Connection kit for parallel operation: 0, 1, 2

## 11. Test and Assessment Procedure and Conditions:

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Requirements.

## 12. Schedule Drawings

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

## 13. Certificate History

Details of the supplements to this certificate are described below:

| Date                       | Description     |
|----------------------------|-----------------|
| 24 <sup>th</sup> July 2012 | Original Issue. |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA

T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmapprovals.com](mailto:information@fmapprovals.com) [www.fmapprovals.com](http://www.fmapprovals.com)

# **SCHEDULE**



to Canadian Certificate of Conformity No: FM21NCA0007

| Date                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 <sup>th</sup> September 2021 | <u>Supplement 1:</u><br>Report Reference: RR228650 dated 24 <sup>th</sup> September 2021.<br>Description of the Change: Re-create certificate in new format. Reformat model number scheme in Certificate and Approval Guide listing. Refer to FM21CA0055X certificate history for changes to hazardous location pump variants under RR228650. |
| 2 <sup>nd</sup> December 2021   | <u>Supplement 2:</u><br>Report Reference: RR230190 dated 2 <sup>nd</sup> December 2021.<br>Description of the Change: Addition of alternate motor supplier/type, impacting equipment ratings field of certificate.                                                                                                                            |

**THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE**

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA  
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: [information@fmaprovals.com](mailto:information@fmaprovals.com) [www.fmaprovals.com](http://www.fmaprovals.com)

# RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung

## Formulario RMA y declaración de descontaminación



RMA-Nr./ RMA-No.

Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Recibirá el número RMA de su contacto de ventas o de atención al cliente. Al enviar un aparato usado para su eliminación introduzca "WEEE" en el apartado del n.º RMA.

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ Junto con el formulario de devolución debe enviarse también una declaración de descontaminación. Las disposiciones legales indican que usted debe enviarnos esta declaración de descontaminación rellena y firmada. Por la salud de nuestros trabajadores, le rogamos que rellene este documento completamente.

### Firma/ Empresa

Firma/ Empresa

Straße/ Calle

PLZ, Ort/ C.P., municipio

Land/ País

Gerät/ Dispositivo

Anzahl/ Cantidad

Auftragsnr./ Número de encargo

### Ansprechpartner/ Persona de contacto

Name/ Nombre

Abt./ Dpto.

Tel./ Tel.

E-Mail

Serien-Nr./ N.º de serie

Artikel-Nr./ N.º de artículo

### Grund der Rücksendung/ Motivo de devolución

- ☐ Kalibrierung/ Calibrado ☐ Modifikation/ Modificación  
☐ Reklamation/ Reclamación ☐ Reparatur/ Reparación  
☐ Elektroaltgerät/ Equipo eléctrico usado (WEEE)  
☐ andere/ otros

bitte spezifizieren / especifique, por favor

### War das Gerät im Einsatz?/ ¿Estaba en uso el dispositivo?

- ☐ Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdeten Stoffen betrieben wurde./ No, puesto que el dispositivo no utiliza sustancias peligrosas.  
☐ Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ No, puesto que el dispositivo se ha limpiado y descontaminado correctamente.  
☐ Ja, kontaminiert mit:/ Sí, con los siguientes medios:



☐  
explosiv/  
explosivo



☐  
entzündlich/  
inflamable



☐  
brandfördernd/  
comburente



☐  
komprimierte  
Gase/ gases  
comprimidos



☐  
ätzend/  
corrosivo



☐  
giftig,  
Lebensgefahr/  
venenoso, pe-  
ligro de muerte



☐  
gesundheitsge-  
fährdend/  
perjudicial para  
la salud



☐  
gesund-  
heitsschädlich/  
nocivo



☐  
umweltge-  
fährdend/  
dañino para el  
medio ambiente

### Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Adjunte la hoja de datos de seguridad!

Das Gerät wurde gespült mit:/ El dispositivo ha sido lavado con:

*Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.*

*La presente declaración se ha cumplimentado correcta e íntegramente y ha sido firmada por una persona autorizada a tal efecto. El envío de los dispositivos y componentes (descontaminados) se realiza conforme a las disposiciones legales.*

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

En caso de que la mercancía no esté limpia, es decir, nos llegue contaminada, la compañía Bühler se reserva el derecho a contratar a un proveedor externo para que la limpie y a cargarle los gastos a su cuenta.

Firmenstempel/ Sello de la empresa

Datum/ Fecha

rechtsverbindliche Unterschrift/ Firma autorizada



### **Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe**

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.

### **Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen**

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

### **Einbau von Ersatzteilen**

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

### **Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung**

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierungserklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie auf der Webseite unseres Unternehmens.

### **Evitar modificaciones y daños en el conjunto que se va a enviar**

El análisis de módulos defectuosos es una parte importante del control de calidad de Bühler Technologies GmbH. Para garantizar un análisis concluyente la mercancía debe inspeccionarse alterándola lo mínimo posible. No pueden darse cambios ni otros daños que puedan ocultar las causas o impedir el análisis.

### **Manipulación de conjuntos sensibles a la electricidad estática**

En el caso de módulos electrónicos puede tratarse de módulos electrostáticos sensibles. Debe tenerse en cuenta que hay que tratar estos módulos conforme a ESD. En caso de que sea posible los módulos deben cambiarse en un lugar de trabajo conforme con ESD. Si no es posible, deben adoptarse medidas conformes con ESD en caso de intercambio. El transporte puede llevarse a cabo en recipientes conformes con ESD. El embalaje de los módulos debe estar conforme con ESD. Utilice si es posible el embalaje de la pieza de repuesto o seleccione usted mismo un embalaje conforme con ESD.

### **Instalación de piezas de repuesto**

Al instalar la pieza de repuesto tenga en cuenta las mismas indicaciones que se han descrito anteriormente. Asegúrese de que realiza el montaje de la pieza y de todos los componentes. Antes de la puesta en funcionamiento, ponga el cableado de nuevo en su estado original. En caso de dudas pida más información al fabricante.

### **Envío de dispositivos eléctricos usados para su eliminación**

Si desea enviar un producto eléctrico de Bühler Technologies GmbH para su adecuada eliminación por parte de nuestros profesionales, introduzca "WEEE" en el apartado del n.º RMA. Para el transporte, adjunte la declaración de descontaminación del dispositivo usado completamente cumplimentada de forma que sea visible desde fuera. Puede encontrar más información sobre la eliminación de dispositivos electrónicos usados en la página web de nuestra empresa.

