

1 引言

1.1 合规应用

采样探头是为安装于工业化气体分析系统中而设计的。

气体采样探头是气体预处理系统中最重要的部件之一。


- 因此也请注意附件中的相关图纸。
- 在安装本装置之前，请检查给出的技术数据与应用程序参数是否相符。
- 您也应检查供货范围内的所有部件是否完备。

您可从铭牌上辨识其规格。在铭牌上，除了订单号/ID号，您还可找到产品编号和型号名称。

请在连接时留意过滤器的参数，在订购备件时留意正确的版本。

1.2 铭牌

例如：

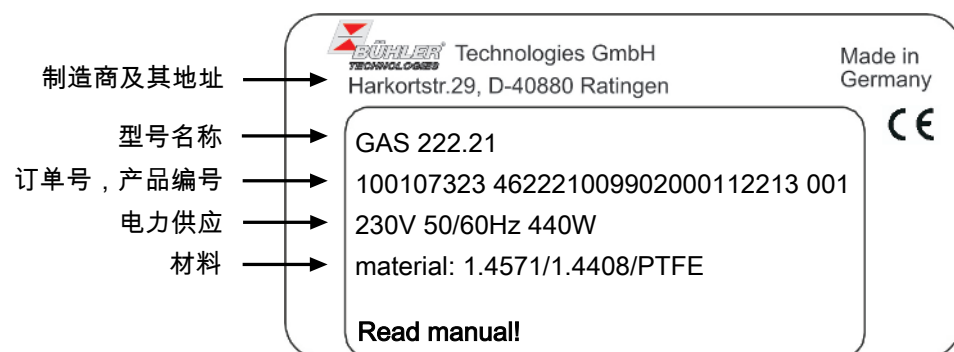

1.3 供货范围

- 1 个气体取样探头
- 1 x 法兰垫圈和螺纹紧固件
- 产品文档
- 连接与安装附件（仅作为选件）

1.4 订购提示

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4622221	X	9	9	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SN	产品特征
																	法兰
0																	DIN DN65 PN6
2																	ANSI 3 “-150 lbs - 无CSA C和US认证
																	探头电压
1																	115 V
2																	230 V
																	校准气体接头
0																	无校准气体接头
1																	6 mm
2																	6 mm + 止回阀
3																	1/4 “
4																	1/4 “ + 止回阀
																	连接经加热的延长线
0																	否
1																	是
																	经加热的延长管用集成的温度控制器¹⁾
0																	否
1																	是
																	带空气储备容器的反冲洗²⁾
																	空气储备容器的加热
1																	是
9																	否
																	集成的反冲洗控制¹⁾
1																	内部控制器
9																	否
																	空气阀/阀门电压规范
0																	手动
1																	115 V
2																	230 V
3																	24 V
9																	不带（如果不需要反冲洗）
																	球阀用的气动执行器
1																	单稳无压打开
2																	单稳无压闭合
3																	双稳态
9																	不带
																	气动传动用限位开关
1																	是
9																	否
																	气动传动用控制阀
3																	3/2路阀
5																	5/2-Wege阀 ³⁾
9																	不带控制阀
																	接液部件玻璃镀膜
																	SN SilcoNert® 2000 ⁴⁾

¹⁾ 在电子设备中，可以集成一用于经加热的延长线的温度控制器或一反冲洗控制。

²⁾ 对于易燃样气，只允许用惰性气体进行反冲洗。对于爆炸性气体，则不允许进行探头反冲洗！

³⁾ 仅在与双稳态气动驱动组合使用时，在球阀上才可实现。

⁴⁾ 交货时间延长约6周。

1.5 产品描述

探头	描述
GAS 222.21	带入气和/或排气过滤器、旋塞阀和反冲洗连接的探头
附件	该探头的附件可在此说明书末尾的数据页中找到